

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ Г5-79

Техническое описание и инструкция
по эксплуатации
З.269.093 ТО

Часть I

Исправленному на стр. 2(1), 13(1)
10(1), 69(1)
..... ВЕРИТЬ *Томасов*

2002

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Введение.....	3
2. Назначение.....	4
3. Технические данные.....	4
4. Состав прибора.....	13
5. Устройство и работа прибора и его составных частей.....	14
5.1. Принцип действия.....	14
5.2. Схема электрическая принципиальная.....	15
5.3. Конструкция.....	63
6. Маркирование и пломбирование.....	68
7. Общие указания по эксплуатации.....	68
8. Указания мер безопасности.....	69
9. Подготовка к работе.....	69
10. Порядок работ.....	70
10.1. Подготовка к проведению измерений.....	70
10.2. Проведение измерений.....	75
11. Характерные неисправности и методы их устранения.....	83
12. Поверка прибора.....	86
12.1. Операции и средства поверки.....	86
12.2. Условия поверки и подготовка к ней.....	94
12.3. Проведение поверки.....	94
12.4. Оформление результатов поверки.....	112
13. Правила хранения.....	112
14. Транспортирование.....	113
14.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки.....	113
14.2. Условия транспортирования.....	114

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации (части 1 и 2) предназначены для изучения генератора импульсов Г5-79 и содержат описание его устройства, принципа действия, технические характеристики, электрические принципиальные схемы, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования), транспортирования, хранения прибора.

В техническом описании приняты следующие обозначения:

ДПКД - делитель с переменным коэффициентом деления;

КОП - канал общего пользования;

ТТЛ - транзисторно-транзисторная логика;

"лог.0" - уровень логического нуля - низкий потенциал
(в ТТЛ - меньше или равно 0,8 В);

"лог.1" - уровень логической единицы - высокий потенциал
(в ТТЛ - больше или равно 2,5 В);

ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь;

УУ - устройство управления;

ОЗУ - оперативное запоминающее устройство;

ОМП - однокристальный микропроцессор;

ГТИ - генератор тактовых импульсов;

БФ - блок формирователей;

ДПС - дешифратор страниц памяти;

ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;

ОМ - общая магистраль;

ШИ - шина информационная;

ПРВ - входы прерываний;

ДУ - дистанционное управление;

ВМ - выбор микросхемы;

ША - шина адресная;

АдК - адрес клавиатуры;

СУ - сигнал управления;

ИСА - информация сопровождения адреса;

ПЗ - параметр запуска;

ПВ - параметр выхода;

ЛД - линия данных;

ПРМ - приемник;
ОИ - очистить интерфейс;
ЗПР - запрос;
ЗП/ЧТ - запись/чтение;
РЕЖИМ 1 - формирование импульсов прямоугольной формы;
РЕЖИМ 2 - формирование линейно-изменяющихся сигналов;
ШФ - шинный формирователь;
КОНТ. - контакт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Генератор импульсов Г5-79 представляет собой источник одинарных и серий импульсов или сигналов типа "пила", "треугольник", "трапеция" и предназначен для проверки импульсной измерительной техники.

Класс точности - IO.

Внешний вид прибора показан на рис.1.

2.2. Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающей среды от 243 до 323 К (от -30 до +50 °С);

относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 298 К (+25 °С);

атмосферное давление 60-106 кПа (450-800 мм рт.ст.);

напряжение питающей сети (220±22) В, частотой (50±0,1) Гц с содержанием гармоник до 5 %, напряжением (220±11) В, частотой (400±12) Гц с содержанием гармоник до 5 %.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Генератор импульсов Г5-79 обеспечивает на основных выходах прямоугольные импульсы (одинарные или серии), неинвертированные (выход 50 Ом и 1 кОм), инвертированные (выход 50 Ом) и сигналы напряжения пилообразной, треугольной или трапецеидальной форм.

Полярность сигналов переключаемая: положительная или отрицательная

3.2. Амплитуда основных прямоугольных импульсов и сигналов пилообразной, треугольной и трапецеидальной форм на внешней нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом) изменяется от 1 до 9,9 В с дискретностью 0,1 В.

Амплитуда основных прямоугольных импульсов и сигналов пилообразной, треугольной и трапецеидальной форм на внешней нагрузке 1 кОм 50 лВ (выход выносного блока) изменяется от 10 до 99 В с дискретностью 1 В.

3.3. Погрешность установки амплитуды основных прямоугольных импульсов и сигналов пилообразной, треугольной и трапецеидальной

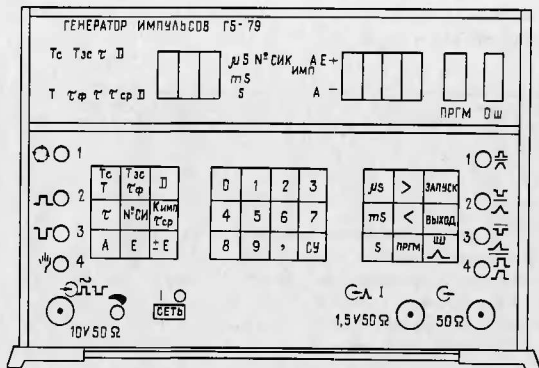


Рис.1. Генератор импульсов Г5-79

форм не превышает $\pm(0,1 A+0,1 B)$ на внешней нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом) и $\pm(0,1 A+1 B)$ на выходе 1 кОм (выход вносного блока), а при установке длительности импульсов 0,1 - 0,3 мкс - $\pm(0,2A+4 B)$, где A - установленное значение амплитуды прямоугольных импульсов или сигналов пилообразной, треугольной или трапециевидальной форм.

3.4. Длительность основных прямоугольных импульсов на внешней нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом) изменяется от 0,05 мкс до 999 мс при внутреннем запуске.

Дискретность установки длительности соответствует табл.1.

При внешнем запуске длительность основных импульсов изменяется от 0,1 мкс до 999 мс.

Таблица 1

Дискретность	Интервал длительности
-	0,05 мкс
0,1 мкс	0,1-99,9 мкс
1 мкс	1-999 мкс
0,01 мс	0,01-9,99 мс
0,1 мс	0,1-99,9 мс
1 мс	1-999 мс

Длительность основных прямоугольных импульсов на внешней нагрузке 1 кОм (вносной блок) изменяется от 0,1 мкс до 999 мс.

Значения длительностей 0,1-0,3 мкс являются дополнительными.
Дискретность установки длительности соответствует табл.2.

Таблица 2

Дискретность	Интервал длительности
0,1 мкс	0,1-99,9 мкс
1 мкс	1-999 мкс
0,01 мс	0,01-9,99 мс
0,1 мс	0,1-99,9 мс
1 мс	1-999 мс

Длительность сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм (по основанию) на внешней нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом) и 1 кОм (выход выносного блока) изменяется от 10 мкс до 999 мс для пилообразной формы ($\tau = \tau_{\Phi}$), от 20 мкс до 999 мс для треугольной формы ($\tau = \tau_{\Phi} + \tau_{ср}$) и от 10,1 мкс до 999 мс для трапецидальной формы с дискретностью, указанной в табл.8 для сигналов пилообразной и треугольной форм и указанной в табл.2 для сигналов трапецидальной форм.

3.5. Погрешность установки длительности основных прямоугольных импульсов на внешней нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом) не превышает $\pm(0,03 \tau + 0,01 \text{ мкс})$;

где τ - установленная длительность импульсов;

погрешность установки длительности основных прямоугольных импульсов на внешней нагрузке 1 кОм (выход выносного блока) не превышает $\pm(0,03 \tau + 0,03 \text{ мкс})$;

при установке длительности 0,1 - 0,3 мкс - $\pm(0,2 + 0,04 \text{ мкс})$;

погрешность установки длительности сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм на внешних нагрузках 50 Ом и 1 кОм не превышает $\pm(0,1 \tau + 0,1 \text{ мкс})$.

3.6. Период повторения серий основных импульсов при внутреннем запуске на выходе 50 Ом изменяется от 1 мкс до 99,9 с, на выходе 1 кОм - от 3 мкс до 99,9 с с учетом следующего соотношения

$$T_c = K_{\text{имп}} \cdot T_{\text{зс}} \cdot Q;$$

где $K_{\text{имп}}$ - количество импульсов в серии;

$T_{\text{зс}}$ - период заполнения серий;

Q - скважность серий (≥ 3).

Таблица 3

Дискретность	Интервал периода
0,1 мкс	1-99,9 мкс
1 мкс	1-999 мкс
0,01 мс	0,01-9,99 мс

Таблица 3, продолжение

Дискретность	Интервал периода
0,1 мс	0,1-99,9 мс
1 мс	1-999 мс
0,01 с	0,01-9,99 с
0,1 с	0,1-99,9 с

Период повторения сигналов при внутреннем запуске и при установке амплитуды сигналов менее 30 В изменяется:

для пилообразной формы от 11 мкс до 99,9 с, значения 11-20 мкс являются дополнительными;

для треугольной формы от 22 мкс до 99,9 с с дискретностью, указанной в табл.4, значения 22-30 мкс являются дополнительными;

для трапецидальной формы от 33 мкс до 99,9 с с дискретностью, указанной в табл.3, значения 33-50 мкс являются дополнительными.

Период повторения сигналов при внутреннем и внешнем запусках и при амплитуде равной или выше 30 В устанавливается с соблюдением окважности не менее 9.

Таблица 4

Дискретность	Интервал периода
0,1 мкс	11-99,9 мкс
1 мкс	11-999 мкс
0,01 мс	0,01-9,99 мс
0,1 мс	0,1-99,9 мс
1 мс	1-999 мс
0,01 с	0,01-9,99 с
0,1 с	0,1-99,9 с

3.7. Погрешность установки периода повторения серий основных прямоугольных импульсов и погрешность установки периода повторения сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной формы не превышает $\pm 0,03 T_c$ ($\pm 0,03 T$),

где T_c - установленный период повторения серий импульсов;

T - установленный период повторения сигналов пилообразной, треугольной или трапецидальной формы.

3.8. Период заполнения серий на внешней нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом) изменяется от 0,1 мкс до 9,99 с. Дискретность установки периода заполнения серий соответствует табл.5.

Таблица 5

Дискретность	Интервал периода
0,1 мкс	0,1-99,9 мкс
1 мкс	1-999 мкс
0,01 мс	0,01-9,99 мс
0,1 мс	0,1-99,9 мс
1 мс	1-999 мс
0,01 с	0,01-9,99 с

Период заполнения серий на внешней нагрузке 1 кОм (выносной блок) изменяется от 1 мкс до 9,99 с. Дискретность установки периода заполнения соответствует табл.6.

Таблица 6

Дискретность	Интервал периода
0,1 мкс	1-99,9 мкс
1 мкс	1-999 мкс
0,01 мс	0,01-9,99 мс
0,1 мс	0,1-99,9 мс
1 мс	1-999 мс
0,01 с	0,01-9,99 с

Генератор может выдавать на внешней нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом) основные одиночные импульсы с периодом повторения от 0,1 мкс до 99,9 с с дискретностью, указанной в табл.5.

3.9. Погрешность установки периода заполнения серий не превышает $\pm 0,03 T_{зс}$,

где $T_{зс}$ - установленный период заполнения серий.

3.10. Временной сдвиг серий основных импульсов и сигналов пилообразной, треугольной или трапецеидальной форм (по основанию) относительно синхроимпульса "1" изменяется от 0 до 999 мс. Дискретность установки временного сдвига соответствует табл.7.

Таблица 7

Дискретность	Интервал временного сдвига
0,1 мкс	0-99,9 мкс
1 мкс	1-999 мкс
0,01 мс	0,01-9,99 мс
0,1 мс	0,1-99,9 мс
1 мс	1-999 мс

3.11. Погрешность установки временного сдвига первого импульса серии или сигналов пилообразной, треугольной или трапецидальной форм (по основанию) относительно синхроимпульса "Г" не превышает $\pm(0,03 D + 0,02 \text{ мкс})$ для внешней нагрузки 50 Ом (выход 50 Ом) и $\pm(0,03 D + 0,06 \text{ мкс})$ для внешней нагрузки 1 кОм (выход выносного блока), при установке временного сдвига, равного 0 ($D = 0$), погрешность установки не превышает $\pm 0,03 \text{ мкс}$ для внешней нагрузки 50 Ом (выход 50 Ом) и $\pm 0,06 \text{ мкс}$ для внешней нагрузки 1 кОм (выход выносного блока), где D - установленный временной сдвиг.

3.12. Количество импульсов в серии регулируется от 1 до 9999 с дискретностью установки 1.

3.13. Длительность фронта и среза основных импульсов на внешней нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом) не превышает 10 нс, а на внешней нагрузке 1 кОм (выход выносного блока) - 100 нс.

3.14. Длительность фронта сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм изменяется от 10 мкс до 999 мс; длительность среза изменяется: для сигналов трапецидальной формы от 0 до 998 мс; для сигналов треугольной формы от 10 мкс до 998 мс; для пилообразной формы всегда устанавливается 0.

Дискретность установки длительности фронта и среза соответствует табл. 8.

Таблица 8

Дискретность	Интервал длительности
0,01 мс	0,01-9,99 мс
0,1 мс	0,1-99,9 мс
1 мс	1-999 мс

3.15. Погрешность установки длительности фронта и среза сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм не превышает $\pm 0,1 \tau_{\Phi}$ ($\tau_{\text{ср}}$), а при установке длительности среза равного нулю ($\tau_{\text{ср}} = 0$), погрешность установки не превышает 1 мкс,

τ_{Φ} - установленное значение длительности фронта;

$\tau_{\text{ср}}$ - установленное значение длительности среза.

3.16. Выбросы до фронта, за фронтом, до среза, за срезом основных прямоугольных импульсов не превышает $\pm 10 \%$.

3.17. Неравномерность вершины основных прямоугольных импульсов не превышает $\pm 5 \%$ по истечении 45 нс на внешней нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом) и 360 нс на внешней нагрузке 1 кОм (выход выносного блока).

3.18. Нелинейность фронта и среза (кроме $\tau_{\text{ср}} = 0$) сигналов

пилсообразной, треугольной и трапециевидальной форм не превышает $\pm 10\%$.

3.19. Сквозность основных импульсов в серии и серий импульсов на выходе I кОм (выход выносного блока) не менее 3. В режиме одиночных импульсов $K_{\text{имп}}-I$ на выходе выносного блока сквозность не менее 9.

3.20. Сквозность сигналов пилособразной, треугольной и трапециевидальной форм при установленной амплитуде менее 30 В не менее I, I, а при амплитуде от 30 до 99 В - не менее 9.

3.21. Генератор обеспечивает на соответствующих выходах прибора три синхрои импульса:

- синхрои импульс "I", совпадающий с тактовыми импульсами;
- синхрои импульс "II", совпадающий с первым импульсом серий;
- синхрои импульс "III", совпадающий с любым выбранным импульсом серии.

Синхрои импульсы "I", "II", "III" положительной полярности на внешних согласованных нагрузках 50 Ом имеют параметры, приведенные в табл. 9.

Таблица 9

Наименование параметров синхрои импульсов	Значение параметра
Амплитуда, В, не менее на нагрузке 50 Ом	I, 2
Длительность фронта, нс, не более на нагрузке 50 Ом	10
Длительность, нс, не более на нагрузке 50 Ом	50
Временной сдвиг синхрои импульса "I" относительно внешнего запускающего импульса, нс, не более	500
Временной сдвиг между синхрои импульсом "II" и первым импульсом серии или сигналом пилособразной, треугольной или трапециевидальной форм (по основанию) для выхода 50 Ом, нс, не более	20
для выхода выносного блока I кОм, нс, не более	60
Временной сдвиг между синхрои импульсом "III" и любым импульсом серии, с которым синхрои импульс "III" совпадает по номеру, для выхода 50 Ом, нс, не более	10
для выхода выносного блока I кОм, нс, не более	50

Наименование параметров синхросигналов	Значение параметра
Неравномерность исходного уровня на выходах синхросигналов "I", "II", "III", %, не более	± 10
Сопротивление внешних нагрузок выходов синхросигналов, Ом	50

3.22. Предусмотрены следующие режимы запуска: внутренний, разрывной, механический и внешний импульсами положительной или отрицательной полярности с амплитудой 1-9,9 В, длительностью от 50 нс до 999 мс, длительностью фронта не более 1 мкс, периодом повторения от одиночных импульсов до 1 мкс или синусоидальным напряжением с амплитудой 2-9,9 В, частотой 50 Гц - 1 МГц.

3.23. Сопротивление входа внешнего запуска (50 ± 5) Ом.

3.24. Мгновенная нестабильность (паразитная модуляция) временного сдвига основных импульсов серии относительно импульса внешнего запуска и длительности прямоугольных импульсов не превышает $\pm [0,005 D(\tau) + 4 \text{ нс}]$ на выходе 50 Ом и $\pm [0,005 D(\tau) + 30 \text{ нс}]$ на выходе 1 кОм, где $D(\tau)$ - установленное значение временного сдвига (длительности).

3.24а. Мгновенная нестабильность амплитуды основных импульсов не более $\pm(0,02A + 50 \text{ мВ})$ на выходе 50 Ом и $\pm(0,02A + 500 \text{ мВ})$ на выходе 1 кОм.

3.25. На выходе 50 Ом предусмотрено изменение величины базового смещения от минус 2 до плюс 2 В с дискретностью 0,1 В. При этом сумма постоянного и импульсного напряжения не должна превышать ± 10 В.

3.26. Погрешность установки величины базового смещения на внешней нагрузке 50 Ом не превышает $\pm(0,1E - 0,1 \text{ В})$, где E - установленная величина базового смещения.

3.27. Прибор может работать от канала общего пользования (КОП). Управляющие сигналы соответствуют двоичному коду TTL логики ("лог.0" - высокий уровень, амплитуда сигнала не менее 2,8 В; "лог.1" - низкий уровень, амплитуда сигнала не более 0,8 В).

При работе от КОП задаются значения всех параметров и устанавливаются любые режимы работы. Генератор реализует работу в системе электронных устройств и выполняет функции приемника ПЗ и синхронизации приема СП.

3.28. В приборе предусмотрена возможность записи десяти программ, которые хранятся при выключении прибора в течение 16 ч.
Примечание. После спецдействия допускается перепись программы (информации), т.к. происходит искажение информации.

3.29. Прибор имеет возможность автоматического изменения одного из параметров, кроме выбора вида запуска, изменения полярности выходных сигналов и режима работы.

3.30. Электрическая изоляция цепи сетевого питания прибора выдерживает без пробоя испытательное напряжение переменного тока с частотой 50 Гц значеннем, равным:

- 1500 В - в нормальных условиях;
- 900 В - в условиях повышенной влажности.

Сопротивление изоляции указанной цепи генератора относительно корпуса, МОм, не менее:

- в нормальных условиях 20;
- при повышенной относительной влажности 2;
- при повышенной температуре 5.

3.31. Прибор обеспечивает технические характеристики после времени установления рабочего режима, равного 15 мин, при рабочей температуре до минус 10 °С, а при рабочей температуре от минус 10 °С до минус 30 °С - равного 30 мин.

3.32. Питание: сеть переменного тока напряжением (220±22) В, частотой (50±0,1) Гц с содержанием гармоник до 5 %, напряжением (220±11) В, частотой (400±12) Гц с содержанием гармоник до 5 %.

3.33. Мощность, потребляемая от сети при номинальном напряжении, не более 180 В·А.

3.34. Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение 16 ч при сохранении своих технических характеристик.

Примечание. Время непрерывной работы не включает в себя время установления рабочего режима.

3.35. Прибор сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, приведенных выше в рабочих условиях эксплуатации, приведенных в п. 2.2.

3.36. Неработка на отказ не менее 3000 ч.

3.37. Гамма-процентный срок службы $T_{сл}$ не менее 15 лет.
Гамма-процентный ресурс T_p не менее 10000 ч.

3.38. Габаритные размеры, не более:

- прибора - 324x172x310 мм;
- выносного блока - 150x48x68 мм;
- ящика укладочного для прибора - 680x340x485 мм;
- ящика транспортного - 910x575x742 мм.

3.39. Масса, не более:

- прибора - 8,3 кг;

прибора и ЗИП в укладочном ящике - 30 кг;
 прибора и комплекта ЗИП в транспортном ящике - 75 кг.

4. СОСТАВ ПРИБОРА

4.1. Состав комплекта прибора приведен в табл.10.

Таблица 10

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1. Генератор импульсов Г5-79	3.269.093	I	
2. Ящик укладочный для ЗИП, в нем:	4.161.036-09	I	
кабель ВЧ	4.851.081-26 Сп	5	
нагрузка 50 Ом	2.727.197	4	P=2 Вт
нагрузка 1 кОм	2.727.205	I	P=4 Вт
блок выносной тройник НЧ	2.222.031	I	
	3.649.000	I	
ящика РИМ7-24ШК1-В	0.364.049-ТУ	X	Поставляется по требованию
рычаг	8.332.057	I	Приспособление для вынимания плат
рычаг	8.332.057-01	I	То же
кабель	4.853.222	4	Подключение
плата	3.660.142	I	плата
вставка плавкая ВП1-1-3А 250 В	0.480.003 ТУ	2	
индикатор			
ЗЛС324Б	0.339.103 ТУ	2	
светодиоды ЗЛ341Б	0.339.189 ТУ	2	
ЗЛ341Г	То же	I	
ЗЛ341Е	"-	I	
реле электромагнитное типа РЭК23	4.500.472-00.01		
	4.500.472 ТУ	I	
3. Плата устройства управления 3.723	3.051.000	I	
4. Плата формирователя выходного 3.724	2.035.113	I	

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть I	3.269.093 ТО	I	
6. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 2	3.269.093 ТОI	I	
7. Формуляр	3.269.093 ФО	I	
8. Ящик укладочный	4.161.226	I	Для приборов, поставляемых по требованию

На рис.2 приведены основные принадлежности из комплекта ЗИП.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

5.1. Принцип действия

Схема электрическая принципиальная генератора импульсов Г5-79 приведена в части 2 ТОI.

Электрическая структурная схема генератора Г5-79 представлена на рис.3.

Генератор состоит из следующих частей: устройства управления (2), воспринимающего входную информацию с кнопочного поля или канала общего пользования (КОП), записывающего и хранящего ее в памяти, обрабатывающего и выдающего ее в устройстве цифровой индикации, делитель (ДПКД) (4, 5), выходной формирователь (6), стабилизатор (7) и выносной блок (8);

блока индикации (I), содержащего кнопочное поле, вырабатывающего код нажатой кнопки, сопровождаемый синхримпульсом, и высвечивающего информацию, поступающую с устройства управления (2);

делителя ДПКД (4, 5), формирующего временные интервалы (длительность, период повторения серий, период заполнения серий, временной сдвиг, количество импульсов в серии), обеспечивающего режимы запуска (внутреннего, внешнего и разового механического) и выдающего синхримпульсы ("I", "II", "III");

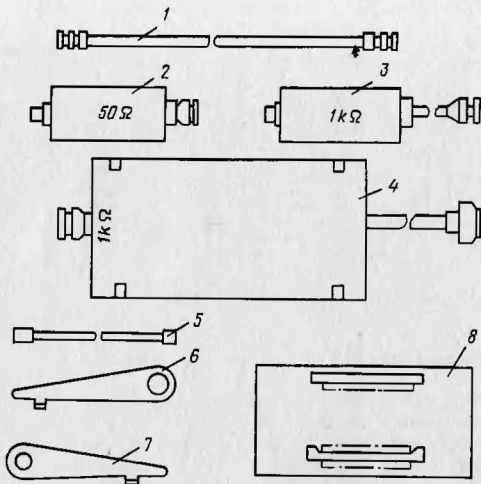


Рис.2. Основные принадлежности комплекта ЭИП:

1 - кабели Вч; 2 - нагрузка 50 Ом; 3 - нагрузка 1 кОм; 4 - блок выносной; 5 - кабели; 6 - рычаг; 7 - рычаг; 8 - плата

выходного формирователя (6), необходимого для получения амплитуды и формы выходного сигнала;

выносного блока (8), формирующего сигналы с амплитудой ст 10 до 99 В;

устройства сопряжения с каналом общего пользования (КОП) (3), обеспечивающего работу прибора в автоматизированных измерительных системах;

блока питания: преобразователя, выпрямителей и стабилизатора (7), обеспечивающего напряжениями, необходимыми для работы генератора.

5.2. Схема электрическая принципиальная

5.2.1. Устройство управления. Устройство управления (УУ)

принимает информацию с режиме работы генератора, вводимую с кнопочного поля или с канала общего пользования (КОП), записывает и хранит эту информацию в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ), встроенном в однокристалльный микропроцессор (ММП), производит необходимые преобразования введенной информации, проверяет коррект-

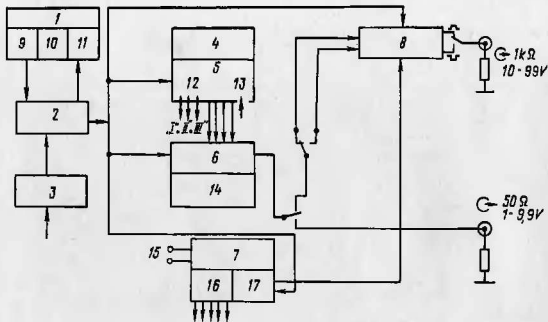


Рис.3. Схема электрическая структурная генератора Г5-79:
 I - блок индикации; 2 - устройство управления; 3 - КОП; 4 - автомат управления ДПКД; 5 - ДПКД; 6 - выходной формирователь; 7 - блок питания; 8 - выносной блок; 9 - кнопочное реле; 10 - ОЗУ; 11 - устройство цифровой индикации; 12 - выход "синхр"; 13 - вход "внешн.запуск"; 14 - базовое смещение; 15 - сеть; 16 - выпрямитель; 17 - стабилизатор

ность заданных параметров и, в случае условий корректности, выдает информацию в двоичном коде по адресно-информационной магистрали на следующие устройства (рис.3):

- блок индикации (I);
- делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД) (4, 5);
- выходной формирователь (6);
- КОП (3).

Схема электрическая принципиальная УУ приведена в части 2 ТО1. Функциональная схема УУ приведена на рис.4.

УУ состоит из следующих функциональных блоков:

- однокристалльный микропроцессор (ОМП);
- внутренний шинный формирователь (ШФ1);
- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ);
- генератор тактовых импульсов (ГТИ);
- схема начального пуска ОМП;
- внешний шинный формирователь со схемами управления (ШФ2);
- регистр адреса (Р·А);
- дешифратор адресов исполнительных устройств (ДАИУ);
- формирователь импульсов записи в ДПКД и выходной формирователь (ФИЗ).

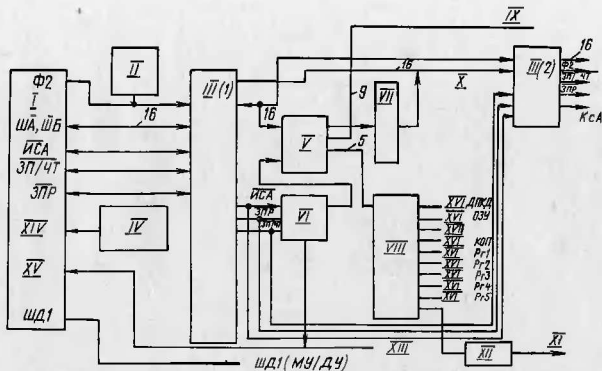


Рис.4. Схема электрическая функциональная УУ: I - ОМІ; II - генератор ГИМ; III - шинный формирователь; IV - схема начального пуска; V - регистр адреса; VI - ложка управления; VII - ПЗУ; VIII - ДАМУ; IX - адресная магистраль; X - информационная магистраль; XI - импульс записи в ДПКД; XII - ФИЗ; XIII - сигнал "ответ"; XIV - сигнал "пуск"; XV - сигнал "ответ"; XVI - адрес; XVII - адрес клавиатуры

ОМІ (микросхема УЗ) представляет собой 16-разрядную микроЭВМ с возможностью наращивания внешней памяти (ВП). Для подключения ВП служат следующие шины:

- шина А (ША);
- шина Б (ШБ);
- шина-импульс сопровождения адреса (ИСА);
- шина-запрос внешней памяти (ЗПР);
- шина-запись/чтение (ЗП/ЧТ);
- шина-ответ ВП.

При работе ОМІ с ВП сигналы ЗПР и ЗП/ЧТ снимаются после прихода сигнала "ответ" через два такта Ф2.

Временная диаграмма работы ОМІ с ВП приведена на рис.5.

Распределение адресов памяти приведено в табл.11.

ПЗУ построено на микросхемах 556PI7, по электрическим и временным параметрам согласованных с ОМІ. Выборка соответствующей микросхемы осуществляется с помощью дешифратора страниц ПЗУ, выполненного на микросхеме У17. "Ответ" формируется при помощи микросхем У8-2, У19-2, У8-3.

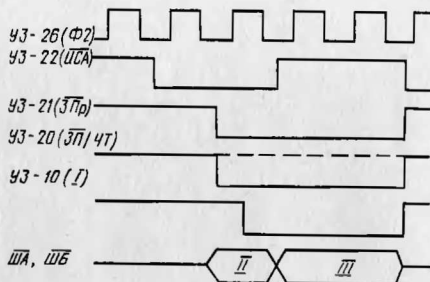


Рис.5. Временная диаграмма работы ОМП с ВП:
 I - ответ; II - адрес ВП; III - информация ОМП \rightleftharpoons ВП

Внутренний шинный формирователь (ШФ1) построен на ИС У4-У6 и отделяет ОМП от логической части платы.

Генератор тактовых импульсов (ГТИ) выполнен на микросхемах У1, У2-1.

Схема начального пуска предназначена для пуска ОМП при включении питания. Построена она на конденсаторах С2...С7 и резисторе R2.

После включения питания формируется перепад от I В до 0, запускающий процессор.

Внешний шинный формирователь (ШФ2) предназначен для усиления сигналов, выдаваемых ОМП, по шинам: ША, ШБ, ИСА, ЗПР, ЗП/ЧТ, Ф2. ШФ2 построен на микросхемах У20...У23 (усиливает сигналы ША, ШБ), У24 - (усиливает сигналы ИСА, ЗПР, ЗП/ЧТ, Ф2).

Схема управления построена на микросхемах У18, У19, У12-3, У2-2.

Регистр адреса (Р-А) выполнен на микросхемах У9, У10. Запись в регистр производится импульсом, сформированным на микросхемах У11-1, У12-1.

Формирователь импульса записи (ФИЗ) выполнен на микросхемах У11-3, У25, У19-4.

Распределение адресов памяти

Адрес (в шестнадцатиричной системе счисления)	Адресное устройство
0000-00FF	Внутреннее ОЗУ ОМП
1000-1FFF	Внешнее ПЗУ (У13, У14)
2000-2FFF	Внешнее ПЗУ (У15, У16)
3000	Адрес РГ1
3800-39FF	Внешнее ОЗУ
4000, 4007, 400B, 400E, 400D	Адрес кнопочного поля
4800-480F	Регистры ДПКД и выходного формирователя
5000-500F	Регистры платы КОП
5800	Адрес РГ2
6000	Адрес РГ3
6800	Адрес РГ4
7000	Адрес РГ5


Укрупненный алгоритм программы приведен на рис.6.

При включении прибора выполняются операции тестового контроля и наличие настройки программы, после чего управление передается блоку I программы.

В этом блоке анализируется значение сигнала ДУ1 от платы КОП и, в зависимости от него, производится настройка прибора на работу с кнопочного поля или канала общего пользования.

В блоке 2 анализируется факт нажатия какой-либо из кнопок клавиатуры или поступление информации с КОП. Информация с КОП поступает непосредственно в коде КОИ-7, а информация с кнопочного поля преобразуется в этот код в соответствии с табл.12.

Реакция программы на принятый код определяется значением этого кода, т.е. той кнопкой клавиатуры, которая нажата.

При нажатии кнопки "  " изменяется режим работы генератора (режим генерации серий прямоугольных импульсов заменяется режимом генерации одиночных сигналов пилообразной, треугольной или трапециoidalной формы, или наоборот) и ожидается ввод параметров генерации.

При нажатии кнопки ЗАПУСК запоминается нажатие этой кнопки, и управление передается блоку 3. В этом блоке ожидается ввод значения параметра запуска (ПЗ).

Значение ПЗ = 1 соответствует внутреннему запуску генератора; ПЗ=2 - внешний запуск положительным импульсом или синусоидальным сигналом;

ПЗ=3 - внешний запуск отрицательным импульсом;

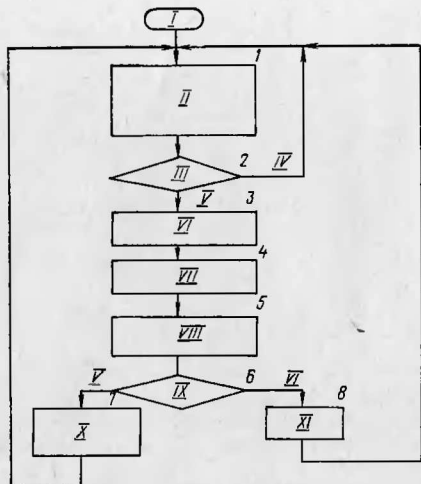


Рис.6. Алгоритм управляющей программы:

I - начало; II - ожидание нажатия кнопки клавиатуры или поступления информации с КОП; III - кнопка нажата; IV - команда "нет"; V - команда "да"; VI - ввод параметров, выдача на информацию; VII - преобразование параметра; VIII - проверка корректности задания параметров; IX - условия корректности выполнены; X - загрузка параметров в исполнительные блоки; XI - индикация ошибки

ПЗ=4 - разовый пуск.

При работе в режиме разового пуска для повторного запуска достаточно нажимать только кнопку "4" (не нажимая каждый раз кнопку ЗАПУСК).

Таблица 12

Кодирование кнопок клавиатуры генератора

Кнопка	Символ	Код символа шестнадцатичной системы счисления	Кнопка	Символ	Код символа шестнадцатичной системы счисления
T_c/T	P	50	μs	B	42
τ	T	54	ms	P	46
A	U	55	s	C	43
E	W	57	СУ	C	47
T_{sc}/τ_{Φ}	R	52	\vee	@	40
№ СИ	V	56	\wedge	D	44
D	S	53	ПРИМ	J	4A
$K_{имп}/\tau_{ср}$	Q	51	⏏	H	48
0	0	30	ЗАПУСК	A	41
1	1	31	ВЫХОД	E	45
2	2	32			
3	3	33			
4	4	34			
5	5	35			
6	6	36			
7	7	37			
8	8	38			
9	9	39			
,	,	2E			
$\pm E$:	3A			

Примечание. Все символы – буквы латинского алфавита.

В блоке 4 значение ПЗ преобразуется в унитарный код, затем управление передается блоку 5.

Параметр, вводимый кнопкой ВЫХОД, обрабатывается аналогично параметру, вводимому кнопкой ЗАПУСК. Параметр выхода (ПВ) может принимать следующие значения:

ПВ=1 – выходной импульс неинвертированный положительный.

ПВ=2 – выходной импульс инвертированный положительный,

ПВ=3 – выходной импульс неинвертированный отрицательный,

ПВ=4 – выходной импульс инвертированный отрицательный.

При нажатии кнопки ПРИМ запоминается факт нажатия этой кнопки, и анализируется следующий вводимый символ. Если этим символом

будет цифра от 0 до 9, то из ОЗУ считывается программа с указанным номером, и начинается генерация импульсов с параметрами, заданными в вызываемой программе. Если вторым (после ПРТМ) символом будет "СУ", то ожидается ввод третьего символа, который должен быть цифрой от 0 до 9. При поступлении этого символа производится запись предварительно введенных параметров генерации в ОЗУ в качестве программы с указанным номером.

При нажатии кнопок " $>$ " или " $<$ " производится настройка генератора на режим автоматической работы. Можно задать режим разового автомата, нажав два раза любую кнопку направления автомата " $>$ ", " $>$ " или " $<$ ", " $<$ " или " $>$ ", " $<$ ". Если следующим (после " $>$ " или " $<$ ") символом оказывается ПРТМ, то из памяти последовательно считываются программы генерации с заданной по нулевую или девятую, осуществляется генерация импульсов, записанных в вызванной программе, затем считывается программа со следующим номером, и процесс повторяется, причем после нулевой или девятой вновь вызывается заданная программа.

Если после кнопки " $>$ " или " $<$ " нажимается кнопка с наименованием того или иного параметра (кроме СУ, ЗАПУСК и ВЫХОД), то ожидается ввод цифры. После ввода цифры начинается автоматическое изменение значения указанного параметра от исходного до максимального (или минимального) или до нарушения условия корректности, после чего процесс начинается вновь.

Направление изменения значения параметра в режиме автоматической работы определяется тем, какая из кнопок " $>$ " или " $<$ " была нажата (" $>$ " соответствует увеличению; а " $<$ " - уменьшению значения параметра). Величина приращения равна единице того разряда, который был указан введенной цифрой.

В режиме разового автомата оператор управляет увеличением или уменьшением параметра на единицу в указанном разряде, нажимая каждый раз кнопку " $>$ " или " $<$ ".

Автоматическая работа генератора может быть остановлена нажатием кнопки СУ. Если оператор нажимает кнопку с наименованием параметров (T_c , T , τ , T_{2c} , t_f , D , t_{cp} , A , E , $\% СИ$, $K_{имп}$), то значение данного параметра вызывает на индикацию, и в блоке 3 осуществляется ввод нового значения этого параметра. Признаком конца ввода является нажатие кнопок μs , ms или s (для временных параметров) или СУ (для амплитудных (A , E) и $\% СИ$, $K_{имп}$).

Кнопки незначащих нулей можно не нажимать.

Если при вводе значения параметра оператор обнаруживает, что он ошибся, то он может начать ввод значения параметра заново, не нажимая кнопки параметра.

В блоке 4 введенные значения переводятся в двоичную систему счисления, из значений $K_{имп}$ и $\% СИ$ вычитается 1. Временные пара-

метра преобразуются в форму с десятичным порядком и двоичной мантиссой, причем значения τ_{ϕ} и $\tau_{ор}$ делятся на 99.

В блоке 5 проверяется корректность задания параметров по следующим соотношениям:

1) параметры запуска (ПЗ) и выхода (ПВ) лежат в диапазоне от I до 4;

2) значения всех параметров лежат в диапазоне от минимального до максимального значения, определенных ТУ;

3) для режима генерации сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной формы, а также в режиме генерации серий прямоугольных импульсов, когда $A \geq 10 B$, определены только неинвертированная положительная и неинвертированная отрицательная полярность выходного сигнала (ПВ = 1, ПВ = 3);

4) в режиме генерации серий прямоугольных импульсов:

$$T_{зс} \geq \tau \quad \text{при } A < 10 B$$

$$T_{зс} \geq 3\tau \quad \text{при } A \geq 10 B$$

$$\# СИ < K_{имп}$$

$$T_c \geq (D + K_{имп} \cdot T_{зс}) \quad \text{при } A < 10 B$$

$$T_c \geq (D + 3K_{имп} \cdot T_{зс}) \quad \text{при } A \geq 10 B.$$

5) в режиме генерации сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной формы:

$$T > D + \tau \quad \text{при } A < 30 B$$

$$T > D + 3\tau \quad \text{при } A \geq 30 B.$$

В блоке 6 анализируется результат проверки корректности в блоке 5, и в зависимости от него управление передается блоку 7 или блоку 8. В блоке 8 на индикатор ошибки поступает код в соответствии с табл. I3, указывающий, какое из соотношений корректности было нарушено, из блока 7 поступают значения параметров в виде форматов информации на исполнительные платы генератора в соответствии с табл. I4.

После запуска генерации управление вновь передается блоку I, в котором программа ожидает поступления новой управляющей информации о кнопочного поля или КОП.

Коды ошибок

Таблица I3

Код ошибки	Причина ошибки	Реакция программы
0	Нет ошибок	Запуск генерации
1	Взаимное несоответствие параметров генерации (нарушены соотношения 4 или 5)	Генерация ранее установленного режима
2	Оператор нажал не ту кнопку	Введенный символ игнорируется

Код ошибки	Причина ошибки	Реакция программы
3	Инверсный выходной сигнал запрещен для заданного режима (нарушено соотношение 3)	Генерация ранее установленного набора
4	Сбой информации при считывании из ПРГМ	Генерация ранее установленного режима
5	Параметр выходит за пределы изменения (нарушены соотношения I или 2)	Генерация ранее установленного набора

5.2.2. Блок индикации. Блок цифровой индикации предназначен для ввода параметров с передней панели прибора (кнопочные поля) или местного управления, выбора режимов работы (режимов запуска и выхода), а также индикации числовых значений параметров, единиц измерений и режимов работы.

Таблица 14

Форматы информации, выдаваемой на исполнительные платы генератора

Абонент	Адрес	Разрядность	Число тактов заполнения	Формат информации
Регистр режима	4800	6	1	Разряды I0-I3 адреса записи в ОЗУ I4-I5 режимы работы "автомата управления ДПКД"
Формирование ручного запуска	4801	1	1	
Регистр параметров платы "Делитель"	4802	4	8	Разряды I2-I5 информация о $K_{\text{мпц}}$ и $N_{\text{СИ}}$
Регистр параметров плат автомата и выходного формирователя	4803	4	7	Разряды I2-I5 информация об амплитуде и признаках настройки платы автомата ДПКД и выходного формирователя

Абонент	Адрес	Разрядность	Число тактов заполнения	Формат информации
Младшая тетрада \emptyset внутреннего ЗУ	4804	4	I	
Тетрада I внутреннего ЗУ	4805	4	I	
Тетрада 2 внутреннего ЗУ	4806	4	I	
Тетрада 3 внутреннего ЗУ	4807	4	I	



В состав его входят устройство цифровой индикации (3.715) и устройство оперативное запоминающее (ОЗУ) (3.731).

Функциональная схема блока индикации представлена на рис.7.

Схемы электрические принципиальные устройства цифровой индикации 3.715 и ОЗУ 3.731 приведены в части 2 ТО1.

На плате 3.715 расположены кнопки, образующие поля кнопок (6) прибора с коммутатором (7), регистры (8) в качестве запоминающего устройства, дешифраторы (9), преобразующие информацию в семисегментный код для индикаторов, цифровые индикаторы (10) и светоизлучающие диоды (11).

Все кнопки прибора разбиты на три поля.

1-е поле (параметры) содержит кнопки, имеющие одинарную или двойную гравировку, позволяющую осуществлять набор параметров одними и теми же кнопками в двух режимах работы: в режиме серии прямоугольных импульсов (I)  и в режиме сигналов пилообразной, треугольной или трапециoidalной форм (II) .

Кнопки, имеющие одинарную гравировку, предназначены либо для набора параметров только режима серии прямоугольных импульсов (кнопки № СИ, Е, ±Е), либо для обоих режимов (кнопки D, τ, А).

Для кнопок с двойной гравировкой верхний ряд гравировки соответствует параметрам режима серии, а нижний ряд - режиму сигналов пилообразной, треугольной или трапециoidalной форм.

2-е поле (цифровое) содержит кнопки, служащие для набора числового значения параметра).

3-е поле содержит следующие кнопки единиц измерения временных параметров (с, мс, μс);

" > ", " < " - служат для выбора знака приращения в режиме автоматического изменения параметра;

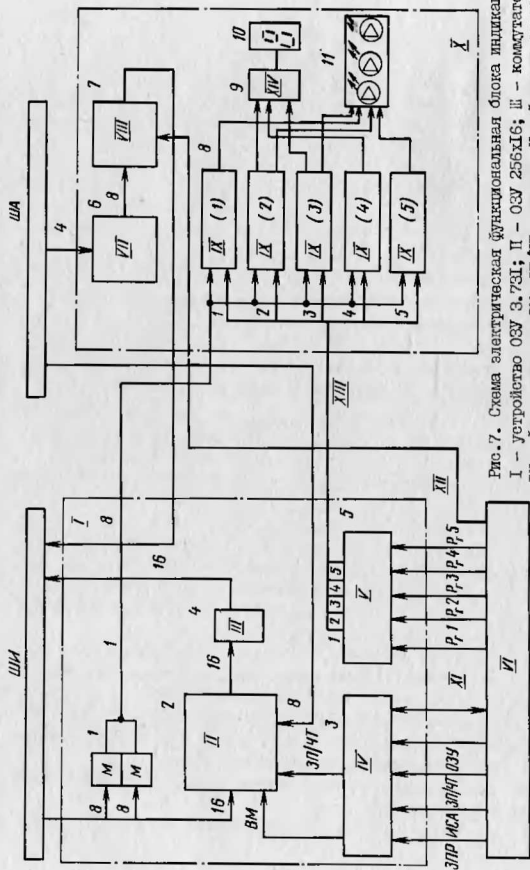



Рис. 7. Схема электрическая функциональная блока индикации:
 I - устройство ОЗУ 3.731; II - ОЗУ 256x16; III - коммутатор;
 IV - формирователь ВМ, ЭЛ/ЧТ, отвеса; V - формирователь
 цифровой индикации 3.715; VI - сигнал "ответ" XII - сигнал "отвечать"
 VII - поле кнопок; VIII - коммутатор; IX - регистр; X - устройство
 адрес клавиатуры; XI - сигнал "адрес клавиатуры"; XII - сигнал "отвечать";
 XIII - дешифратор

ПРГМ - при нажатии этой кнопки с последующим нажатием одной из цифр от 0 до 9 (номер выбранной программы) в приборе устанавливаются наперед заданные параметры в соответствии с номером выбранной программы, если запись программ была произведена; если же после нажатия этой кнопки, нажимают кнопку СУ и цифру любую от 0 до 9, то производят запись в программу.

"  " - кнопка выбора режима работы (I или II). При нажатии этой кнопки режим меняется на противоположный. В режиме работы генератора можно судить по расположению светодиодов; верхний ряд светодиодов относится к режиму серии импульсов (I), нижний ряд светодиодов относится к режиму сигналов пилообразной, треугольной или трапециевидальной форм (II).

Если на передней панели горит хотя бы один светодиод верхнего ряда ($T_c, T_{zc}, D, \tau, \# \text{СИ}, K_{\text{имп}}, A, E$) - значит установлен режим I; если горит диод нижнего ряда ($T, \tau_{\phi}, \tau, \tau_{cp}, D, A$) - установлен режим II.

ЗАПУСК - для выбора режима запуска прибора (внутренний, внешний положительными, отрицательными импульсами или синусоидальным напряжением и ручной механический).

ВЫХОД - для выбора полярности выходного сигнала (неинвертированного или инвертированного) для режима серии, или выбора формы сигнала ("пила", "трапеция", "треугольник") для режима линейно-изменяющихся сигналов.

Кроме того, цифровое кнопочное поле, помимо цифр и запятой, содержит кнопку СУ, имеющую несколько функций:

1) при наборе параметра, имеющего неизменяемую единицу измерения, например, амплитуда, признаком конца набора параметра является нажатие кнопки СУ;

2) при занесении параметров в память (заполнения программ) после нажатия кнопки ПРГМ перед значащей цифрой от 0 до 9 нажимается кнопка СУ;

3) в режиме автоматического изменения параметров (" $>$ " или " $<$ ") при нажатии кнопки СУ прекращается автоматическое изменение параметра.

На плате 3.73I (устройство ОЗУ) расположены: ОЗУ (2) с коммутатором (4) для хранения информации с последующим выводом ее на индикацию (всех 10 программ).

мультиплексоры для преобразования 15-разрядного параллельного кода в последовательный для регистров, хранящих информацию для цифровых индикаторов и светодиодов (1); формирователь сигналов БМ (выбор микросхемы), ЗП/ЧТ, "ответ" (3), формирователь стробирующих импульсов (5) для продвижения информации в регистрах.

Рассмотрим работу отдельных узлов плат индикации.

Кнопки в количестве 30 штук, расположенные на плате 3.715, включены по матричной схеме (8x4). Горизонтальные шины этой матрицы подключены к адресной шине, в которой используются младшие разряды адресов ША15-ША12.

Когда происходит опрос кнопок, на горизонтальные шины последовательно подаются адреса 0111, 1011, 1101, 1110, а на шину АДК (адрес клавиатуры) подается "лог.1" с платы устройства управления. Если при этом ни одна кнопка не нажата, на всех вертикальных шинах удерживается "лог.1", и на всех выходах микросхем У1 и У2 устанавливается низкий потенциал "лог.0". Если в момент опроса будет нажата одна из кнопок, то на одной из вертикальных шин установится "лог.0" и на соответствующем ей выходе микросхемы У1 или У2 установится "лог.1".

Полученный таким образом 8-разрядный код с выходов микросхем У1 и У2 поступает на информационную магистраль.

Этот 8-разрядный код состоит из семи "0" и одной "1", соответствующей той вертикальной шине, в которой находится нажатая кнопка. Конкретно нажатая кнопка в этой вертикали определяется той горизонтальной шиной, на которой в момент нажатия кнопки был выставлен адресный код, содержащий "0" (все остальные горизонтальные шины в этот момент имеют адрес, содержащий только "1").

Индикация параметров осуществляется следующим образом.

В качестве запоминающего устройства для хранения параметров, предназначенных для индикации, выбрано 16-разрядное ОЗУ, выполненное на 16 микросхемах (256x1) и расположенное на плате 3.731. Для обращения к 256 ячейкам этого ОЗУ требуется 8-разрядный адрес ША14-ША7, который формируется в плате управления и по адресной шине поступает на адресные входы ОЗУ. Информация с ШИ поступает на информационные входы ОЗУ (И15-И0). Для ОЗУ цикл записи (время между сменой адресных сигналов) должен быть не менее 2,5 мкс, поэтому формирование сигналов ВМ и "ответ" должно производиться с учетом цикла записи.

Рассмотрим формирование сигналов ВМ и "ответ" (см. временные диаграммы рис.8).

На информационный вход триггера микросхемы поз.У7 приходит "лог.0" по окончании сигнала ИСА, в результате на инверсном выходе триггера устанавливается "лог.1". Положительный перепад с выхода триггера поступает на одновибратор, собранный на микросхеме поз.У10, где происходит формирование импульса длительностью 2 мкс. Если происходит запись информации в ОЗУ, на шине ЗП/ЧТ устанавливается уровень "лог.1", который разрешает прохождение импульса 2 мкс на выход микросхемы поз.У13-1. Если происходит чтение информации из ОЗУ, на шине ЗП/ЧТ выставляется "лог.0" и на выходе микросхемы поз.У13-1 будет "лог.1". С выхода микросхемы поз.У13-1

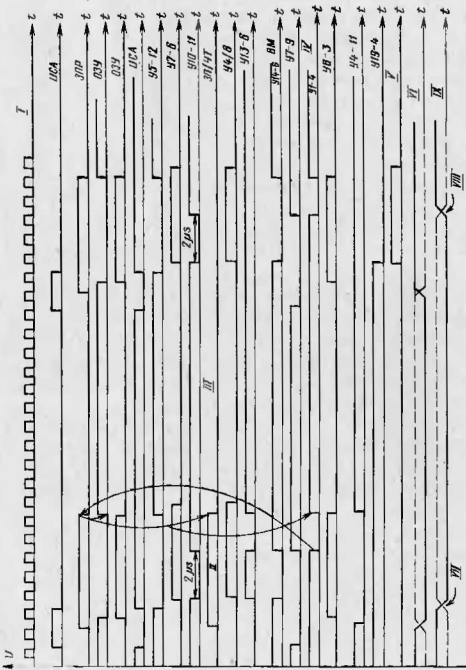


Рис.8. Временные диаграммы формирования сигналов "ГМ" и "ответ" при обращении к ОСУ в режимах записи и чтения:
 I - информация "такт"; II - информация "запись"; III - информация "чтение"; IV - информация "ответ"; V - информация "входы коммутаторов УЗ6-УЗ9"; VI - информация "адресные сигналы"; VII - информация выставленная ОСУ; VIII - информация выставленная ШМ

сигнал подается на вход микросхемы поз.У14 с открытым коллектором, на которой непосредственно формируется сигнал ВМ. Кроме того, на микросхему У14 приходит разрешающий сигнал ("лог.1") с микросхемы поз.У6-2. Когда происходит обращение к ОЗУ, на шине ОЗУ устанавливается "лог.0", соответственно на выходах микросхем поз.У4-1 и У6-1 "лог.1". Если происходит обращение по любому другому адресу, на шине - "лог.1", соответственно на выходах микросхем У4-1 и У6-1 - "лог.0", который удерживает выход микросхемы У14, а следовательно и сигнал ВМ в состоянии "лог.1".

Таким образом, на выходе микросхемы поз.У14 формируется сигнал ВМ с уровнем "лог.0", который при записи в ОЗУ равен 2 мкс, а при чтении из ОЗУ "лог.0" удерживается все время от конца действия импульса ИСА до момента окончания сигнала ЗПР.

Сигнал ЗПР удерживается в состоянии "лог.1" до тех пор, пока микропроцессор не получит сигнал "ответ" от устройства, к которому было обращено (в нашем случае ОЗУ).

Формирование сигнала "ответ" производится на триггере (микросхема поз. У7-2) и схеме "И" с открытым коллектором (микросхема поз. У1-2).

Появление сигнала "ответ" характеризуется установкой уровня "лог.0" на выходе микросхемы У1-2, который до этого все время удерживается в состоянии "лог.1". С приходом отрицательного перепада по шине "ответ" микропроцессор через 2 такта онамает сигнал ЗПР (переводит его в состояние "лог.0"), что в свою очередь приводит сигнал "ответ" в исходное состояние ("лог.1").

Информация, записанная в ОЗУ с инверсного выхода (контакт I4), поступает на выходной коммутатор, собранный по схеме "И" с открытым коллектором (микросхемы поз. У36-У39). Кроме информации с ОЗУ на выходные коммутаторы поступает управляющий сигнал, формируемый на микросхеме поз. У13-2.

Когда происходит запись информации в ОЗУ, управляющий сигнал удерживается в состоянии "лог.0", а следовательно все выходы микросхем поз. У36-У39 - в состоянии "лог.1". Так как все выходы коммутаторов подключены к ШИ, то высокий уровень "лог.1" на их выходах не будет预备товать информации на ШИ, выдаваемой микропроцессором. В случае чтения информации из ОЗУ управляющий сигнал находится в состоянии "лог.1", и следовательно сигнал с выхода ОЗУ проходит на выходы микросхем поз. У36-У39 и на ШИ. Кроме того, сигнал с выходов микросхем поз. У36-У39 поступает на 2 коммутатора "восемь в один" (микросхемы поз. У16, У17), которые управляются выходными сигналами (1, 2 и 3 разрядами) четырехразрядного счетчика на микросхеме поз. У8.

С выходов этих коммутаторов сигнал поступает на вход логической схемы (микросхема поз. У19), управляемой четвертым (старшим)

разрядом счетчика. Происходит преобразование 16-разрядного параллельного кода в последовательный код, который передается за 16 тактов, причем за первые 8 тактов на выход микросхемы У6-4 происходит сигнал с выхода микросхемы поз. У16, а за вторые 8 тактов с выхода микросхемы У17.

Этот сигнал через разъем Ш поступает на плату 3.715 на входы I регистров (микросхемы поз. У3, У7, У20, У30, У46). Все регистры, расположенные на плате 3.715, разбиты на 5 групп, на каждую из которых приходит свой тактовый сигнал, формируемый на плате 3.731 на микросхемах поз. У12 и У3-4.

Когда происходит обращение к регистрам, на плате управления формируется признак обращения "лог.0" последовательно по всем группам регистров: АдРг₁, АдРг₂, АдРг₃, АдРг₄, АдРг₅.

Так как каждая группа состоит из четырех 4-разрядных регистров, обрезующих один 16-разрядный регистр, для последовательной записи информации во все 16 разрядов требуется 16 тактовых импульсов (стробов). Эти стробы формируются на плате 3.731 (см. временную диаграмму на рис.9).

Схема формирования работает следующим образом. На выходе микросхемы поз. У5-1 до окончания импульса ИСА удерживается высокий потенциал ("лог.1"), который устанавливает счетчик (микросхема поз.У8) в нулевое состояние. Этот же сигнал, инвертируясь на микросхеме поз. У15-2, устанавливает триггер на микросхеме поз. У9 в нулевое состояние (по инверсному выходу состояние "лог.1"). По окончании сигнала ИСА на выходе микросхемы поз. У5-1 конт.6 устанавливается "лог.0", разрешающий счетчику счет. Триггер на микросхеме поз. У9 включен по схеме триггера со счетным входом, его тактовый вход (контакт I2) подключен к выходу старшего разряда счетчика. Когда на контакт I2 микросхемы поз. У9 придет отрицательный перепад, по времени совпадавший с 16-м импульсом тактовой последовательности на входе счетчика, триггер на микросхеме поз. У9 перебросятся в противоположное состояние (на контакте 6 установится "лог.0"). Вследствие этого на выходе микросхем поз. У5-3 и У3-2 прекратится тактовая последовательность.

Таким образом, триггер поз. У9 является "воротами", которые пропускают только 16 тактовых импульсов при каждом обращении к регистрам АдРг₁ - АдРг₅.

Адреса регистров АдРг₁ - АдРг₅ приходят с платы управления с уровнем "лог.0", далее проходят через инверторы на микросхеме поз.У11 и с уровнем "лог.1" поступают на входы микросхем поз.У12 и У3-4. На одном из выходов этих микросхем посылаются пакеты из 16 тактовых импульсов (строб I - строб 5), на остальных четырех выходах - "лог.1".

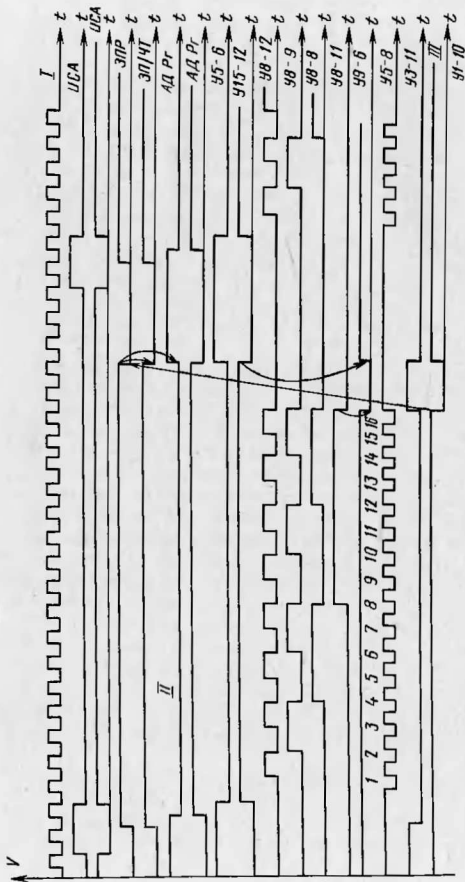


Рис. 9. Временные диаграммы формирования сигналов "ответ" и "строб" - импульсов при обращении к регистрам индикации;
 I - информация "такт"; II - информация "запись"; III - информация "ответ"

Ответ при этом формируется на микросхемах поз.У1-2 и У1-3 и вырабатывается после прохождения 16 тактовых импульсов (одновременно с переключением триггера на микросхеме поз.У9).

Сформированные на плате 3.731 16 импульсов (строб I и строб 5) поступают на контакт 9 регистров платы 3.715, а на контакт I этих регистров приходит информация в последовательном коде. Происходит запись информации в регистры, выходы которых подключены либо к светодиодам, либо через дешифраторы к цифровым индикаторам.

5.2.3. Делитель частоты (ДПКД). Схемы электрические принципиальные делителя частоты (ДПКД) (плата 3.728 и 4.384) приведены в части 2 ТОГ.

Электрическая структурная схема делителя частоты (ДПКД) представлена на рис.10 и содержит:

- LS - генератор - I;
- схему управления запуском - 2;
- ДПКД-таймер с управлением, схемами масштабного делителя и мультиплексором - 3;
- регистры настройки - 4;
- делители с переменным коэффициентом деления (ДПКД $K_{\text{имп}}$, ДПКД № СИ) - 5;
- схему формирования синхроимпульсов - 6;
- схему выработки функций выходов (импульса запуска, обрыва и серий импульсов) - 7;
- триггера пуска-останова - 8;
- схему формирования признака конца последовательности - 9;
- схему выработки функций возбуждения - 10;
- блок J-K триггеров - 11;
- ОЗУ параметров - 12.

Схема делителя частоты (ДПКД) расположена на двух платах: делитель частоты (ДПКД) 3.728 и автомат управления ДПКД 4.384.

На плате 3.728 расположены: регистры настройки, ОЗУ параметров, ДПКД $K_{\text{имп}}$, ДПКД № СИ, ДПКД-таймер со схемой управления, масштабными делителями и мультиплексором.

На плате 4.384 расположены: LS-генератор, схема управления запуском, триггер пуска-останова, схема выработки функций возбуждения, блок J-K триггеров и схема выработки функций выходов.

Исходная информация для временного блока подготавливается микроЭВМ и записывается в регистры настройки и ОЗУ. Генератор должен формировать выходные импульсы напряжения с дискретностью до 50 нс в широком температурном диапазоне при существенных ограничениях в габаритах и потребляемой мощности.

Элементной базой прибора является ТТЛ-логика, работающая на частоте, близкой к предельной. Этим объясняется сложность структурного решения временного блока.

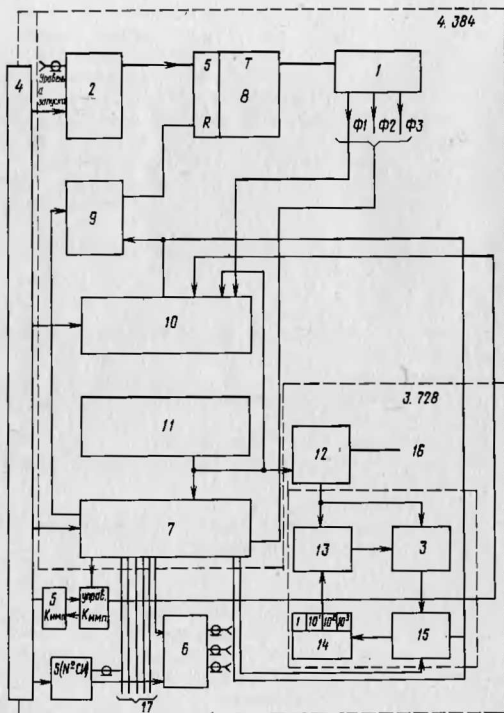


Рис.10. Схема электрическая структурная делителя:

1 - LC - генератор; 2 - схема управления запуском; 3 - ДПКД таймер; 4 - регистры настройки; 5 - ДПКД; 6 - схема формирования синхронимпульса; 7 - схема выработки функций выводов; 8 - триггер пуска - останова; 9 - схема формирования признака конца последовательности; 10 - схема выработки функций возбуждения; 11 - блок Т-К триггеров; 12 - ОЗУ параметров; 13 - мультиплексор; 14 - масштабный делитель; 15 - блок управления таймером; 16 - шины ИЗС; 17 - выходные сигналы

Запоминающее устройство хранит данные для обработки интервалов, начиная с 200 нс.

В связи с ограниченным быстродействием ОЗУ интервалы до 200 нс обрабатываются схемой управления таймера, а признаки нулевого и 100 нс интервалов хранятся в регистрах настройки.

Кроме того, в регистрах настройки хранятся признаки запуска, работы: $K_{\text{имп}} = 1$, $\% \text{СИ} = 1$ и код адреса ОЗУ.

Адрес ОЗУ формируется блоком J-к триггеров, являющихся памятью автомата управления. В процессе обработки временной последовательности автомат переходит из одного состояния в другое состояние. В каждом состоянии с помощью таймера обрабатывается заданная длительность интервала. При длительности, начиная с 200 нс, код состояния автомата используется как код адреса считывания из ОЗУ.

Из ОЗУ считывается признак интервала, равного 200 нс, трехразрядный код настройки масштабного делителя и двенадцатиразрядное слово, задающее величину обрабатываемого интервала.

В связи с последовательным характером обработки временных интервалов, данные, введенные пользователем, преобразуются в следующие интервалы для двух режимов работы (первого - серия прямоугольных импульсов; второго - пилообразные, треугольные или трапециевидальные сигналы):

временной сдвиг D ;

длительность τ для первого или длительность шага фронта $\Delta \tau_{\text{ф}}$ для второго режимов работы;

остаток периода заполнения серий OT_{30} для первого режима или длительность вершины $\tau_{\text{в}}$ для второго режима;

длительность шага среза $\Delta \tau_{\text{ср}}$ для второго режима;

остаток периода повторения $OT_{\text{с}}$ для первого режима, OT для второго режима;

В первом режиме длительность τ и остаток периода заполнения серий OT_{30} повторяются от 1 до заданного $K_{\text{имп}}$ раз.

Во втором режиме шаг фронта и шаг среза повторяются 99 раз.

В связи с формированием СИ, привязанных к началу интервала первой длительности τ в первом режиме, первый шаг фронта $\Delta \tau_{\text{ф}}$ и первый шаг среза $\Delta \tau_{\text{ср}}$ во втором режиме автоматом управления формируются в отдельных состояниях, поэтому данные об указанных интервалах засылаются в ОЗУ дважды.

Распределение адресов в ОЗУ указано в табл.15.

Таблица 15

Код адреса	Интервал
000	не используется
001	D
010	τ / τ_{cp}
011	OT_{3c} / τ
100	τ_{cp} B
101	OT_c / OT
110	τ / τ_{Φ}
111	τ_{cp}

Для повышения быстродействия путем исключения коммутатора на входах адреса ОЗУ код адреса записи также формируется блоком J-K триггеров автомата управления. J-K триггера получает этот код из регистров настройки.

Временной блок работает в режимах "Подготовка", "Генерация" и "Останов".

Код режима задается в соответствии с табл.16.

Таблица 16

Признаки		Режим
подг.	ген.	
0	0	"Подготовка"
1	1	"Генерация"
1	0	"Останов"

В режиме "Подготовка" заполняются регистры настройки. Блок J-K триггеров работает в режиме транзисторной передачи кода адреса записи в ОЗУ и заполняется ОЗУ. В режиме "Генерация" запускается автомат, происходит считывание информации из ОЗУ, формируются выходные сигналы. В режиме "Останов" заканчивается формирование заданной последовательности, создается сигнал КП - конец последовательности и триггер пуска-останова закрывает LC- генератор.

Основным блоком автомата управления ДПКД является блок триггеров, собранных на микросхемах У28, У29.

Триггеры могут находиться в одном из 15 состояний, согласно табл.17.

Таблица I7

Триггер				Обозначение состояния
T3	T2	T1	T0	
0	0	0	0	0
0	0	0	I	I
0	0	I	0	2
0	0	I	I	3
0	I	0	0	4
0	I	0	I	5
0	I	I	0	6
0	I	I	I	7
I	0	0	I	9
I	0	I	0	A
I	0	I	I	B
I	I	0	0	C
I	I	0	I	D
I	I	I	0	E
I	I	I	I	F

Триггеры изменяют состояние в соответствии с диаграммой состояний блока J-K триггеров (рис. I1 и I2). На рис. I1 и I2 в вершинах графа указаны текущие состояния и через символ " / " ожидаемое состояние.

Условия изменения состояний записаны на дугах графа.

В условия изменения состояний входят:

тактовый сигнал ΦI и его диверсия $\overline{\Phi I}$;

признак конца временного интервала (кон) и его инверсия ($\overline{\text{кон}}$);

признак конца количества импульса (конки) и его инверсия ($\overline{\text{конки}}$);

признаки настройки.

Признаком настройки являются:

признак подготовки (подг)

код адреса записи в ОЗУ

0000 - АДР0
0001 - АДР1
0010 - АДР2
0000 - АДР3
0100 - АДР4
0101 - АДР5
0110 - АДР6

0111 - АДР7
1001 - АДР9
1010 - АДРА
1011 - АДРВ
1100 - АДРС
1101 - АДРД
1110 - АДРЕ
1111 - АДРГ

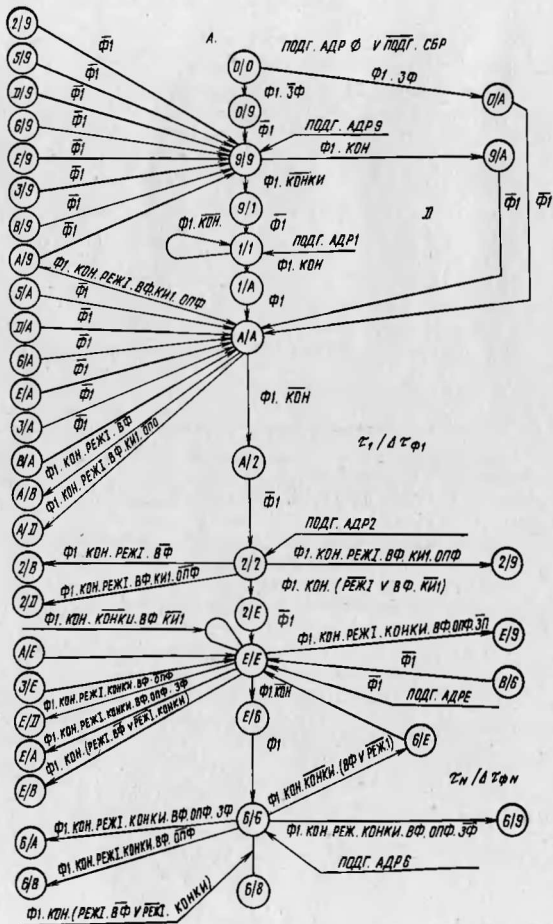


Рис. II. - Диаграмма состояний блока I-K триггеров

признак режима I (Рис. I);
 признаки нулевых интервалов:
 задержки (З \emptyset),
 остатка T_{3c} (В \emptyset),
 шага среза (С \emptyset),
 остатка периода (ОП \emptyset);
 признак количества импульсов, равного I ($K_{\text{имп. I}}$);
 признак номера синхроимпульса, равного I ($\# \text{СИ I}$).
 Признаки настройки формируются на У1, У2, У3.

Число вершин на графе значительно превышает число наблюдаемых состояний (15 состояний) триггеров, т.к. на графе показаны через символ "/" сочетания состояний вторых и первых ступеней внутренней памяти J-к триггеров. Значения на выходах J-к триггеров устанавливаются по отрицательному фронту такта \emptyset I, а прием сигналов в первые ступени J-к триггеров происходит по положительному фронту такта \emptyset I.

Центральная ветвь графы по рис. II и I2 определяется обработкой всех временных интервалов с длительностью не менее 200 нс.

Состояния от 9 до 11 устанавливаются на один период такта \emptyset I, т.е. на 100 нс, в начале каждого обрабатываемого интервала и поэтому используются для формирования выходных сигналов.

После синтеза и оптимизации функции возбуждения J-к триггеров имеют следующий вид:

$$\begin{aligned}
 J3 &= \overline{T3} (\text{КОН} \vee A_0) = T3 \vee \overline{\text{КОН}} \cdot \overline{A_0} \\
 K3 &= \overline{A_0} \cdot \overline{\text{КОН}} \\
 J2 &= \text{КОН} (A_3 \cdot (\overline{\text{РЕЖ}} \vee \overline{\text{ОП}} \vee \overline{\text{КОНКИ}} \cdot \overline{\text{КИ}}) \vee A_2 \cdot (\overline{\text{РЕЖ}} \vee \overline{\text{В}} \vee \overline{\text{ОП}} \vee \overline{\text{КИ}})) \\
 K2 &= \text{КОН} \cdot (A_5 \vee A_6 \cdot \overline{\text{КОНКИ}} \cdot \overline{\text{ОП}} \vee A_6 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot \overline{\text{В}} \vee A_6 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot \overline{\text{КОНКИ}}) \\
 J1 &= A_0 \cdot \overline{3\emptyset} \vee (A_1 \vee A_4 \vee A_5 \cdot \overline{3\emptyset}) \cdot \overline{\text{КОН}} \\
 K1 &= \text{КОН} \cdot (A_3 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \vee A_3 \cdot (\overline{\text{КОНКИ}} \vee \overline{\text{КИ}}) \cdot (\overline{3\emptyset} \vee \overline{\text{ОП}}) \vee A_2 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot \overline{\text{В}} \vee \overline{\text{КИ}} \vee A_7 \cdot \overline{\text{КОНКИ}} \vee A_6 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot \overline{\text{КОНКИ}} \cdot \overline{\text{В}} \cdot (\overline{3\emptyset} \vee \overline{\text{ОП}})) \\
 J0 &= A_0 \cdot \overline{3\emptyset} \vee \text{КОН} \cdot (A_4 \vee A_2 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot (\overline{\text{КИ}} \vee \overline{\text{В}}) \vee A_6 \cdot \overline{\text{КОНКИ}} \cdot \overline{3\emptyset} \vee \overline{\text{ОП}} \vee \overline{\text{РЕЖ}}) \vee A_6 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot \overline{\text{В}} \\
 K0 &= \text{КОН} \cdot (A_1 \vee A_3 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot \overline{\text{С}} \vee A_3 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot \overline{\text{ОП}} \cdot \overline{3\emptyset} \vee A_3 \cdot \overline{\text{КОНКИ}} \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot \overline{\text{КИ}} \vee A_5 \cdot \overline{3\emptyset})
 \end{aligned}$$

Функции формирования выходных сигналов реализует следующие функции:

$$\begin{aligned}
 \text{СИ} &\sim A_3 \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \vee \overline{\text{ПСИ}} \cdot \overline{\text{В}} \vee A \cdot \overline{3\emptyset} \cdot (\overline{\text{РЕЖ}} \vee \overline{\text{ПСИ}}) \cdot \overline{\text{В}} \\
 \text{ВАС} &\cdot \overline{\text{ПСИ}} \cdot \overline{\text{В}} \vee A_D \cdot \overline{\text{РЕЖ}} \cdot \overline{\text{ПСИ}} \cdot \overline{\text{С}} \cdot \overline{\text{В}};
 \end{aligned}$$

$C2 \sim A_A \cdot \bar{\Phi}$;
 $C3 \sim A_A \cdot \overline{НСИИ} \cdot \overline{РЕЖИ} \cdot \bar{\Phi} \vee B3 \vee A_D \cdot \overline{РЕЖИ} \cdot \overline{ПСИ} \cdot \bar{\Phi} \vee A_B \cdot \bar{\Phi} \cdot \overline{РЕЖИ} \cdot \overline{ПСИ}$;
 $B3 = \overline{ПЕРНСИ} \cdot \bar{\Phi}$
 Запуск $\sim A_A \cdot \Phi2 \vee A_E \cdot \overline{РЕЖИ} \cdot \Phi2$
 Пуск Т $\sim A_D \vee A_A \vee A_B \vee A_C \vee A_D \vee A_E \quad A_F$
 Обрыв $\sim A_A \cdot \Phi1 \cdot \overline{РЕЖИ} \cdot \tau 50 \vee A_E \cdot \Phi1 \cdot \overline{РЕЖИ} \cdot \tau 50 \vee A_D \cdot \overline{РЕЖИ} \cdot \Phi2 \vee A_B \cdot \Phi2 \cdot \overline{РЕЖИ} \cdot \tau 50$
 Плюс $\sim (A_A \vee A_E) \cdot \Phi2 \vee \overline{РЕЖИ}$
 Минус $\sim A_C \cdot \Phi2 \vee A_F \cdot \Phi2 \vee \overline{РЕЖИ}$
 Уст. КИ $\sim A_A \cdot \bar{\Phi} \cdot \overline{КИИ} \vee A_C \cdot \bar{\Phi}$
 Уст. НСИ $\sim A_A \cdot \overline{НСИИ} \cdot \overline{РЕЖИ} \cdot \bar{\Phi}$
 Опр. КИ $\sim A_E \cdot \bar{\Phi} \cdot \overline{КИИ} \vee A_F \cdot \bar{\Phi} \cdot \overline{КИИ}$
 Опр. НСИ $\sim A_E \cdot \overline{НСИИ} \cdot \overline{РЕЖИ}$

Генератор должен работать в режимах внутреннего, внешнего и разового запуска.

Внешний запускающий сигнал выделяется, дифференцируется и усиливается в устройстве формирования внешнего запускающего сигнала. Запускающие сигналы поступают на триггер пуска-останова.

На R-выходе сигнал определяется выражением

Стоп = $CБP_n \vee ПOДч \vee КП (\overline{ГЕН} \vee \overline{ПЕР})$.

На S-входе сигнал определяется выражением:

Пуск = $ГЕН \cdot [ПЕР \vee РУЧн^* \vee ВН (+)^* \vee ВН (-)^*]$ · СТОП,

где $ручн.^*$, $вн(+)^*$, $вн(-)^*$ - сформированные сигналы запуска;

$CБP_n$ - сброс при включении;

КП - сигнал конца последовательности.

Сигнал конца последовательности определяется по формуле

$КП = КОН \cdot \Phi1 [(A2 \vee A6) (КОНКИ \vee K_{ИМИ} I) \overline{РЕЖИ} \vee A5 \cdot \overline{РЕЖИ}]$

Триггер пуска-останова создает сигнал сброса (сбр). Сигнал сброса устанавливает J-к триггеры автомата в исходное состояние "0", блокирует выдачу сигнала "готов" и управляет задающим генератором.

Задающий генератор выполнен на основе LC-генератора, работающего в режиме ударного возбуждения на частоте 20 МГц и в соответствии с временной диаграммой, приведенной на рис.13..

Нулевые интервалы и интервалы, длительностью 100 нс обеспечиваются переходами синхронного автомата на J-К триггерах, тактируемого частотой 10 МГц.

Интервалы в 200 нс и более обрабатываются специальным таймером.

Интервалы в 50 нс формируются из выходных сигналов автомата с помощью двух тактовых импульсов, сдвинутых на 50 нс ($\Phi 1$ и $\Phi 2$).

Плата ДПКД является операционным устройством по отношению к автомату управления.

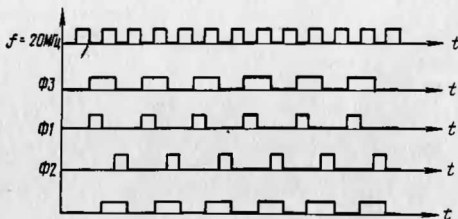


Рис.13. Временная диаграмма тактовых импульсов

В регистре настройки платы ДПКД хранятся: признаки 100 нс, интервалов: $D1\bar{D}\bar{D}$, $\tau 100/\Delta\tau_{\phi}$, $I\bar{D}\bar{D}$, $0T\bar{z}\bar{s}$ $I\bar{D}\bar{D}/\tau_{B}$ $I\bar{D}\bar{D}$, $I\bar{D}\bar{D}$, $0T I\bar{D}\bar{D}$; код количества импульсов; код номера синхроимпульса.

Временные параметры, большие 100 нс, хранятся в ОЗУ, функционирование которого описано выше.

Во всех узлах с параллельным переносом на микросхемах применены двоично-десятичные счетчики I33IE6 в режиме прямого счета (суммирования).

Для повышения быстродействия выходы переносов не используются, а сигналы переноса формируются конъюнкторами, выделяющими состояние "9". В связи с таким структурным решением в счетчики заносится двоично-десятичный дополнительный код.

Занесение кода выполняется в начале обработки временного интервала или количеством импульсов сигнала установки ($Уст KI$) и ($Уст \# СИ$).

Сигналы установки счетчиков KI и $\# СИ$ создаются автоматом управления.

Так как задержка микросхем памяти составляет ~ 60 нс, то к моменту установки счетчиков таймера на выходе ОЗУ успевает установиться новое значение.

Сигналы опроса счетчиков KI и $\# СИ$ создаются автоматом управления, а сигнал опроса таймера формируется схемой управления таймера из такта ϕI .

Сигналы об окончании счета формируются в счетчиках ДПКД по разному.

Счетчик KI содержит RS -триггер, который обрасчивается сигналом $Уст KI$ и устанавливается сигналом переноса.

Счетчик № СИ формирует только сигнал переноса $\overline{B3}$, синхронизированный тактом $\overline{B3}$.

Таймер формирует сигнал об окончании интервала (КОН) на выходе RS-триггере.

Триггер сбрасывается фронтом такта $\emptyset 2$, а устанавливается срезом $\emptyset 2$ в зависимости от настройки.

В случае настройки на 100 нс интервала, установка осуществляется ближайшим срезом $\emptyset 2$, в случае настройки на 200 нс один такт пропускается. При больших интервалах установка происходит после получения сигнала таймера (УИ-2).

Сигнал внешнего запуска подается на разъем Ш5 (плата 4.384).

Резисторы R14, R15, R16 составляют делитель с входным сопротивлением 50 Ом. Диоды Д2, Д3 являются ограничительными. На транзисторах Т5, Т6 собран переключатель тока. Изменяя величину постоянного напряжения, подаваемого на базу транзистора Т6, (ручка регулировки уровня запуска выведена на переднюю панель), можно изменить коэффициент усиления. Таким образом, производится регулировка амплитуды внешнего запускающего сигнала в пределах 1-10 В. На транзисторах Т4, Т7 собраны усилители.

При внешнем запуске и отсутствии внешнего запускающего сигнала транзистор Т8 открыт и генерации нет. С приходом запускающего импульса транзистор Т8 закрывается и возникают автоколебания, которые обрываются импульсом с микросхемы У51.2.

5.2.4. Формирователь выходной

Выходной формирователь состоит из трех каналов формирования.

Схемы электрические принципиальные формирователи выходного 3.724 приведены в части 2 ТО1. Схема формирователя состоит из трех каналов формирования:

- 1) схем формирования отрицательного тока;
- 2) схем формирования положительного тока;
- 3) схем формирования базового смещения.

Функциональная схема формирователя выходного приведена на рис.14. Каждая схема формирования может работать в любом из двух режимов, причем режимы имеют два варианта работы:

- I режим (вариант 1) - режим серии прямоугольных импульсов с амплитудой до 9,9 В на нагрузке 50 Ом (выходное гнездо на передней панели);

- I режим (вариант 2) - режим серии прямоугольных импульсов с амплитудой до 99 В на нагрузке 1 кОм (выходное гнездо на выносном блоке);

- II режим (вариант 1) - режим одинарных сигналов пилообразной, треугольной и трапецеидальной форм с амплитудой до 9,9 В на нагрузке 50 Ом (выходное гнездо на передней панели);

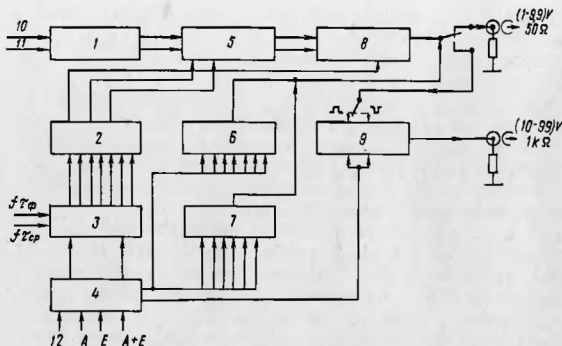


Рис.14. Схема электрическая функциональная формирователя выходного: I - триггер формирования длительности; 2 - формирование сигнала по весовым данным и амплитуде (формирование отрицательного тока); 3 - делитель частоты; 4 - управление и коммутация; 5 - тоновые ключи; 6 - формирование положительного тока; 7 - формирование базового смещения; 8 - выходной каскад; 9 - выносной блок; 10 - запуск; 11-обрыв

- II режим (вариант 2) - режим одиночных сигналов пилообразной, треугольной и трапецеидальной форм, с амплитудой от 10 до 99 В на нагрузке 1 кОм (выходное гнездо на выносном блоке).

Все четыре режима работы используют одни и те же каскады формирования. Каждый формирователь имеет функционально законченные схемы, а именно:

формирование отрицательного тока:

- триггер формирования длительности (I),
- токовые ключи (5),
- выходной каскад импульсов с амплитудой 9,9 В при нагрузке 50 Ом (8),

- формирование сигналов по весовым данным и амплитуде (2);
- формирование положительного тока (6);
- формирование базового смещения (7);

формирователь импульсов с амплитудой до 99 В при нагрузке 1 кОм (выносной блок) (9);

схемы управления и коммутации (4).

Схема формирования отрицательного тока и отрицательной полярности в режиме работы серии прямоугольных импульсов.

Расомотрение работы электрической схемы формирователя нужно начать с установки определенного формируемого им режима, например, серии прямоугольных положительных импульсов с амплитудой до 9,9 В на нагрузке 50 Ом.

Импульсы запуска и обрыва на триггере формирования длительности поступают через разъем Ш1 с ДПКД; причем импульсы запуска соответствуют фронту выходных импульсов, а импульсы обрыва - срезу, таким образом, временной сдвиг между этими импульсами определяет длительность выходных импульсов и может быть любой величины от 0,05 мкс до 999 мс. Если триггер на микросхемах У10 и У14 срабатывает на импульсы запуска и возвращается в исходное состояние импульсами обрыва, то на выходе формирователя будут отрицательные неинвертированные импульсы, если же триггер на микросхемах У10 и У14 срабатывает на импульсы обрыва, а возвращается в исходное состояние импульсами запуска, на выходе формирователя будут отрицательные инвертированные импульсы (рис.15). Управление работой триггера на микросхемах У10 и У14 осуществляется микросхемами У1, У7, срабатывающими на код:

- отрицательный неинвертируемый импульс - 0000100,

- отрицательный инвертированный импульс - 0001000,

подаваемый по информационной шине через разъем Ш1 конт. I35 по сигналу с кнопки ВЫХОД. (Засылается семь импульсов, которые записывают шесть нужных разрядов) (Временные диаграммы приведены на рис.15).

Прямой и инверсный выходы триггера на микросхемах У10 и У14 используются дальше для переключения тока в токовых ключах на транзисторах Т1-Т2, Т4-Т5, Т6-Т7. Согласование выходов триггера ТП1 - структуры с транзисторами осуществляется с помощью транзисторов Т1-Т2.

На эмиттере первого токового переключателя на транзисторах Т1-Т2 должно быть напряжение около 0, а питание осуществляется от источников "+" и "-".

Дальше согласование ключей осуществляется автоматически при подаче соответствующего питания на каждый токовый переключатель.

Ток через выходной каскад (транзисторы Т3, ТП1) определяет выходную амплитуду серии импульсов и, т.к. выходная амплитуда должна изменяться от 1 до 9,9 В с дискретностью 0,1 В, ток должен изменяться от 20 до 200 мА с дискретностью 2 мА, т.е. в этом диапазоне необходимо иметь 100 дискретных точек или 27 переключений.

В качестве источника отрицательного тока использован транзистор Т9, управление током которого осуществляется серией микросхем и транзисторов: У13, У17 - напряжение на выходе их пропорционально величине опорного напряжения, снимаемого с регулируемого ЦАП на микросхемах У18, У21; микросхема У19 - инвертор; микросхе-

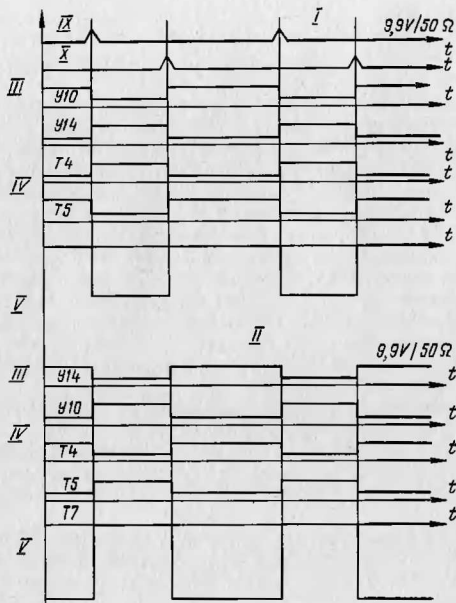


Рис.15. Временные диаграммы:

I - неинвертируемые импульсы (отрицательная полярность); II - инвертируемые импульсы (отрицательная полярность); III - триггер; IV - тоновый переключатель; V - выход

ма У22 и транзистор Т3 - привязка к источнику минус 16 В и микросхема У26 - регулятор тока в транзисторе Т9.

Информационный код, соответствующий величине амплитуде серии прямоугольных импульсов с помощью сигнала, подаваемого от дешифратора через разъем III конт. I7A, записывается в схемы памяти (триггера).

С помощью импульса ОБРЫВ в счетчики записывается величина, соответствующая максимальной амплитуде, т.е. 9,9.

Эта величина со счетчиков на микросхемах У8, У9 устанавливается на выходах скоростного ЦАП на микросхеме У13. На этот же

ЦАП (конт. 4) в качестве опорного напряжения подается величина, пропорциональная амплитуде с ЦАП на микросхемах У18 и У21. Амплитуда 9,9 В соответствует $U_{оп} = +9,9 В$, а $I В - U_{оп} = + I В$.

Каждый разряд информационного сигнала подключается на определенный вход ЦАП на микросхеме У18. Так, если на информационных шинах установлен семirazрядный код 0001111, записанный в триггер У6, то информационный код переписывается на входы ЦАП на микросхемах У18 и подключит на выходной каскад ток 30 мА. На нагрузке 50 Ом получим напряжение $U = 30 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = 1,5 В$.

Подключение кодированного сигнала на ЦАП осуществляется разрешающим сигналом записи режима работы на микросхемах У1, У7, У5.2.

Выходной каскад представляет собой тоже токовый переключатель, но составленный вместе с источником отрицательного тока по проводимости п-р-п. Внешняя нагрузка 50 Ом подключается к транзистору Т11, нормально закрытому. Подключение нагрузки производится с помощью реле Р1, которое в исходном состоянии (обесточенное) подключает выходной сигнал формирования к нагрузке 50 Ом, а во включенном состоянии к выносному блоку (высоковольтный выход до 99 В на нагрузке 1 кОм).

Во включенном состоянии реле Р1 (включение производит пятый разряд "лог.1", записанный в микросхему У4, конт.5) импульсы через контакты реле Р1 подаются на контакты другого реле Р1, которое установлено на коммутационной плате и срабатывает, когда устанавливается положительная полярность (на микросхеме У4 (на конт.15) лог."1"), и далее на выносной блок, подключаемый с помощью соединительного шланга. В нагрузку 50 Ом подается напряжение $\pm(0-2) В$ от схемы базового смещения, выполненного на микросхемах У29, У32, У33 и транзисторах Т12 и Т15.

Выходной сигнал - серия отрицательных прямоугольных импульсов - смещается на величину базового смещения (рис.16). При работе на выход 50 Ом выходной формирователь работает совершенно так же, как на выносной блок, с той лишь разницей, что реле Р1 не выключается, т.к. пятый разряд информационных шин при работе от сигнала с кнопки ВЫХОД имеет код "лог.0" и выходной сигнал через разъем Ш3 поступает на гнездо на передней панели.

Схема формирования отрицательной полярности в режиме сигналов пилообразной, треугольной и трапециевидной форм.

При работе в этом режиме счетчики на микросхемах У8, У9 переводятся в состояние, когда они могут работать в режиме оложения или вычитания, в зависимости от того, на какой из контактов (5 или 4) подается сигнал с ДПКД (разъем Ш1 конт. 6Б и 3Б).

При подаче на конт. 5 серии из 99 импульсов на выходах счетчика появляются сигналы с периодом в 2-4-8-16-32-64-128 раз боль-

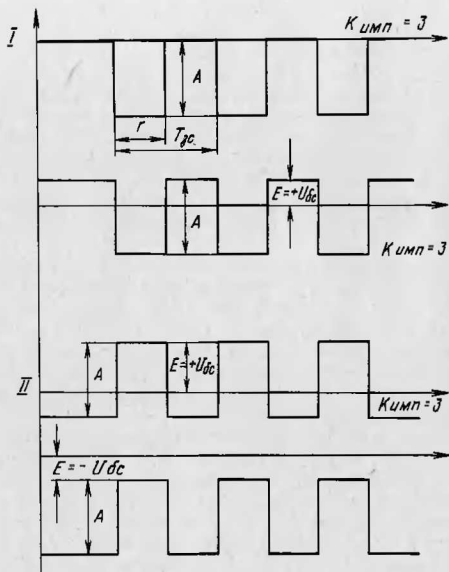


Рис. 16. Подключение базового смещения Б к выходному сигналу:
 I - неинвертируемые сигналы; II - инвертируемые сигналы

шим, чем период импульсов в серии на входе. Из этих сигналов складывается выходной сигнал пилообразной, треугольной и трапецидальной форм (рис. 17). Помимо этого, каждому выходному сигналу счетчика в ЦАПе (микросхема У13) присваивается определенная весовая функция в виде тока, т.е. сигналам с периодами в 2-4-8-16-32-64-128 раз большими, чем входной определен ток в 2-4-8-16-32-64-128 раза от опорного напряжения.

Если амплитуда сигнала пилообразной, треугольной и трапецидальной форм устанавливается до 5 В, это значит, что на микросхему У13 подается опорное напряжение, равное 5 В, и оно, в зависимости от разряда, придает деленному сигналу определенный весовой коэффициент.

Таким образом, сигналу, сложенному из семи выходов счетчиков У8, У9, придается вес изменения амплитуды по коду I-2-4-8 и на

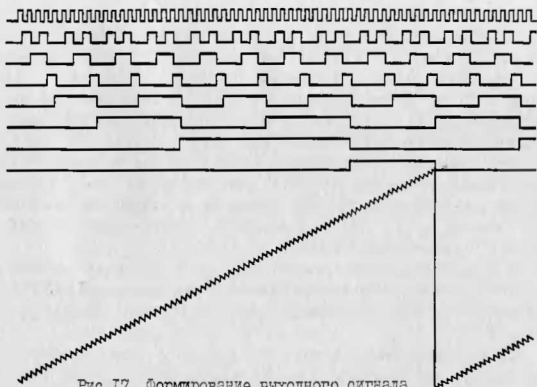


Рис.17. Формирование выходного сигнала

нагрузке 50 Ом происходит изменение амплитуды сигнала с дискретностью 0,1 В в пределах от 1,0 до 9,9 В. Одновременно с приходом на вход счетчиков 99 импульсов фронта и 99 импульсов среза (если таковой имеется) на вход формирователя "обрыв" с ДПКД поступают импульсы, соответствующие концу сигнала пилообразной, треугольной и трапециевидальной форм, и выходной каскад открывается.

Так, если на выходе прибора должен быть сигнал типа "пила", то на счетчики подаются только сигналы, соответствующие фронту, т.е. нарастанию пилы, а сигналы среза отсутствуют, вместо их на входе лог. "1" и на "обрыв" подается импульс, соответствующий 99-му импульсу этой серии (конец нарастания фронта). Эти импульсы вызовут установку счетчиков в исходное положение и срабатывание формирующего триггера на микросхемах У10 и У14.

Импульс обрыва откроет выходной каскад и ток выходного каскада образует на выходной нагрузке сигнал пилообразного напряжения. Таким образом, выходной каскад открыт для прохождения линейноизменяющегося тока.

Схема формирования положительной полярности в режиме работы серии прямоугольных импульсов

Работа этой схемы не отличается от работы схемы при формировании отрицательной полярности с той лишь разницей, что еще формируется "положительный" ток, который на выходной нагрузке 50 Ом складывается с отрицательным током, образуя импульсы положительной

полярности на нагрузке 50 Ом. Формирование "положительного" тока производится лишь при условии подачи разрешающего сигнала на микросхему У24 конт. I2 и окончания всех засылок (У24 конт. I3). Величина "положительного" тока определяется кодом, подаваемым по шине III конт. IOB на триггер "памяти" (УП и У20) и далее через схему совпадения на ЦАП. Аналоговый сигнал в виде изменяющегося тока вызывает изменение напряжения на транзисторе Т10 и далее тока в источнике тока на транзисторах Т13, Т14. Этот ток поступает непосредственно в выходную нагрузку 50 Ом через фильтрующий дроссель Др2. Эта схема используется для формирования положительного базового смещения от 0 до 2 В, которое, если оно существует, складывается с "положительным" током.

Код включения положительного тока при формировании положительной неизвергнутой полярности представляет собой 0000001 и положительной инвертированной полярности - 0000010 (триггер "памяти" У4).

Серия прямоугольных импульсов с выходного каскада (транзисторы Т8, Т11, Т9) с помощью реле Р1 переключается либо на выносной блок для дальнейшего формирования до амплитуды 99 В, либо на гнездо Ш3 и дальше на выходное гнездо на передней панели прибора.

Схема формирования положительной полярности сигналов пилообразной, треугольной или трапециoidalной форм.

Как указывалось выше, схемы формирования сигналов и логика включения остались те же самые, что и при отрицательной полярности; изменилась логика включения режима работы и на выходной нагрузке произошло сложение токов.

Работает ЦАП на вычитание следующим образом. Код сигнала, соответствующего величине нужной амплитуды, подается по семи информационным разрядам, записанным в запоминающие элементы на микросхемах VII, У20.

Все семь разрядов кода затем подаются на входы ЦАП, в который записана амплитуда 9,9 В, происходит вычитание и в виде постоянного усиленного операционным усилителем на микросхеме У31 сигнала поступают на вход усилителя постоянного тока на транзисторе Т10, где усиливаются до напряжения от I2 до I5 В и поступают на обдую нагрузку 50 Ом через составной эмиттерный повторитель на транзисторах Т13, Т14.

На плате находится ЦАП изменения величины базового смещения. Запись информационного кода о величине и полярности базового смещения производится в запоминающий элемент на микросхеме У15. Далее информация о величине и полярности базового смещения подается через логику на микросхемах У22 и У27, работающую только при лог. "1" - т.е. отрицательной полярности напряжения на входе ЦАП (микросхема У29).

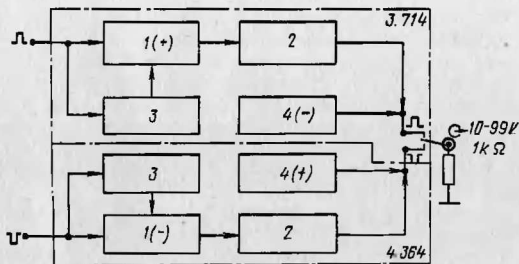


Рис.18. Схема электрическая функциональная блока выносного:
 1 - усилитель; 2 - эмиттерный повторитель; 3 - формирователь среза (T_{cp}); 4 - дополнительный источник тока

Подача на контакт 2 У2.2 лог. "1" вызывает срабатывание логики и на ЦАП (микросхема У29) подается опорное напряжение плюс 15 В, а на выходе операционного усилителя будет постоянное напряжение отрицательной полярности, которое в дальнейшем усиливается и подается непосредственно на выходное гнездо.

5.2.5. Блок выносной. Схема электрическая принципиальная выносного блока приведена в части 2 ТО1.

Функциональная схема выносного блока приведена на рис.18.

Схемно формирователь в выносном блоке разбит на две части - усилитель-формирователь импульсов и сигналов положительной полярности (3.714) и усилитель-формирователь импульсов и сигналов отрицательной полярности (4.364). Обе части имеют одинаковое схемное выполнение и отличаются только проводимостью примененных транзисторов.

Сигнал с платы формирователя выходного 3.724 (положительной или отрицательной полярности) через реле Р1 платы 3.722 по кабелю, согласованному на конце (в выносном блоке), поступает на выносной блок и усиливается. Усилитель положительной полярности (3.714) на транзисторах Т1, Т2 усиливает сигнал и передает на выходной эмиттерный повторитель (транзистор Т3).

Одновременно на усилитель поступает сформированный сигнал среза.

Поступающие на выносной блок входные импульсы дифференцируются цепочкой С11^ж, R21, формируются токовыми переключателями на транзисторах Т8, Т7, Т6, Т5 и на время среза закорачивают нагрузку усилителя, способствуя быстрому разряду паразитной емкости.

Усилители на транзисторах Т1, Т2 имеют коэффициент усиления 10, но, чтобы создать линейную входную характеристику (для прохождения сигнала пилообразной, треугольной или трапецеидальной форм), транзисторы Т1 и Т2 приоткрыты и через выходную нагрузку течет постоянная оставляющая тока. Для создания на выходе в момент отсутствия сигнала нулевого смещения на нагрузке, на транзисторах Т4 созданы дополнительные источники тока, которые создают ток противоположного направления, алгебраически складывающийся с током смещения.

Для защиты выходного транзистора Т3 от перегрузки в момент окончания импульса серии в схеме установлен диод Д2.

В момент, когда заканчивается импульс, емкость, подключенная к нагрузке, удерживает напряжение на эмиттере большой величины, в то время как на базе уже установилось практически нулевое смещение. При этом создается угроза пробоя транзисторов по переходу база-эмиттер, но диод ускоряет процесс разрядки емкости и защищает транзисторы от пробоя. При неосторожном обращении с выходной нагрузкой 1 кОм может произойти непроизвольное закорачивание и короткое замыкание ее.

Диод Д1 способствует тому, что при коротком замыкании нагрузки происходит довольно медленное разогревание перехода эмиттер-коллектор выходного транзистора (уменьшение мощности на переходе), и успевает сработать защита от перегрузки по току и напряжению в стабилизаторе плюс-минус 120 В.

Подключение усилителя-формирователя положительной или отрицательной полярности к выходному гнезду производится реле Р2, включаемое выходным формирователем на плате З.724 при передаче по информационным шинам сигнала, в котором в младшем разряде появляется "лог.1" (наличие "лог.1" - положительная полярность, "лог.0" - отрицательная полярность).

Питание выходных каскадов усилителей-формирователей выносного блока производится от стабилизатора, который в зависимости от полярности и амплитуды выходного сигнала выдает плюс от 30 до 120 В или минус от 30 до 120 В, что способствует большей надежности работы выходных транзисторов.

Изменение амплитуды импульсов и сигналов пилообразной, треугольной или трапецеидальной форм производится на входе усилителей-формирователей, т.е. изменением амплитуды входных сигналов через О,1 В.

Усилители-формирователи выносного блока имеют коэффициент усиления 10 (поддерживается благодаря сильным обратным связям) и поэтому на выходе на нагрузке 1 кОм получается сигнал от 10 до 99 В с дискретностью изменения 1 В.

Усиление отрицательной полярности (плата 4.364) производится аналогичным образом на транзисторах Т1 и Т2, выходной каскад - составной транзистор Т3, Т5.

Усилитель-формирователь среза в этой плате построен на транзисторах Т9, Т8, Т7, Т6, а дополнительный источник тока - транзистор Т4.

Усиление формирования среза на обеих платах производится только для сигналов прямоугольной формы - этому способствует реле Р1 на платах 3.714 - положительной полярности и 4.364 - отрицательной полярности.

При прохождении сигналов пилообразной, треугольной и трапециевидальной форм дифференцирующие цепочки С11*, R21 (плата 3.714) и С11*, R21 (плата 4.364) отключаются.

5.2.6. Устройство сопряжения с каналом общего пользования (КОП). Устройство осуществляет связь прибора с каналом общего пользования (КОП). Если прибор адресован на прием, то при включении дистанционного управления (ДУ) сигналы из КОП выполняют функции органов управления, расположенных на передней панели прибора.

Дистанционное управление (ДУ) включается при одновременном выполнении двух условий:

- 1) переключатель дистанционного управления (ДУ), расположенный на боковой стенке прибора, находится в положении "ДУ",
- 2) по линии ДУ из КОП подается низкий уровень.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, т.е. тумблер находится в положении "МУ" или на линии ДУ высокий уровень, то дистанционное управление выключается, и управление генератором осуществляется с кнопочного поля.

Кодирование информации должно осуществляться в соответствии с табл. 5.2.

Схема электрическая принципиальная устройства сопряжения с КОП приведена в части 2 ТО1.

Входные цепи предназначены для согласования прибора с КОП (резисторы R27...R56 и развязывающие инверторы на микросхемах У2...У6).

Схема адресации (микросхемы У9 и У10) служит для формирования сигнала "адрес" при совпадении кода адреса, поступающего с переключателей "2⁰ - 2⁴" (В1-В5), расположенных на боковой стенке прибора, с кодом, поступающим по линиям данных ЛД0-ЛД4. Сигнал "адрес" формируется микросхемой У9 и поступает на триггер адресации на микросхеме У11.

Первым сигналом при обращении к прибору по КОП должен быть сигнал "01" (очистить интерфейс). Низкий уровень на линии "01" установит в "0" триггер адресации У11 (по входу R), а триггер

управления сигналом "ГП" (готов к приему) - микросхемы У16-I и У17-I - в "I".

Низкий уровень на выходе микросхемы У11 (I2) в свою очередь вызовет появление низкого уровня на выходе У13 (5), который сбросит в "0" триггер управления сигналом "ДП" (данные приняты) - микросхемы У14-3 и У14-4.

По окончании сигнала "ОИ" контроллер КОП может адресовать прибор.

Для этого по КОП передается адрес "на прием", предписанный данному прибору, при этом на выходе микросхемы У8 (I0) появляется высокий уровень. Адреса и команды по КОП передаются при низком уровне на линии "УП" (управление).

Передача любой информации сопровождается установкой низкого уровня на линии "СД" (сопровождение данных). Таким образом при передаче адреса прибору на выходе микросхемы У7 (I2) появится синхриимпульс. Длительность синхриимпульса задается величинами сопротивления резистора R33 и емкости конденсатора С4.

Одновременный приход высокого уровня на вход 7 и синхриимпульса на вход 2 триггера У1 вызовет установку этого триггера в состояние "I" (на входах 8 и 9 - высокие уровни). Высокий уровень на выходе У11 (I2) является признаком того, что прибор был адресован со стороны КОП (состояние "СПАД" - приемник адресован).

Выход триггера У11 (I2) управляет сигналами "СПАК" (приемник активен) и "СПРМ" (прям данных), которые формируются в соответствии с логическими выражениями (5.1) и (5.2).

$$\text{СПАК} = \text{СПАД} \wedge \text{УП} \quad (5.1)$$

$$\text{(выход 6 микросхемы У12-3).}$$

$$\text{СПРМ} = \text{СПАД} \wedge \text{СД} \quad (5.2)$$

$$\text{(выход 5 микросхемы У13-1).}$$

После того как прибор адресован, контроллер КОП может передавать прибору информацию для настройки его на тот или иной режим генерации. Информация передается в виде 7-разрядного кода по линиям данных ЛД0-ЛД6. Этот код через инверторы У20 и У21 поступает на информационные шины прибора ШИ (9) - ШИ (I5).

Одновременно на шину ШИ (8) поступает сигнал "СПРМ" с выхода У21 (I3). Низкий уровень на этой шине является для программы управления признаком того, что информацию на ШИ (9) - ШИ (I5) нужно обработать, как очередной байт входных данных.

Прохождением сигнала "СПРМ" и информации с линии данных ЛД0-ЛД6 через инверторы У20, У21 управляет сигнал с выхода микросхемы У12 (II). Высокий уровень на этом выходе будет только при обращении к КОП со стороны программы управления за очередным байтом данных. При этом на вход микросхемы У19 (5.6) поступает низкий уровень - признак обращения к КОП, а на входы микросхемы

У16-3 поступают 4 младшие разряда адреса. Для упрощения схемы дешифрации адреса в программе управления адрес выходного регистра платы КОП принят таким, что 4 младшие разряда в нем равны 1 (500 F).

Таким образом, при обращении с КОП со стороны программы управления за очередным байтом на выходе У16 (10) появится низкий уровень, а на выходе У12 (11) - высокий уровень, который открывает инверторы У20, У21.

Этот же сигнал вместе с сигналами "СПРМ" и "СПРМ" управляет состоянием триггеров У16.1 - У17.1 и У14.3 - У14.4. "Лог.1" на выходе первого триггера У16 (12) свидетельствует о готовности программы управления к приему нового байта информации с КОП, а "лог.1" на выходе второго триггера У14 (12) - о приеме входного байта.

Триггер У16.1 - У17.1 собран по стандартной схеме. Как указано выше, первоначально он устанавливается в состоянии "лог.1" сигналом "СК" по входу У16 (1).

Приход сигнала "СПРМ" с выхода триггера У12(8) обрывает его в состояние "лог.0" по входу У17(9) и вновь в единичное состояние он вернется только при поступлении высокого уровня с выхода У12(11) в тот момент, когда сигнал "СПРМ" станет высоким.

Если сигнал "СПРМ" не принимал состояния "лог.0", т.е. по КОП не поступала информация, то триггер У16.1 - У17.1 будет сохранять состояние "лог.1" и обращение программы управления за новым байтом (сигнал с выхода У12(11)) не будет вызывать переключения триггера.

Аналогично, если программа успеет повторно обратиться за новым входным байтом раньше, чем будет снят предыдущий, то триггер сохранил состояние "лог.0", т.к. низкий уровень сигнала "СПРМ" на входе У14(2) блокирует прохождение сигнала обращения с выхода У12(11).

Триггер У14.3 - У14.4 также собран по стандартной схеме.

Когда в исходном состоянии сигнал "СПРМ" имеет значение "лог.0" (У13(5)), то этот триггер устанавливается в "лог.0" по входу У14(6).

При поступлении входного байта сигнал "СПРМ" становится высоким и разрешает прохождение сигнала обращения по входу У14(9), при этом триггер установится в состояние "лог.1".

Повторные обращения к КОП со стороны программы управления до снятия первого байта не изменяют состояние триггера, который опрокинется в "0" только после снятия сигнала "СПРМ".

Схемы формирования сигналов синхронизации "ГП" и "ДП" собраны на микросхемах У13, У15, У16.2, У17 и У18.

Сигнал "ГП" формируется в соответствии с логическим выражением 5.3.

$$\Gamma\text{П}=\overline{\text{ДП}} \wedge (\overline{\text{УП}} \wedge \text{СД} \vee \text{СПАК} \wedge \text{У16(12)} \wedge \text{СД}) \vee \overline{\text{СПАК}} \wedge \text{УП} \quad (5.3)$$

Высокий уровень сигнала "ГП" свидетельствует о готовности прибора к приему следующего байта данных по КОП.

Сигнал "ДП" формируется согласно логическому выражению 5.4.

$$\text{ДП}=\text{СД} \text{ зад.} \wedge \overline{\text{УП}} \vee \text{У14(12)} \vee \text{СПАК} \wedge \text{УП}, \quad (5.4)$$

где СД зад. - задержанный сигнал на линии "СД", длительность задержки определяется величинами сопротивления резистора R33 и емкости конденсатора С4.

Высокий уровень сигнала "ДП" свидетельствует о том, что данные, вытоавленные на линиях ДД0-ДД7, приняты.

Выходные формирователи на транзисторах Т10, Т11 предназначены для формирования сигналов, выдаваемых в КОП.

Синхронизация работы контроллера КОП и программы управления при передаче данных осуществляется следующим образом:

1) контроллер выдает на линии данных байт информации и вырабатывает сигнал СД.

При этом сигнал "СПРМ" устанавливается в "лог.1", а сигнал "СПРМ" сбрасывает в "лог.0" триггер У16.1 - У17.1.

Сигналы "ГП" и "ДП" оба имеют низкий уровень ($\Gamma\text{П}=\text{Н}$, $\text{ДП}=\text{Н}$);

2) программа управления обращается в КОП за байтом данных.

При этом на выходе триггере У12(II) появляется сигнал обращения, а на выходе У18(I) формируется сигнал "ответ" для микроЭВМ. Сигнал обращения открывает вентили У20, У21 и устанавливает в "лог.1" триггер У14.3-У14.4. Сигнал о выходе У14(7) вызывает появление высокого уровня на линии "ДП" ($\text{ДП}=\text{В}$, $\Gamma\text{П}=\text{Н}$);

3) контроллер выявляет состояние $\text{ДП}=\text{В}$ и снимает сигнал СД.

При этом сигнал "СПРМ" (У13-1) сбрасывается в "лог.0" и устанавливает в "лог.0" триггер У14.3 - У14.4. На линии "ДП" вновь устанавливается низкий уровень ($\text{ДП}=\text{Н}$, $\Gamma\text{П}=\text{Н}$).

Сигнал "СПРМ" становится равным "лог.1" и открывает вентиль У14-1;

4) программа управления обращается к КОП для проверки снят ли предыдущий байт данных. На выходе У12(II) вновь появляется сигнал обращения, который через вентиль У14-1 устанавливает сигнал "ГП" в "лог.1" (У16-1).

На входах 1, 2, I3 и I4 микросхемы У13-2 все высокие уровни, на выходе У13(I2) появляется низкий уровень, который устанавливает "ГП" в высокое состояние ($\Gamma\text{П}=\text{В}$, $\text{ДП}=\text{Н}$);

5) контроллер анализирует " $\Gamma\text{П}=\text{В}$ " и выставляет на линии данных очередной байт информации.

Далее процесс повторяется, начиная с п.1).

Высоковольтный стабилизатор, питающий выходной каскад.

На плате КОП расположен стабилизатор. Он обеспечивает выходной каскад выносного блока стабилизированным напряжением от 30 до 120 В. положительной или отрицательной полярности при импульсном токе нагрузки до 120 мА.

Переключение уровня выходного напряжения производится посредством реле Р2, Р3, Р4 усилителя для питания реле на транзисторах VI-2 VI-3, VI-4 в микросхемном исполнении по сигналам прошедшим через разъем ШI-I о платы формирователя 3.724.

Переключение полярности выходного напряжения производится посредством реле Р1, а его выключение с помощью реле Р5. Усилитель для питания реле Р1 построен на транзисторе VI-I.

Питание стабилизатора производится от блока питания стабилизированным выпрямленным напряжением 130 В, изолированным от корпуса через розетку ШI-I.

На входе стабилизатора для повышения надежности на случай перенапряжения входного напряжения 130 В включен параметрический стабилизатор на стабилитронах Д1, Д2, которые подгружает выпрямитель 130 В при увеличении напряжения на его выходе.

Высоковольтный стабилизатор выполнен по схеме компенсационного стабилизатора напряжения с последовательным регулирующим элементом на транзисторе Т1. Эмиттер регулирующего транзистора включен на минус входного напряжения 130 В, а с его коллектора снимается стабилизированное напряжение от минус 30 до минус 120 В.

Первый каскад усилителя обратной связи выполнен по дифференциальной схеме на транзисторах Т6, Т7, второй каскад, питающий базу регулирующего транзистора, выполнен на транзисторах Т2, Т3, Т4 по схеме последовательного соединения для повышения допустимого напряжения коллектор - эмиттер второго каскаде.

Транзистор Т5 входит в схему защиты от перегрузки по току и короткого замыкания. Источник опорного напряжения выполнен на стабилитроне Д9. Переключение выходного напряжения производится посредством коммутации резисторов R28, R29, R30 с помощью реле Р2, Р3, Р4.

Стабилитрон Д9 совместно со стабилитроном Д2 является параметрическим стабилизатором, обеспечивающим питание первого каскада усилителя обратной связи.

Стабилитрон Д17 служит для согласования постоянных потенциалов между первым и вторым каскадом усилителя обратной связи.

Диод Д6 служит для исключения возможного появления на выходе стабилизатора напряжения противоположной полярности от других источников. Для повышения стабильности опорного источника параметрический стабилизатор на стабилитронах Д8, Д9 питается от предварительного стабилизатора на стабилитроне Д3. Утановка уровня выходного напряжения производится резистором R33.

5.2.7. Блок питания. Схема генератора питается стабилизированными источниками напряжения о параметрами, приведенными в табл.18.

Таблица 18

Напряжение, В	Ток нагрузки, А	Пульсация, мВ
+5,2	6,0	100
+30	0,02	50
-30	0,02	50
+15	0,35	50
-16	0,35	50
+27	0,1	1000
± 130	0,1	1000

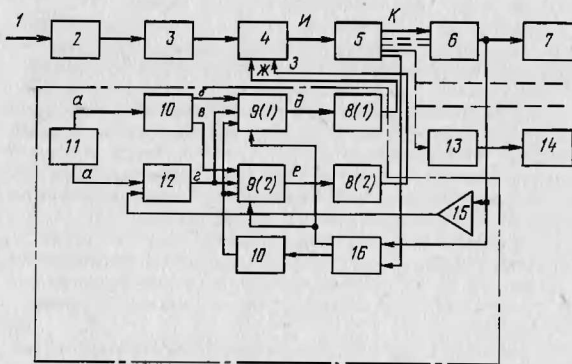


Рис.19. Схема электрическая функциональная блока питания:
 1 - сеть; 2 - низкочастотный выпрямитель; 3 - низкочастотный фильтр;
 4 - управляемый инвертор; 5 - высокочастотный выпрямитель; 6 - высокочастотный фильтр ВФ; 7 - нагрузка НВ; 8 - усилитель мощности;
 9 - смеситель; 10 - Д - триггер; 11 - генератор тактовых импульсов;
 12 - ждущий мультивибратор; 13 - высокочастотный фильтр ВФп;
 14 - нагрузка Нк; 15 - усилитель обратной связи; 16 - устройство
 схемы защиты

Для уменьшения объема и веса вторичных источников питания (ВИП), в генераторе применена схема высокочастотного инвертора, питаемого непосредственно от сетевого выпрямленного напряжения, без применения силового понижающего трансформатора низкой частоты.

Функциональная схема ВИП изображена на рис.19.

Напряжение питающей сети с частотой 50 или 400 Гц подается на входной низкочастотный выпрямитель (НВ). Выпрямленное и отфильтрованное низкочастотным фильтром (НФ) постоянное напряжение (350 В) поступает на управляемый, с "паузой на нуле" полумостовой инвертор (УИ).

Управление транзисторами инвертора производится прямоугольными импульсами, сдвинутыми по фазе друг относительно друга на 180° .

Гарантированную паузу, сдвиг фаз и стабилизацию выходного напряжения обеспечивает схема управления (СУ).

Генератор тактовых импульсов (ГТИ) вырабатывает последовательность импульсов (рис.20) длительностью 20 мкс с частотой 2 F, где F - частота работы подмостового инвертора.

Этими импульсами запускается Д-триггер, с прямого выхода которого сигналы "лог.0" или "лог.1" (рис.20.2) поступают на вход первого смесителя (СМ1), а сигналы с инверсного выхода триггера (рис.20.3) поступают на вход второго смесителя (СМ2).

Одновременно импульсы тактовой частоты подаются на один вход ждущего мультивибратора (ЖМ), а на другой вход мультивибратора подается сигнал с усилителя обрешотной связи (УОС). Мультивибратор вырабатывает импульсы тактовой частоты с максимальной длительностью 20 мкс, срез которых переключается в интервале 5-20 мкс, в зависимости от сигнала, поступающего с усилителя обратной связи, (рис.20.4).

Таким образом, гарантируется минимальная длительность паузы в 5 мкс.

С выхода ждущего мультивибратора сигнал поступает на смесители (СМ1) и (СМ2). В результате суммирования сигналов 20.2 и 20.4 на выходе смесителя (СМ1) образуется сигнал 20.5 (рис.20), а при сложении сигналов 20.3 и 20.4 в смесителе (СМ2) обрезаются сигналы 20.6 (рис.20.6). Этими сигналами через усилители мощности (УМ1) и (УМ2), соответственно, управляется полумостовой инвертор (УИ) (сигналы 20.7 и 20.8, рис.20.7 и 20.8), со вторичных обмоток которого снимается переменное напряжение сложной формы (рис.20.9).

После выпрямления высокочастотными выпрямителями (ВВ) сигналы 20.10 становятся однополярными (рис.20.10). Далее это напряжение фильтруется высокочастотными фильтрами (ВФ) и подается на нагрузку (НЛ).

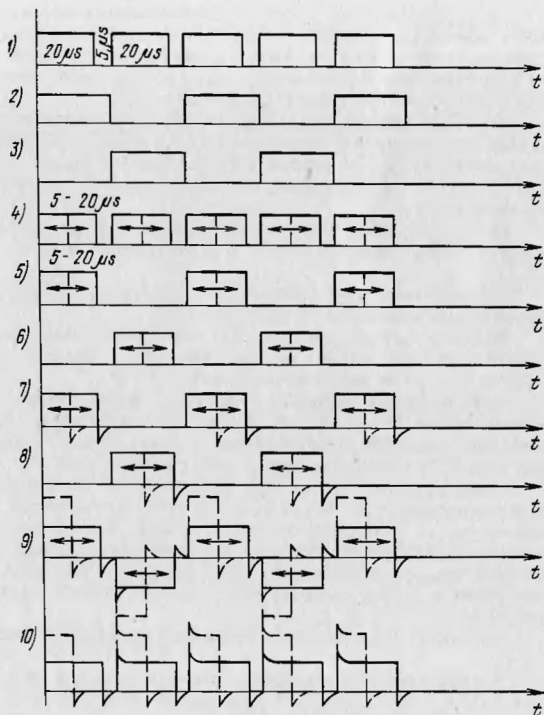


Рис. 20. Временная диаграмма работы блока питания

Схема управления обеспечивает также электронную защиту нагрузки от перенапряжения и источников от короткого замыкания.

При возникновении короткого замыкания в нагрузке устройство схемы защиты (УЗ) устанавливает на выходе триггера сигнал "лог.0", что приводит к закрыванию смесителей (СМ1) и (СМ2), а, соответственно, и инвертора.

Электрическая схема преобразователя (платы 3.704 и 3.705) и платы выпрямителя (3.720) приведены в ТО1.

Напряжение питающей сети 200 В, 50 или 400 Гц через сетевой фильтр поступает на выпрямитель Д1...Д4, выполненный по схеме моста.

Выпрямленное и отфильтрованное на емкостном фильтре С1...С5 постоянное напряжение 350 В через высокочастотный фильтр на дросселях Др1, Др2 и конденсаторе С6 подается на управляемый инвертор на транзисторах Т7, Т8 и конденсаторах С23, С24, выполненный по полумостовой схеме. (Трансформатор преобразователя Тр1 и трансформатор тока Тр2 конструктивно расположены на плате выпрямителей, поэтому в схеме преобразователя отсутствуют).

Высокочастотный фильтр необходим для отсечки высокочастотных колебаний от электролитических конденсаторов С1...С5. Управление инвертором осуществляется через трансформаторы Тр1 и Тр2.

Генератор тактовых импульсов выполнен на микросхемах У4 и У3.

С одного выхода генератора тактовых импульсов (контрольная точка "Ж") подаются сигналы на вход Д-триггера, выполненного на микросхеме У5, с другого (контрольная точка "И") на ждущий мультивибратор — микросхема У6. Одновременно на другой вход ждущего мультивибратора подается сигнал с усилителя обратной связи на микросхеме У2.

В результате сложения сигналов, поступающих с выхода Д-триггера (контрольная точка "М") и с выхода мультивибратора (контрольная точка "Н") в первом смесителе (микросхеме У7) вырабатывается сигнал управления (контрольная точка "Р"), который через усилитель мощности (транзистор Т3 и трансформатор Тр2) подается в базовую цепь транзистора преобразователя Т8. При сложении сигналов (контрольная точка "Д") и (контрольная точка "Н") на выходе второго смесителя (микросхема У8) образуется сигнал (контрольная точка "Г"), сдвинутый относительно сигнала (контрольная точка "Р") на 180° .

Этот сигнал через усилитель мощности (транзистор Т2 и трансформатор Тр1) поступает в базовую цепь второго транзистора преобразователя Т7. Под действием этих сигналов происходит поочередное включение и выключение транзисторов преобразователя Т7 и Т8, в результате чего в первичной обмотке трансформатора преобразователя протекает переменный ток.

При изменении напряжения питающей сети или тока нагрузки в источнике 5 В меняется напряжение на выходе и, соответственно, на выходе операционного усилителя на микросхеме У2, что вызывает изменение длительности импульса ждущего мультивибратора и, следовательно, длительности управляющих импульсов. Таким образом, на нагрузке поддерживается постоянное напряжение.

Резистором R18 в небольших пределах можно изменять выходное напряжение источника 5 В.

Схема защиты от короткого замыкания выполнена на микросхеме У10 и транзисторе Т5, датчиком которой служит трансформатор тока Тр2, включенный последовательно в первичную обмотку трансформатора преобразователя Тр1. При коротком замыкании на выходе источников резко увеличивается ток в первичной обмотке трансформатора преобразователя а, следовательно, и в первичной обмотке трансформатора тока. Во вторичной обмотке трансформатора тока возникает выброс напряжения, который открывает транзистор Т5, образуя на входе микросхемы У10 потенциал "лог.0". На выходе микросхемы У10 тоже создается "лог.0", которым запираются смесители на микросхемах У7, У8 и преобразователь перестает работать. При перенапряжении на нагрузке источника 5 В транзистор Т6 открывается и на выходе микросхемы У10 образуется "лог.0", который подается на вход "R" триггера (микросхема У5).

На выходе триггера (микросхема У5) и, следовательно, на входе элемента микросхемы У6 создается потенциал "лог.1", благодаря чему на выходе этого элемента образуется "лог.0", которым запираются смесители на микросхемах У7 и У8 и преобразователь перестает работать.

Питается схема формирования управляющих импульсов от стабилизированного источника, выполненного на микросхеме У1.

Резистором R3 устанавливают величину стабилизированного напряжения 5 В. Усилитель обратной связи на микросхеме У2 питается от параметрических стабилизаторов напряжения на стабилитронах Д7 и Д8.

Усилители мощности получают питание от стабилизатора, выполненного на микросхеме У9. Резистором R22 регулируют величину стабилизированного напряжения.

Выпрямители источников плюс 5, плюс 15, минус 16, плюс 30 и минус 30 В (см. часть 2 ТО1) выполнены по двухтактной схеме со средней точкой, источников плюс 27 В и плюс-минус 130 В (для питания регулируемого стабилизатора напряжения) выполнены по мостовой схеме.

Все источники имеют Г-образные LC-фильтры.

Источники 15 В и минус 16 В имеют дополнительную линейную стабилизацию и выполнены на микросхемах I42 серии.

Источник минус 16 В выполнен на микросхеме У1 с регулирующим элементом на транзисторе Т1. Резистором R6 устанавливается величина выходного напряжения.






Источник плюс 15 В выполнен на микросхеме У2 с регулирующим элементом на транзисторе Т3. Резистором R12 устанавливается величина выходного напряжения.

Оба источника имеют защиту от короткого замыкания на нагрузке.


5.3. Конструкция

5.3.1. Органы управления и контроля. Органы управления и контроля и присоединительные разъемы расположены на передней панели, боковой и задней стенках прибора.

Внешний вид панели приведен на рис. 21.

- 1 - "  " "2" - индикатор работы прибора в режиме внешнего запуска импульсами положительной полярности или синусоидальным напряжением;
- 2 - "  " "3" - индикатор работы прибора в режиме внешнего запуска импульсами отрицательной полярности;
- 3 - "  " "1" - индикатор работы прибора в режиме внутреннего запуска;
- 4 - "  " "4" - индикатор работы прибора в режиме разового механического пуска;
- 5 - "  " - разъем внешнего запуска;

6 - индикаторы параметров "То", "Тэс", "τ", "D" - для первого (I) режима (режима прямоугольных импульсов "Ш") и "Т", "τф", "τ", "τср", "D" - для второго (II) режима (режима сигналов типа "пила", "треугольник", "трапеция", "Λ");

7 - "  " - ручка регулировки уровня внешнего запуска;

8 - кнопочное поле параметров;

три кнопки поля имеют два значения: при работе в режиме серии прямоугольных импульсов "Ш" (I режим) - верхнее обозначение ("То", "Тэс", "К_{имп}"); при работе в режиме сигналов пилообразной, треугольной или трапецеидальной форм "Λ" (II режим) - нижнее обозначение ("Т", "τф", "τср"), причем две кнопки "D" и "τ" при работе в I режиме обозначают:

D - временной сдвиг серии прямоугольных импульсов;

τ - длительность импульсов в серии;

а во II-м режиме;

D - временной сдвиг сигнала пилообразной, треугольной или трапецеидальной форм;


τ - длительность сигнала пилообразной, треугольной или трапецеидальной форм (по основанию);

9 - СЕТЬ - кнопка включения прибора в сеть;






10 - цифровое кнопочное поле;

11 - индикаторы параметров # СИ, Кимп, А, Б - для первого режима "Ш" и А - для второго режима "Λ";

12 - кнопочное поле режимов и единиц измерений;

13 - "  " - разъем выхода синхроимпульса "I"

14 - ПРГМ - индикатор номера программы;

- 15 - ОШ - индикатор номера ошибки;
- 16 - "  "Г" - индикатор формы выходного импульса: неинвертированный положительный импульс - I режим, сигнал типа "трапеция" - II режим;
- 17 - "  2" - индикатор формы выходного импульса; - положительный инвертированный импульс - I режим,
- 18 - "  3" - индикатор формы выходного импульса: - отрицательный неинвертированный импульс - I режим; - сигнал типа "треугольник" - II режим;
- 19 - "  4" - индикатор формы выходного импульса: - отрицательный инвертированный импульс - I режим; - сигнал типа "пила" - II режим;
- 20 - "  50 Ω " - выходной разъем 9,9 В на нагрузке 50 Ом.
- Внешний вид боковой стенки приведен на рис. 22.
- "2⁰", "2¹", "2²", "2³", "2⁴" - тумблеры для установки кода адреса прибора;
- "МУ" - тумблер установки местного и дистанционного управления ДУ"

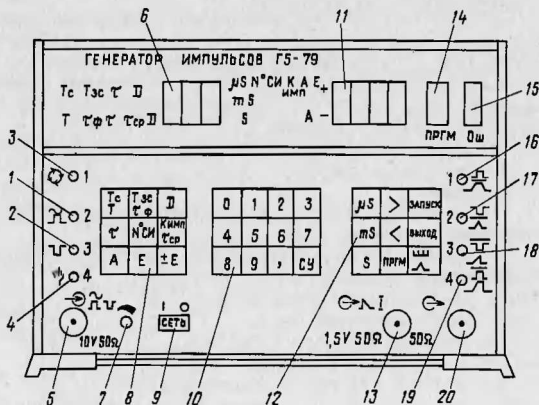


Рис. 21. Внешний вид передней панели прибора

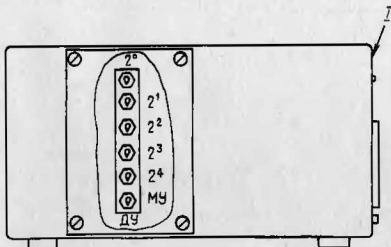


Рис.22. Внешний вид боковой панели:
I - передняя панель

Внешний вид задней стенки приведен на рис.23.

- 1 - "С-ЛШ1,5√50Ω" - выходной разъем синхросигнала "П".
- 2 - "ВЫНОСНОЙ БЛОК" - разъем для присоединения выносного блока.
- 3 - "КОП" - разъем для присоединения прибора к КОП.
- 4 - " ⊕ " " клемма защитного заземления.
- 5 - "220 V 50 Hz , 400 Hz 130 VA " - ввод питающего кабеля
- 6 - "С-ЛШ1,5√50 Ω " - выходной разъем синхросигнала "Ш".
- 7 - счетчик машинного времени.

5.3.2. Описание конструкции

Прибор размещен в унифицированном корпусе "НАДЕЛ-75".

Верхняя часть передней панели представляет собой табло индикации всех параметров прибора, состоящее из индикаторов. В нижней части передней панели расположены органы управления приборами, разъемы внешнего запуска и синхросигнала, кнопка СЕТЬ, выходной разъем.

Управление прибором осуществляется при помощи кнопочных полей.

Работа прибора в каждом режиме индицируется светодиодами.

К верхней части задней стенки прикреплен блок питания, в нижней части размещается разъем для подключения выносного блока, разъем КОП, счетчик наработки, разъемы выходов синхросигналов "П" и "Ш".

Расположение плат в приборе приведено на рис.24.

- 1 - устройство цифровой индикации 3.715;
- 2 - устройство оперативное запоминающее (ОЗУ) 3.731;
- 3 - устройство управления 3.723;
- 4 - автомат управления ДПКД 4.384.
- 5 - делитель частоты 3.728;
- 6 - формирователь выходной 3.724;

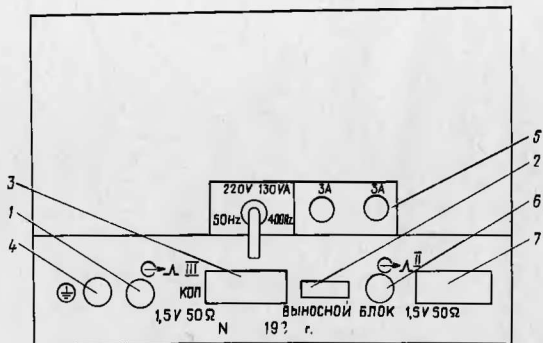


Рис.23. Внешний вид задней отенки

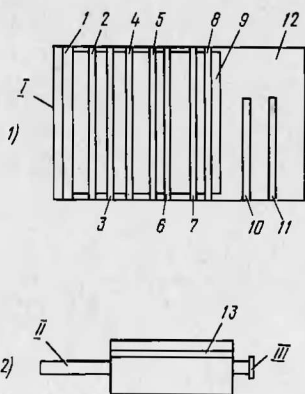


Рис.24. Расположение плат в приборе (вид сверху):
 I - передняя панель; II - кабель переключения; III - выходное гнездо;
 I - основной блок; 2 - выносной блок (формирователь)

- 7 - устройство сопряжения с каналом общего пользования 3.721;
- 8 - выпрямитель 3.720;
- 9 - устройство коммутационное (плата) 3.722;
- 10 - плата преобразователя 3.704;
- 11 - плата управления (преобразователя) - 3.705;
- 12 - преобразователь;
- 13 - блок выносной.

Блок цифровой индикации состоит из двух установленных параллельно друг другу и передней панели плат: устройства цифровой индикации и ОЗУ. Платы соединяются между собой через разъемы по коммутационной плате.

В средней части прибора расположены платы монтажа, размещенные параллельно передней панели и соединенные с коммутационной платой.

Платы закреплены в направляющих.

Преобразователь выполнен в виде отдельного блока, укрепленного на боковых кронштейнах и соединенного с прибором при помощи разъема.

В преобразователе находится тумблер включения сети, соединенный с помощью штока с кнопкой, расположенной на передней панели.

Плата выпрямителя, входящая в блок питания, втапливается в коммутационную плату.

Обшивка корпуса (верхняя и нижняя) перфорированная. Корпус имеет съемные пластмассовые ножки для установки в горизонтальное положение и откидную ножку-подставку для установки прибора в наклонное положение.

На боковой стенке прибора расположена ручка для переноса прибора.

Все функциональные части прибора съемные, что облегчает настройку и ремонт прибора.

Прибор имеет выносной блок, выполненный в отдельном корпусе и соединяющийся с прибором при помощи кабеля длиной 1,5 м и разъема.

Схема выносного блока смонтирована на 2 платах печатного монтажа.

5.3.3. В прибор вмонтирован электрохимический счетчик машинного времени, предназначенный для определения суммарного времени наработки генератора при его эксплуатации. Отсчет проработанного времени производится по делению шкалы, против которого находится мениск столбика ртути.

При суммарном времени наработки 2300-2400 ч необходимо изменить направление отсчета (произвести реверсирование) путем

изменения полярности питания счетчика. В этом случае отсчет ведется в обратном направлении.

Показания счетчика машинного времени при установке его в прибор изготовителем и эксплуатации должны заноситься в формуляр.

6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. На лицевой панели нанесены наименование и условное обозначение генератора.

6.2. Заводской порядковый номер генератора и год изготовления, а также условное обозначение расположены на задней стенке прибора.

6.3. Генератор импульсов Г5-79, принятый ОТК пломбируется мастичными пломбами, которые устанавливаются сзади прибора.

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Произвести расконсервацию прибора согласно п.13.9 настоящего списка.

7.2. Перед началом эксплуатации прибора следует проверить: сохранность пломб;

комплектность согласно табл.4.1;

отсутствие видимых механических повреждений;

наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, плавность вращения ручек органов настройки, наличие предохранителей и т.п.;

состояние соединительных проводов, кабелей, нагрузок;

состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок;

отсутствие механических повреждений или ослабления креплений элементов охемы (определяется на слух при наклонах генератора);

установку тумблера "МУ" на боковой стенке прибора;

при работе прибора со своего кнопочного поля тумблер должен стоять в положении "МУ", а при работе от КОП - в "ДУ".

7.3. При эксплуатации вентиляционные отверстия на корпусе прибора не должны закрываться посторонними предметами. Прибор устанавливается в наклонное положение с помощью откидной ножки-подставки.

7.4. До включения прибора необходимо ознакомиться с разд. 8, 9 настоящего технического описания. Ознакомиться с формуляром и в дальнейшем выполнять его требования.

7.5. Сделать отметку в формуляре о начале эксплуатации и записать показания счетчика машинного времени.

Примечание. Подключение генератора Г5-79 к питающей сети 115 В, 400 Гц осуществляется с помощью трансформатора выносного, изготавливаемого потребителем, имеющего намоточные данные, приведенные в части 2 ТО1.

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. При работе с прибором необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности при работе с электроустановками.

8.2. По электробезопасности прибор выполнен по классу защиты ОI при поставке внутри страны и I при поставке на экспорт ~~и включенных в соглашение о специализации.~~

8.3. Перед включением в сеть необходимо надежно заземлить корпус прибора через зажим защитного заземления " ⊕ ".

Присоединение зажима защитного заземления к заземляющей шине должно производиться до других присоединений, а отсоединение — после всех отсоединений.

8.4. При проведении измерений, при обслуживании и ремонте, в случае использования прибора совместно с другими приборами или включения его в состав установок необходимо для выравнивания потенциалов корпусов соединить между собой соединенные с корпусом клеммы всех приборов (" ⊕ ").

8.5. Включение прибора для регулировки и ремонта со снятыми стенками разрешается только лицам, прошедшим соответствующий инструктаж.

ВНИМАНИЕ. Так как блок питания включает в себя преобразователь, который имеет гальваническую связь с питающей сетью, то, во избежание несчастных случаев и выхода из строя измерительной аппаратуры, настройку, ремонт и проверку блока питания можно производить только при подключении преобразователя в сеть через разделительный трансформатор. Данные разделительного трансформатора приведены в части 2 ТОI.

8.6. При ремонте прибора не допускать соприкосновения с токонесущими элементами, так как в приборе имеется переменное напряжение 220 В и постоянное напряжение 350 В.

Все остальные напряжения, питающие схему прибора, опасности для оператора не представляют.

8.7. Ремонтировать прибор могут лица, имеющие допуск к работе с напряжением до 1000 В.

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1. Перед началом работы следует внимательно изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации, а также ознакомиться с расположением органов управления и контроля на передней панели и задней стенке прибора.

9.2. Разместить прибор на рабочем месте, обеспечив удобство работы и условия естественной вентиляции.

9.3. Проверить надежность заземления.

9.4. Присоединить шнур питания к питающей сети. Переключатель сети должен находиться в выключенном состоянии.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1. Подготовка к проведению измерений

10.1.1. Если прибор внесен в помещение после пребывания при отрицательных температурах ниже минус 30 °С, то перед включением его необходимо выдержать в нормальных условиях в течение 3 часов.

10.1.2. Органы управления могут находиться в произвольном положении.

10.1.3. Кнопку СЕТЬ нажать до совпадения ее риски со знаком "I". Через несколько секунд индикаторы и табло прибора покажут прохождение в приборе контрольного набора параметров $T_c=0,88$ с; $K_{\text{имп}}=2888$; $\text{PRIM}=8$; $\text{Oш}=0$

Если эти параметры не высветились, то надо выключить прибор и снова включить. После появления на индикаторах и табло параметров контрольного набора прибор исправен и готов к работе.

10.1.4. До начала работы необходимо прогреть прибор в течение 15 минут.

10.1.5. Для выбора режима работы и набора параметров на передней панели прибора расположены три поля кнопок клавиатуры:

1-е поле - поле параметров;

2-е - цифровое поле (числовое значение параметров);

3-е - поле выбора режима работы, единиц измерения параметра, номера программы и кнопки знаков приращения параметра в автоматическом режиме.

10.1.6. Установка любого параметра генератора производится нажатием кнопок:

наименование параметра;

величины параметра поразрядно, сначала старший разряд, затем следующие;

единицы измерения параметра.

Признаком конца ввода является нажатие кнопок единиц измерения "μs", "ms" или "s" - для временных параметров или "су" - для амплитудных и безразмерных параметров. Кнопку незначащих нулей можно не нажимать.

Примечания: 1. Одновременно световое табло высвечивает только параметры, относящиеся к одному из режимов: либо серии прямоугольных импульсов ("Tc" или "D" или "Tс" или "τ", "SI" или "K_{имп}" или "E" или "A"), либо сигналов пилообразной, треугольной или трапециевидальной форм ("T" или "D" или "τ_ф" или "τ" или "τ_{ср}").

2. Светящийся индикатор и световое табло показывают параметр и числовое значение его.

3. При изменении величины параметра первая цифра новой величины, (после набора параметра) - старший разряд - стирает прежнее значение его.

Ю.1.7. При работе прибора необходимо учитывать следующее:

1) Если прибор работает в режиме внешнего запуска импульсами или синусоидальным сигналом, микропроцессор прибора не получает сведений о периоде повторения сигналов и оператор должен сам следить за корректностью набора параметров, а именно, чтобы $T_0 \geq d + K_{\text{имп}} T_{\text{зс}}$ при $A \leq 9,9 \text{ В}$ и $T_0 \geq (d + 3 K_{\text{имп}} T_{\text{зс}})$ при $A \geq 10 \text{ В}$ для сигналов прямоугольной формы и $T \geq d + \tau$ при $A < 30 \text{ В}$, $T \geq (d + 3\tau)$ при $A \geq 30 \text{ В}$ - для сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм;

2) Иногда при наборе параметров, когда все значения восстановлены правильно и индикатор "Ош" высвечивает "0", генерации прибора не происходит. Тогда оператору необходимо еще раз повторить набор всех параметров;

3) При работе с прибором оператор должен значить все ошибки, которые он производит в процессе набора параметров и коды которых высвечиваются индикатором "Ош". Коды ошибок приведены в табл.19.

Таблица 19

Коды ошибок

Код ошибки	Причина ошибки	Реакция программы
0	Нет ошибки	Запуск генерации
1	Взаимное несоответствие параметров генерации (некорректный набор параметров, нарушены соотношения) $T_{\text{зс}} < \tau$ при $A < 10 \text{ В}$, $T_{\text{зс}} < 3\tau$ при $A \geq 10 \text{ В}$ $\# \text{ СИ} > K_{\text{имп}}$ $T_0 < d + K_{\text{имп}} \cdot T_{\text{зс}}$ при $A < 10 \text{ В}$ $T_0 < (d + 3 K_{\text{имп}} T_{\text{зс}})$ при $A \geq 10 \text{ В}$ в режиме генерации серии прямоугольных импульсов или $T < d + \tau$ при $A < 30 \text{ В}$ $T < (d + 3\tau)$ при $A \geq 30 \text{ В}$ в режима генерации сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм	Генерация ранее установленного набора
2	Последний символ введен неверно	Введенный символ игнорируется. Генерация ранее установленного режима

Код ошибки	Причина ошибки	Реакция программы
3	Инверсный выходной сигнал запрещен для заданного режима (нарушено соотношение для режима генерации сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм, а также в режиме генерации серий прямоугольных импульсов, когда $A \geq 10 B$. Для них определены только неинвертированная положительная и неинвертированная отрицательная формы выходного сигнала)	Генерация ранее установленного набора
4	Сбой информации при считывании из "памяти" генератора	Генерация ранее установленного набора
5	Параметр выходит за пределы допустимых величин (нарушено соотношение): 1) параметры запуска и выхода лежат в диапазоне от 1 до 4; 2) значения всех параметров лежат в диапазоне от минимального до максимального значения, определенных ТУ	Генерация ранее установленного набора



4) При переходе генератора с режима внутреннего запуска на режим внешнего запуска возможны сбои по амплитуде выходного импульса, необходимо повторить набор параметра "А".

Ю.1.8. При работе от канала общего пользования (КОП) необходимо одновременно выполнение двух условий:

- 1) переключатель дистанционного управления (ДУ), расположенный на боковой стенке прибора, должен находиться в положении "ДУ";
- 2) по линии "ДУ" из КОП подается "лог.0".

Невыполнение этих условий отключает "ДУ" и управление прибором осуществляется с кнопочных полей.




Ю.1.9. Ознакомившись с назначением всех органов управления генератора (разд. 5.3.1), произвести проверку исправности работы прибора с помощью осциллографа С1-108 и С1-65А.


Генератор импульсов Г5-79 установить в режим внутреннего запуска (нажать кнопки ЗАПУСК, затем "1") - должен светиться индикатор "Ш" , режим серии прямоугольных импульсов (кнопка "Ш1") - должны светиться индикаторы, относящиеся к параметрам "Тс" или "D" или "Т_{зс}" или "τ"; "Ш СИ" или "К_{имп}" или "Э" или "А" (верхний ряд светодиодов); выход синхросигналов "Л1"  I,5 √ 50 Ω " соединить со входом синхронизации осциллографа СИ-108. На вход "⊖" осциллографа СИ-108 подать сигнал с передней панели генератора (гнездо "⊖ 50 Ω"). На экране должна наблюдаться серия основных прямоугольных импульсов, с помощью кнопок на передней панели должны регулироваться период повторения серий, период запоминания серий, временной сдвиг, длительность импульсов в серии, количество импульсов в серии, амплитуда до 9,9 В, базовое смещение, полярность. Схема соединения прибора с осциллографом приведена на рис.25.

Затем на вход "⊖" осциллографа СИ-65А подать сигнал с выхода выносного блока.

Схема соединения прибора с выносным блоком и осциллографом СИ-65А приведена на рис.26.

На экране должна наблюдаться серия основных прямоугольных импульсов, должны регулироваться период повторения серий, период заполнения серий, временной сдвиг, длительность импульсов в серии, количество импульсов в серии, амплитуда (от 10 до 99 В), полярность.

Перевести генератор Г5-79 в режим сигналов пилообразной, треугольной или трапецидальной форм (нажать кнопку "Ш" ) - должны светиться индикаторы параметров "Т" или "D" или "τ_ф" или "τ_{ср}", "А" (нижний ряд светодиодов). На экране осциллографа должны наблюдаться сигналы типа "пила", "треугольник", "трапеция" (соответственно светятся индикаторы "Л", "Л", "Л"  или "Л" ) , должны регулироваться период повторения, временной сдвиг, длительность, длительность фронта, среза, амплитуда (если нагрузка подключена к гнезду на передней панели - до 9,9 В, если к выносному блоку - до 99 В).

Для проверки работы в режиме внешнего запуска генератор Г5-79 переводит в соответствующий режим (нажать кнопки ЗАПУСК и "2" или "3"), и на разъем "⊖"  I,5 √ 50 Ω " подать внешние запускающие импульсы (или однополюсное напряжение) от прибора, имеющего параметры, оговоренные в п.3.22 настоящих ТО.

При нажатии кнопок ЗАПУСК и "4" на экране осциллографа должно появиться изображение серии прямоугольных импульсов или одного сигнала типа "пила", "треугольник" или "трапеция", в зависимости от установленного в генераторе режима работы.

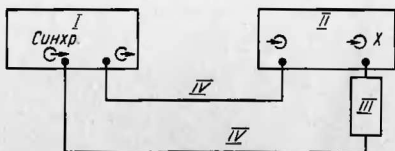


Рис.25. Схема соединений генератора Г5-79 с осциллографом СИ-108 при работе с амплитудой сигналов до 9,9 В:
 I - поверяемый генератор Г5-79; II - осциллограф СИ-108; III - переход 32-II4/3; IV - кабель ВЧ (комплект СИ-108)

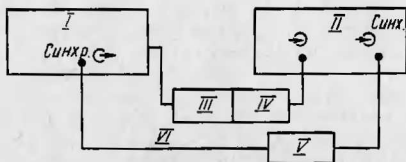


Рис.26. Схема соединений генератора Г5-79 с осциллографом СИ-65А при работе с амплитудой сигналов от 10 до 99 В:
 I - поверяемый генератор Г5-79; II - осциллограф СИ-65А; III - выносной блок; IV - нагрузка 1 кОм; V - нагрузка 50 Ом; VI - кабель ВЧ (комплект Г5-79)

10.1.10. В приборе не надо производить никакой калибровки, но при работе в режиме внешнего запуска от импульсного или синусоидального сигнала устойчивого запуска прибора следует добиваться регулировкой уровня запуска ручкой " ", расположенной на передней панели.

10.1.11. Соединение генератора импульсов Г5-79 с испытуемой схемой (аппаратурой) производится по схеме, приведенной на рис.27.

К выходу генератора Г5-79, расположенному на передней панели, если используется выходное напряжение до 9,9 В, присоединяется кабель ВЧ, к которому подключается нагрузка $R=50 \text{ Ом}$.

Если необходимо использовать выходное напряжение от 10 до 99 В, подключается нагрузка 1 кОм к выходу выносного блока.

Выходное гнездо нагрузки присоединяется к испытуемой аппаратуре.

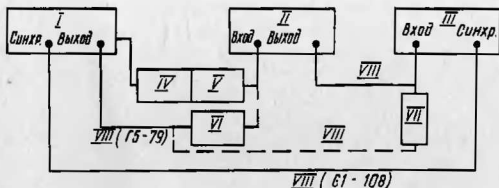


Рис.27. Схема соединений генератора импульсов Г5-79 с испытуемой аппаратурой:

I - генератор Г5-79; II - испытуемая аппаратура; III - осциллограф СИ-108; IV - выносной блок; V - нагрузка 1 кОм; VI - нагрузка 50 Ом; VII - переход БЭ-114/3; VIII - кабель ВЧ

Для контроля работы подсоединяется осциллограф СИ-108, синхронизация которого также осуществляется от генератора импульсов Г5-79 любым из импульсов синхронизации "I", "II", "III".

10.2. Проведение измерений

10.2.1. Прибор обеспечивает следующие возможности работы:

1) по запуску:

внутренний запуск;

внешний запуск импульсами положительной полярности или синусоидальным напряжением;

внешний запуск импульсами отрицательной полярности;

разовый механический пуск;

2) по форме сигналов:

серия неинвертированных прямоугольных импульсов положительной полярности с изменением базового смещения от минус 2 В до плюс 2 В, с амплитудой до 9,9 В;

серия инвертированных импульсов положительной полярности с изменением базового смещения от минус 2 В до плюс 2 В с амплитудой до 9,9 В;

серия неинвертированных прямоугольных импульсов положительной полярности с амплитудой до 99 В;

серия неинвертированных прямоугольных импульсов отрицательной полярности с использованием базового смещения от минус 2 В до плюс 2 В с амплитудой до 9,9 В;

серия инвертированных прямоугольных импульсов отрицательной полярности с использованием базового смещения от минус 2 В до плюс 2 В с амплитудой до 9,9 В;

оерия неинвертированных прямоугольных импульсов отрицательной полярности с амплитудой до 99 В;

одинарные прямоугольные импульсы положительной или отрицательной полярности с периодом повторения от 0,1 мкс до 99,9 с;

одинарные сигналы типа "пила";

одинарные сигналы типа "треугольник";

одинарные сигналы типа "трапеция";

3) по виду изменения величины параметра:

ручное;

автоматическое - любой из вышеописанных режимов работы с автоматическим перебором значений (в пределах единицы измерения) любого параметра, кроме выбора номера синхроимпульса, вида запуска и полярности выходных импульсов;

разового автомата - то же, но при каждом нажатии кнопки

" > " или " < ".

4) программирование:


запись IO программ в память прибора;

считывание любой из записанных IO программ, либо автоматический перебор всех IO программ;

5) работа от КОП.




IO.2.2. Режимы работы.

1) Режим внутреннего запуска.


Для работы в этом режиме необходимо нажать кнопку ЗАПУСК и "1" (должен загореться индикатор "  ") и установить нужные параметры выходных сигналов.

2) Режим внешнего запуска.

Для работы в этом режиме необходимо нажать кнопки ЗАПУСК и "2" или "3" в зависимости от полярности запускающих импульсов или формы запускающего сигнала, подаваемых на гнездо



"  IO $\sqrt{50\Omega}$ " (должен загореться индикатор "  2" или "  3").

3) Режим разового механического запуска.

Для работы в этом режиме необходимо нажать кнопку ЗАПУСК и "4" - должен светиться индикатор "  4". Количество нажатой кнопки "4" соответствует количеству срабатываний генератора.

4) Режим оерий неинвертированных прямоугольных импульсов положительной полярности с амплитудой до 9,9 В и с изменением величины и знака базового смещения.

Для работы в этом режиме необходимо нажать кнопки:

ЗАПУСК и "1" (светится индикатор "  1") и "  " - должны светиться индикаторы "T_c" или "D" или "T_{3c}" или "т", "K СИ" или "K_{дмп}" или "E" или "A";

- Выход и "1" - должен светиться индикатор " $\overline{\Lambda}$ 1".

Выходную нагрузку $R=50 \text{ Ом}$ подключить к гнезду " C 50 Ω " на передней панели. Остальные параметры устанавливает в соответствии с п. 10.1.6.

5) Режим серии инвертированных прямоугольных импульсов положительной полярности с амплитудой до 9,9 В и с изменением величины и знака базового смещения.

Этот режим совпадает по установке с режимом по п.4), но надо нажать кнопки: Выход и "2" - должен светиться индикатор " $\overline{\Lambda}$ 2".

6) Режим серии неизинвертированных прямоугольных импульсов положительной полярности с амплитудой от 10 до 99 В.

Установка этого режима совпадает с п.4), но выходную нагрузку $R=1 \text{ кОм}$ подключают к гнезду на выносном блоке. При этом нельзя работать с базовым смещением.

7) Режим серии неизинвертированных прямоугольных импульсов отрицательной полярности с амплитудой до 9,9 В и с изменением базового смещения.

Этот режим совпадает по установке и подключению к выходному гнезду с п.4), но надо нажать кнопки: Выход и "3" - должен светиться индикатор " $\overline{\Lambda}$ 3".

8) Режим серии инвертированных прямоугольных импульсов отрицательной полярности с амплитудой до 9,9 В с изменением базового смещения.

Этот режим совпадает по установке и подключению к выходному гнезду с п.4), но надо нажать кнопки Выход и "4" - должен светиться индикатор " $\overline{\Lambda}$ 4".

9) Режим серии неизинвертированных прямоугольных импульсов отрицательной полярности с амплитудой от 10 до 99 В.

Установка этого режима совпадает с описанным в п.6), но нажимают кнопки Выход и "3".

10) Режим одиночных прямоугольных импульсов на выходе 50 Ом с периодом повторения 0,1 мкс устанавливается нажатием следующих кнопок:

" $\overline{\Lambda}$ " - режиме серий импульсов;

"Тс" - в положении 1 мкс; *первый серий*

"Тзс" - в положении 0,1 мкс; *первый задержка между сериями*

"т" - в положении 0,05 мкс; *длина*

"д" - в положении 0; *мкс сброса*

"СИ" - в положении "1";

"К_{имп}" - в положении "10". *кол. имп в серии*

Режим одиночных прямоугольных импульсов на выходе 50 Ом с периодом повторения от 0,2 мкс до 0,9 мкс устанавливается при соответствующем сочетании параметров "Тс", "Тзс", "т", "К_{имп}".

Режим одинарных прямоугольных импульсов на выходе 50 Ом и 1 кОм (выход выносного блока) с периодом повторения от 1 мкс до 99,9 с устанавливается следующим образом:

"Ш" - в режим серии импульсов;

"Тс" - в положении 1 мкс и т.д. до 99,9 с;

"К_{имп.}" - в положении 1.

II) Режимы одинарных сигналов типов "пила", "треугольник", "трапеция".

Эти режимы устанавливаются нажатием кнопок:

"Ш" - должны светиться точечные индикаторы "Т" или "D" или "τ_ф", или "τ", или "τ_{ср}", "А".

"τ_ф" и цифр величины параметра в единицах измерения "μs", "ms", "s" - должен светиться цифровой индикатор и индикатор единицы измерения.

Если остальные параметры сигнала равны: $\tau = \tau_{\text{ф}}$; $\tau_{\text{ср}} = 0$, то получим сигнал типа "пила" и справа на передней панели должен светиться индикатор "3" - "А".

Если после "τ_ф" набрали еще и величину "τ_{ср}" и $\tau = \tau_{\text{ф}} + \tau_{\text{ср}}$ получим сигнал типа "треугольник", должен светиться индикатор "2" - "А".

Если же "τ_{ср}" = 0, а набрали " $\tau > \tau_{\text{ф}}$ ", то получим сигнал типа "трапеция" с $\tau_{\text{ср}} = 0$ - должен светиться индикатор "4" - "А".

При наборе параметров "τ_ф" и "τ_{ср}" и $\tau > \tau_{\text{ф}} + \tau_{\text{ср}}$ получим сигнал типа "трапеция", должен светиться индикатор "1" - "А".

12) Режим автоматического перебора значения любого параметра.

Режим автоматического изменения параметров является вспомогательным технологическим режимом и параметры генератора в этом режиме не подлежат нормированию.

Для работы в этом режиме устанавливается любой сигнал, затем нажимается кнопка перехода в автоматический перебор - ">" в сторону увеличения или "<" в сторону уменьшения, кнопка параметра и номера разряда, который надо менять, и на цифровом индикаторе будут светиться цифры перебираемой величины параметра.

Если изменение происходит в сторону увеличения, то перебор будет продолжаться до максимальной величины следующего старшего разряда в пределах одной единицы измерения, а затем опять установится исходное число и опять включится автомат.

Если же изменение происходит в сторону уменьшения, то перебор будет продолжаться до минимальной величины и следующего младшего разряда в пределах одной единицы измерения, а затем опять установится исходное число и опять включится автомат.

Остановка автоматического перебора параметра или режима производится нажатием кнопки "СУ". Может производиться автоматический перебор величины любого параметра и режима, кроме выбора режима работы, вида запуска и полярности выходных сигналов.

При работе в режиме разового автомата устанавливается любой сигнал, затем нажимается два раза любая кнопка перехода в автоматический перебор " > ", " > " или " < " " < " или " < " " > ", кнопка параметра и номера разряда, который надо менять, и на цифровом индикаторе будут светиться цифры перебираемой величины параметра.

После каждого последующего нажатия " > " или " < " происходит увеличение или уменьшение параметра на 1 в заданном разряде. Возврат к установленному значению такой же, как и в автоматическом режиме.

Выход из режима разового автомата по нажатию кнопки "СУ".

13) Режим программирования.

Запись. Для работы в этом режиме набираются все желаемые параметры, затем нажимают кнопки "ПРГМ", "СУ" и любую цифру (от 0 до 9), означающую номер программы. Так можно записать любые 10 программ.

Считывание. Для работы в этом режиме нажимают кнопки "ПРГМ" и цифру, означающую номер вызываемой из памяти прибора программы. На цифровых индикаторах высвечиваются параметры записанной программы.

Автомат прибора может перебирать все 10 программ по очереди, если задать № ПРГМ=1, автомат на увеличение. Можно организовать перебор любого количества программ, так как автомат перебирает программы от заданной программы до 9 при увеличении или до 0 при уменьшении.

14) Режим работы с КОП. Для работы в этом режиме достаточно включить тумблер "ДУ-МУ" в положение "ДУ" и установить тумблерами, расположенными сбоку прибора ("В1-В5"), адрес приборе на прием. При этом кабель канала общего пользования выполняет функции органов управления, расположенных на передней панели.

15) Проверка работы генератора от КОП с помощью анализатора логических состояний 814. Проверку работы генератора от КОП осуществляют по схеме рис.28. с помощью анализатора логических состояний 814 при подаче на шину данных КОП определенных кодов. Последовательность проверки приведена ниже.

С кнопочного поля генераторе (передняя панель) устанавливают режим внутреннего запуска серии выходных импульсов положительной полярности: $T_c = 100$ мкс; $T_{30} = 25$ мкс; $\tau = 20$ мкс; $D = 0,1$ мкс; $A = 5$ В; $K_{имп} = 3$; $B = 0$; № СИ=1; ПРГМ; СУ; 1.

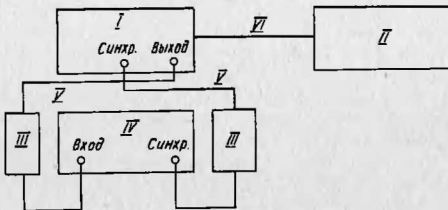


Рис.28. Схема соединений испытываемого генератора Г5-79 с анализатором логических состояний:

I - генератор Г5-79; II - анализатор 8I4; III - нагрузка 50 Ом; IV - осциллограф СИ-65А; У - кабель ВЧ (Г5-79); У1 - кабель КОП

Выходной сигнал с выхода 50 Ом проверяют по осциллографу СИ-65А.

Анализатор логических состояний 8I4 в данном случае работает в режиме передачи данных. Для выполнения данного режима подключают анализатор 8I4 с помощью кабеля КОП к ККП и устанавливают на нем:

- переключатель БЫСТРО-РУЧ-МЕДЛ в положение РУЧ;
- переключатель ПРМ-ПРД-ПРД-КОНТР в положение ПРД (переключателя);
- переключатель T_3 мкс в положение "2";
- переключатели ЧЕТН., КОМПАР., ОК, ДУ, ЗО в нижнее положение;
- переключатели ЗО, ПК, УП (нижние) в положение ОТКЛ;
- переключатели ЛШ - в положение "0".

Затем переключатель МУ-ДУ на боковой стенке генератора Г5-79 устанавливают в положение ДУ, а переключатель ДУ на анализаторе 8I4 в верхнее положение.

Наблюдают невозможность управления генератором Г5-79 со своего кнопочного поля (на нажатие любой кнопки генератор не реагирует).

На анализаторе 8I4 устанавливают:

- переключатель ПАМЯТЬ в положение "32";
- переключатель ПРОСМОТР-РАБОТА-ЗАПИСЬ в положение ЗАПИСЬ;
- переключатель ПРМ-ПРД-ПРД-КОНТР в положение ПРД (переключателя);
- переключатель УП в положение "1";
- нажимают кнопку СБРОС;
- переключателем ОК очищают канал (сначала его переключают в верхнее положение, затем опять в нижнее);

нажимают кнопку ЗАПУСК;
должен светиться индикатор ДД.

Устанавливают переключатель УП в положение "0";
переключатель ПРМ-ПРД-ПРД-КОНТР в положение ПРД (память) и переключателями ДД параметры генератора: $T_0=10$ мкс; $T_{30}=1$ мкс;
 $\tau=0,5$ мкс; $D=0,1$ мкс; $A=5$ В; $K_{\text{ИМП}}=5$; $E=+1$ В; $\% \text{СИ}=4$; полярность - положительная (ВЫХОД-1); ПРГМ "Г" воспользовавшись кодами (табл.20).

Установка параметров переключателями ДД производится следующим образом:

например $T_0=10$ мкс

T_0 - набирают код "50" (01010000) в восьмеричном исчислении - "120", для этого переключатели ДД6, ДД4 в положение "1", а ДД5, ДД3, ДД2, ДД1, ДД0 в положение "0" и нажимают кнопку ЗАПУСК, при этом на панели анализатора светятся индикаторы СТРОКА - высвечивается номер строки, куда происходит запись и ДД7-ДД0 само записываемое число 50 (01010000) в восьмеричном исчислении "120";

набирают "1" - код 31 (00110001) - переключатели ДД5; ДД4 и ДД0 в положении "1", а остальные в положении "0", нажимают кнопку ЗАПУСК, светятся соответствующие индикаторы ДД7-ДД0, "61" и индикаторы строка "1"; набирают "0" - код 30 (00110000), переключатели ДД5, ДД4 в положении "1", остальные в положении "0", нажимают кнопку ЗАПУСК, светятся соответствующие индикаторы ДД - "60", строка "2";

далее набирают размерность параметра - дд - код "42" (01000010), переключатели ДД6, ДД1 в положении "1", остальные в положении "0", нажимают кнопку ЗАПУСК, светятся соответствующие индикаторы ДД, высвечивают цифру "102", строка "3".

Таким образом, на анализаторе набран параметр периода повторения серии десять мкс и записан в память анализатора.

Пользуясь кодами табл.20, следует набрать все остальные параметры генератора и записать их в память анализатора, имея в виду, что запись каждого байта (кода) происходит только после нажатия кнопки ЗАПУСК.

После того, как все параметры набраны и записаны в память, надо в следующую строку памяти записать все "0", т.е. все переключатели ДД устанавливают в положение "0" и нажимают кнопку ЗАПУСК (для образования цикличности повтора запускающих параметров).

Затем необходимо проверить запись в строки памяти параметров генератора, для чего переключатель ПРОСМОТР-РАБОТА-ЗАПИСЬ устанавливают в положение ПРОСМОТР-НАЗАД, переключатель БЫСТРО-РУЧ-МЕДЛ.

в положение РУЧ и нажатием кнопки ЗАПУСК проверяют все строки до начала записи.

Устанавливают переключатель УП в положение "I" и производят адресацию генератора: переключатель ПРОСМОТР-РАБОТА-ЗАПИСЬ - в положении РАБОТА, переключатель ЛД7, ЛД6 - в положении "0", ЛД5-"I", а остальные должны соответствовать положению переключателей, установленных на боковой стенке генератора Г5-79 (положения вниз "0", вверх "I" - 2⁰ соответствует ЛДО анализатора 8I4; 2¹ - ЛД1; 2² - ЛД2; 2³ - ЛД3; 2⁴ - ЛД4 при этом переключатель ПРМ-ПРД-ПРД-КОНТР. устанавливают в положение ПРД (переключатели) и нажимают кнопку ЗАПУСК.

Затем устанавливают все переключатели ЛД в положение "0"; переключатель ПРМ-ПРД-ПРД-КОНТР. в положение ПРД (память); переключатель БЫСТРО-РУЧ-МЕДЛ. в положение МЕДЛ. и нажимают кнопку ЗАПУСК.

Информация, записанная в память анализатора, последовательно и циклично должна передаваться на генератор, что можно видеть по индикаторам генератора Г5-79 и на индикаторах анализатора 8I4.

Подключив осциллограф к выходу Г5-79, наблюдают изменение режима, установленного с кнопочного поля генератора Г5-79 на режим, записанный в память анализатора 8I4.

Для остановки подачи величины параметров с анализатора 8I4 на генератор Г5-79 надо переключатель БЫСТРО-РУЧ-МЕДЛ. установить в положение РУЧ.

Для изменения любого параметра, записанного в память анализатора, надо вызвать нужную строку и записать в нее новую величину параметра, затем передать ее в генератор импульсов Г5-79, пользуясь вышеописанными установками.

Для освобождения генератора Г5-79 от параметров, записанных в анализаторе и возможности его работы со своего кнопочного поля, надо установить переключатель ДУ анализатора в нижнее положение.

Примечание. При последовательной смене параметров генератора Г5-79, в процессе передачи записанной в анализаторе программы, возможно прекращение генерации, при этом в генераторе Г5-79 на индикаторе ОИ высвечивается "I".

II. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

II.1. Для доступа к составным частям прибора при ремонте необходимо отключить прибор от сети, вскрыть его в соответствии с указаниями, приведенными в п. 5.3.

II.2. Прежде чем начать ремонт неисправной составной части, необходимо проверить поступление на нее входных сигналов и наличие номинальных питающих напряжений, руководствуясь приведенными на электрических принципиальных схемах (режимами в контрольных точках и таблицами напряжений на выводах (см. часть 2 ТОI).

II.3. При проведении ремонта следует строго выполнять меры безопасности, указанные в разд. 8.

II.4. Перечень наиболее вероятных неисправностей и указания по их устранению приведены в таб.2I.

II.5. Послегарантийный ремонт прибора производится ремонтной службой предприятия-потребителя, а при необходимости на предприятии-изготовителе по отдельному договору.

Таблица 2I

Внешнее проявление неисправности и дополнительный признак	Вероятная причина	Метод устранения
1. При включении прибора не светится ни один индикатор	Неисправна сетевая вставка плавкая Неисправна сетевая кнопка	Заменить неисправный элемент ПрI или Пр2 в генераторе импульсов (преобразователь) (см. часть 2 ТОI). Исправить или заменить кнопку включения сети ВI (преобразователь)
2. При включении прибора в контрольном наборе на индикаторе ПРГМ горит "0" На индикаторе ошибка, горит "6"	Не совпала контрольная сумма при проверке ПЗУ. Неисправен индикатор Отсутствует сигнал "Готов"	Заменить плату 3.728 Заменить индикатор ПРГМ на плате 3.7I5 Заменить микросхему УI8 и У5I на плате 4.384 (часть 2 ТОI)
3. При наборе параметра на кнопочном поле он не изменяется на цифровом индикаторе, а соответствующий пара-	На элементы У3-У7, УI, УI5, УI9-У22, У26, У30, У34, У38, У42, У46 платы 3.7I5 не поступают	Проверить наличие "лог.1" на конт. 2I5 и "лог.0" на конт.24А-28А разъема ШI-I платы 3.73I.

Внешнее проявление неисправности и дополнительный признак	Вероятная причина	Метод устранения
метр выходного сигнала изменяется	такты импульсы (строб I—строб 5)	Заменить неисправные элементы У2, УП-I, У12 на плате 3.73I (см. часть 2 ТОI)
4. При выборе режима не включается индикатор, но прибор работает в заданном режиме	Неисправен светодиод	Заменить неисправный элемент ДI—Д27 ТОI (плата 3.715)
5. В режиме внутреннего запуска отсутствует синхросигнал "I", а основной сигнал есть	Неисправная схема формирования синхросигнала "I"	Заменить неисправный транзистор ТI на плате автомата управления ДПКД (см. часть 2 ТОI) (плата 4.384)
6. В режиме внутреннего запуска отсутствует синхросигнал "II", а основной сигнал есть	Неисправна схема формирования синхросигнала "II"	Заменить неисправный транзистор Т3 на плате автомата управления ДПКД (см. часть 2 ТОI) (плата 4.384)
7. В режиме внутреннего запуска отсутствует синхросигнал "III", а основной сигнал есть	Неисправна схема формирования синхросигнала "III"	Заменить неисправный транзистор Т2 на плате автомата управления (см. часть 2 ТОI) (плата 4.384)
8. Не регулируется амплитуда серии прямоугольных импульсов положительной или отрицательной полярности на выходе 50 Ом (гнездо на передней панели)	Неисправна схема формирования "отрицательного" тока на конт.3 микросхемы У26	Заменить неисправную микросхему У26 или неисправный транзистор Т3 платы выходного формирователя 3.724
9. Не регулируется амплитуда серии прямоугольных импульсов положительной или отрицательной поляр-	Неисправна схема формирования канала "отрицательного" тока на конт.3 микросхем У26 или нет	Заменить неисправную микросхему У26 платы выходного формирователя 3.724 или заменить неис-

Внешнее проявление неисправности и дополнительный признак	Вероятная причина	Метод устранения
ности на выходе I кОм (гнездо на выносном блоке)	высокого напряжения ± 120 В	правный элемент платы 3.721 - стабилизатор
10. Не регулируется амплитуда линейно-ступенчатых сигналов положительной или отрицательной полярности	Неисправна схема запоминания информации	Заменить неисправные микросхемы У3, У5.3 платы выходного формирователя 3.724
11. При изменении номера программы информация на индикаторах не меняется	Неисправна схема адресации ОЗУ или не меняется содержимое ОЗУ	Заменить неисправный элемент У13 устройства управления (плата 3.723) или У36-У39 платы устройства цифровой индикации 3.715

12. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Настоящий раздел составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 8.206-76 "Генераторы импульсов измерительные. Методы и средства поверки" и устанавливает методы и средства поверки генераторов импульсов Г5-79.

Поверка параметров генераторов импульсов производится не реже одного раза в год.

12.1. Операции и средства поверки

12.1.1. При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 22, 23.

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, проводимых при поверке	Поверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
Г2.3.1.	Внешний осмотр				
Г2.3.2	Опробование				
Г2.3.3	Определение метрологических параметров:				
Г2.3.3.1	- определение диапазона изменения и погрешности установки амплитуды основных прямоугольных импульсов в серии и сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм	<p>Режим "L" при $f_H=50$ Ом I В; 4,8 В; 9,9 В</p> <p>Режим "L" при $f_H=1$ КОм 10 В; 48 В; 99 В</p> <p>Режим "A" при $f_H=50$ Ом; I В; 4,8 В 9,9 В</p> <p>Режим "A" при $f_H=1$ КОм; 10 В; 48 В; 99 В</p>	<p>A=I-9,9 В погрешность установки амплитуды $\leq \pm(0,1A + 0,1 В)$</p> <p>A=10-99 В погрешность установки амплитуды $\leq \pm(0,1A + 1В)$ при $\tau \geq 0,4$ мкс и $\pm(0,2A + 4 В)$ при $\tau = 0,1-0,3$ мкс</p> <p>A=I-9,9 В; погрешность установки амплитуды $\leq \pm(0,1A + 0,1 В)$</p> <p>A=10-99 В погрешность установки амплитуды $\leq \pm(0,1 A + 1 В)$</p>	<p>СИ-108</p> <p>СИ-108, СИ-65А (калибровочный) или СИ-120</p> <p>СИ-108</p> <p>СИ-108, СИ-65А (калибровочный) или СИ-120</p>	


Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, проводимых при поверке	Поверяемые от-метки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения определяемых параметров	Средства по-верки	
				образ-цовые	вспомо-гатель-ные
I2.3.3.2	Определение диапазона изменения и погрешности установки длительности основных прямоугольных импульсов и сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм	Режимы "○" и "□" при $R_n=50 \text{ Ом}$ 0,05; 0,1; 100^* ; $100 \cdot 10^3^*$; $999 \cdot 10^3$ мкс	$\tau=0,05-999 \times 10^3$ мкс; погрешность установки длительности $\leq \pm(0,03 \tau + 0,01 \text{ мкс})$	СИ-108, ЧЗ-54 или ЧЗ-64	
		Режимы: "○" "□" при $R_n=1 \text{ кОм}$ 0,1 [*] ; 0,4; 100^* ; $100 \cdot 10^3^*$; $999 \cdot 10^3$ мкс	$\tau=0,4-999 \times 10^3$ мкс; погрешность установки длительности $\leq \pm(0,03 \tau + 0,03 \text{ мкс})$, а при установке длительности $\tau=0,1-0,3 \text{ мкс}$ $\leq \pm(0,2 \tau + 0,04 \text{ мкс})$	СИ-65А или СИ-120 ЧЗ-54 или ЧЗ-64	
		Режимы: "○" "Λ" при $R_n=$ $=50 \text{ Ом}$ и $R_n=1 \text{ кОм}$ 10 мкс -	"Λ", "Λ" $\tau=10; 20;$ "Λ" 10,1-999х $\times 10^3$ мкс; погрешность	ЧЗ-54 или ЧЗ-64 СИ-65А или СИ-120	

*Здесь и дальше в точках, отмеченных этим знаком, поверяется только работоспособность

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, проводимых при поверке	Поверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
12.3.3.3.	Определение диапазона изменения и погрешности установки периода повторения серий основных импульсов и сигналов пилообразной, треугольной и трапециевидальной форм	<p>"пила", 20 мкс - "треугольник"; 30 мкс - "трапеция" 10 мкс*; 100 мкс* 999. •10³ мкс</p> <p>Режимы: "Ш" и "○" R_н=50 Ом и 1 КОМ 1 мкс; 0,1 мкс*; 0,1* с; 99,9 с</p> <p>Режимы: "Λ" "○" при R_н= =50 Ом (11 мкс ("пила"))</p> <p>0,1 мкс*; 0,1 с*; 99,9 с; при R_н=1 КОМ, 33 мкс</p>	<p>установки длительности $\leq \pm(0,1 \tau +$ $+0,1 \text{ мкс})$</p> <p>T_c=1 мкс - -99,9 с; погрешность установки периода $\leq \pm 0,03 T_c$</p> <p>T=11 мкс- 99,9 с для "Λ"; T=22 мкс- 99,9 с для "Λ"; T=33 мкс - 99,9 с для "Λ"</p> <p>погрешность установки периода $\leq \pm 0,03 T$</p>	43-54 или 43-64	43-54 или 43-64

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, проводимых при поверке	Поверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
12.3.3.4	Определение диапазона изменения и погрешности установки периода заполнения серий	$0,1 \text{ мс}^{\times}$; $0,1 \text{ с}^{\times}$; 99,9 с Режим "III" при $R=$ 50 Ом $0,1 \text{ мкс}^{\times}$; 100 мкс^{\times} ; 100 мс^{\times} ; 9,99 с Режим "III" при $R_{\text{н}}=$ 1 кОм 1 мкс; 100 мкс^{\times} ; 100 мс^{\times} ; 9,99 с	$T_{\text{эс}}=0,1 \text{ мкс}$; 9,99 с, погрешность установки периода заполнения серий $\leq \pm 0,03 T_{\text{эс}}$ $T_{\text{эс}}=1 \text{ мкс}$; 9,99 с погрешность установки периода заполнения $\leq \pm 0,03 T_{\text{эс}}$	ЧЗ-54 или ЧЗ-64	ЧЗ-54 или ЧЗ-64
12.3.3.5	Определение диапазона изменения и погрешности установки временного сдвига серий импульсов и сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм (по основанию) относительно синхросигнала "I"	Режим "III" $0; 0,1 \text{ мкс}$ 100 мкс^{\times} 100 мс^{\times} ; 999 мс	$d=0-999 \text{ мс}$; погрешность установки временного сдвига, $\Delta D: \leq \pm (0,03 + 0,02 \text{ мкс})$; при $d = 0$ $\Delta D \leq 30 \text{ нс}$ для выхода $R_{\text{н}}=50 \text{ Ом}$ и $\leq \pm (0,03 + 0,06 \text{ мкс})$; при $d = 0$ $\Delta D \leq \pm 60 \text{ нс}$ для выхода $R_{\text{н}}=1 \text{ кОм}$	ЧЗ-54 или ЧЗ-64	СИ-108, СИ-65А или СИ-120

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, проводимых при поверке	Поверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
12.3.3.6	Определение диапазона установки количества импульсов в серии	I 4444 9999	$K_{\text{имп}}=I-9999$, дискретность установки I	ЧЗ-54 или ЧЗ-64	
12.3.3.7	Определение длительности фронта и среза основных прямоугольных импульсов	Режим "⌋" при $R_n=50 \text{ Ом}$, $\tau=0,05$; 0, I и 10 мкс	$\tau_{\phi}(\tau_{\text{ср}}) \leq 10 \text{ нс}$	СИ-108	Г5-60
		Режим "⌋" при $R_n=1 \text{ кОм}$, $\tau=0,4$; 10 и 50 мкс	$\tau_{\phi}(\tau_{\text{ср}}) \leq 100 \text{ нс}$	СИ-65А или СИ-120	
12.3.3.8	Определение выбросов до фронта, за фронтом, до среза, за срезом и неравномерности вершины основных прямоугольных импульсов	Режим "⌋" $\tau=0,5 \text{ мкс}$ и $\tau=500 \text{ мкс}$	$\leq \pm 10 \%$ $\leq \pm 5 \%$	СИ-108 СИ-65А или СИ-120	
12.3.3.9	Определение диапазона изменения и погрешности установки длительности фронта и среза	Режим "Λ" 10 мкс; 10 мс [*] ; 100 мс [*] ; 999 мс - $\tau_{\phi}; 0$;	$\tau_{\phi}=10 \text{ мкс}$ - 999 мс $\tau_{\text{ср}}=0$ ("пила") $\tau_{\text{ср}}=0-998 \text{ мс}$, ("трапеция") $\tau_{\text{ср}}=10 \text{ мкс}$ - 998 мс ("тре-	СИ-65А или СИ-120 ЧЗ-54 или ЧЗ-64	Г5-60 СИ-108

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, проводимых при поверке	Поверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
12.3.3.10	сигналов пилообразной, треугольной и трапецизальной формы	10 мкс; 10 мкс ^x ; 100 мкс ^x ; 998 мс- τ_{cp}	угольник") погрешность установки длительности фронта и среза $\pm 0,1 \tau_{ф} (\tau_{cp})$ при $\tau_{сг}=0$ $\Delta \tau_{cp} \leq 1$ мкс	B7-22A или B7-40	
Определение диапазона изменения и погрешности установки величины базового смещения	Режим "  " при $R_n=50$ Ом 0; $\pm 0,1$; $\pm 1,0$; $\pm 2,0$ В	$E=\pm(0-2)$ В; погрешность установки величины базового омещения $\pm(0,1E+0,1$ В)			

Примечания: 1. Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Образцовые и вспомогательные средства поверки должны быть исправны и поверены в органах государственной или ведомственной метрологической службы соответственно.

3. Операции по пп.12.3.3.1...12.3.3.10 должны производиться при выпуске прибора из ремонта.

12.1.2. Технические характеристики образцовых и вспомогательных средств поверки представлены в табл.23.

Таблица 23

Наименование средств поверки	Основные технические характеристики средства поверки		Рекомендуемое средство поверки (тип)	Примечание
	пределы измерения	погрешность		
Осциллограф универсальный	Калиброванная длительность развертки: 0,01 мкс/дел - 50 мс/дел	$\pm 5\%$	СИ-65А или СИ-120	
Осциллограф универсальный	Калиброванный коэффициент отклонения: 0,005 - 10 В/дел	$\pm 5\%$	СИ-108	
	Время нарастания переходной характеристики 1,5 нс. Коэффициент отклонения 0,2 В/дел - 10 В/дел	$\pm 3\%$		
Частотомер электронно-счетный	Калиброванная длительность развертки: 1 нс/дел - 50 мс/дел	$\pm 1\%$	ЧЗ-54 или ЧЗ-64	
	Диапазон измеряемых периодов повторения 1 мкс - пост;	$\pm 1\%$		
	интервалов времени 0,1 мкс - 10 ² с; количество импульсов	$\pm 1\%$		
Генератор импульсов	Амплитуда импульсов 1-10 В; диапазон частот до 10 МГц; временной сдвиг 0-5 с	$\pm 1\%$	Г5-60	Используется как датчик импульсов внешнего запуска
		$\pm 3\%$		
		$\pm 0,1\%$		
Вольтметр универсальный цифровой		$\pm 1\%$	В7-22А или В7-40	
	Диапазон измеряемых напряжений 0,001 В - 1 кВ	$\pm 3\%$		

12.2. Условия поверки и подготовка к ней

12.2.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды $298 \text{ K} \pm 5 \text{ K}$ ($20 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$);

относительная влажность воздуха (65 ± 15) %;

атмосферное давление (100 ± 4) кПа ($750 \text{ мм рт.ст.} \pm 30 \text{ мм рт.ст.}$);

напряжение источника питания $220 \text{ В} \pm 4,4 \text{ В}$, частотой $50 \text{ Гц} \pm 0,5 \text{ Гц}$ и с содержанием гармоник до 5 %.

12.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе "Подготовка к работе" (п. 9.1-9.4), а также:

проверить комплектность изделия;

соединить проводом клемму " ⊕ " поверяемого прибора с клеммой заземления образцового прибора и шиней заземления;

для выравнивания потенциалов корпусов поверяемого прибора и всех участвующих в проведении поверки приборов соединить между собой соединительные с корпусом клеммы всех приборов (" ⊕ ");

подключить поверяемый прибор и образцовые приборы к сети переменного тока напряжением 220 В , частотой 50 Гц ;

включить приборы и дать им прогреться в течение времени, указанного в технических описаниях на них.

12.3. Проведение поверки

12.3.1. Внешний осмотр. При проведении внешнего осмотра должны быть проверены все требования п. 7.2.

Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

12.3.2. Спробование. Спробование прибора производится по пп. 10.1.1-10.1.9.

Неисправные приборы бракуются и направляются в ремонт.

12.3.3. Определение метрологических параметров.

12.3.3.1. Определение диапазона изменения и погрешности установки амплитуды основных прямоугольных импульсов и сигналов пилообразной, треугольной и трапециевидной форм.

Диапазон изменения и погрешность установки амплитуды определяется методом непосредственного измерения и расчета погрешности с помощью осциллографа С1-108 и С1-65А.

Схема соединения приборов приведена на рис.29 и 30.

Измерения проводятся в следующем порядке:

установить в генераторе Г5-79 режим серии импульсов (кнопка " А ");

внутренний запуск (нажать кнопки ЗАПУСК и "Г"); временной сдвиг $0,1 \text{ мкс}$ (D); базовое смещение "0" (E); количество импульсов в серии I ($K_{\text{имп}}$); полярность - положительную (нажать кнопки

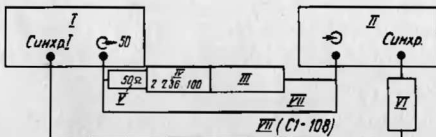


Рис.29. Схема соединения приборов для определения погрешности установки амплитуды на выходе 50 Ом с помощью осциллографа СИ-108:

I - поверяемый генератор Г5-79; II - осциллограф СИ-108; III - делитель 1:50; IV - переход 2.236.100; Y - нагрузка 50 Ом; VI - переход 0.364.030; VII - кабель ВЧ

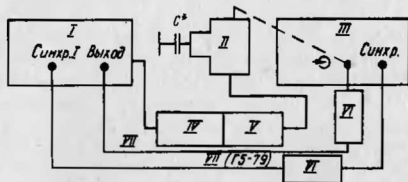


Рис.30. Схема соединения приборов для определения погрешности установки амплитуды на выходе 1 кОм (выносной блок) с помощью осциллографа СИ-65А:

I - поверяемый генератор Г5-79; II - тройник 3.649.000; III - осциллограф СИ-65А; IV - выносной блок; Y - нагрузка 1 кОм; VI - нагрузка 50 Ом; VII - кабель ВЧ

ВЫХОД и "I"); номер синхримипульса - I (нажать кнопку № СИ, "I", СУ);

длительность импульсов 0,05 мкс (τ); период повторения серий I мкс (T_0); период заполнения серий 0,1 мкс (T_c);

подсоединить выход 50 Ом (гнездо на передней панели) с помощью кабеля ВЧ ко входу осциллографа СИ-108 при измерении амплитуды от 1 В до 5 В и с помощью делителя осциллографа 1:50 и перехода при измерении от 5 до 9,9 В;

снять показания осциллографа СИ-108 при следующих значениях: I; 4,8; 9,9 В;

установить длительность импульсов 100 мкс, период заполнения серий 200 мкс (T_{0c}), период повторения серий 500 мкс и проделать те же измерения;

повторить те же измерения для отрицательной полярности импульсов (нажать кнопки "ВЫХОД" и "3");

для проверки амплитуды от 10 до 99 В на нагрузке 1 кОм соединить выносной блок прибора с нагрузкой 1 кОм и подключить ко входу осциллографа СИ-65А, откалиброван его предварительно по осциллографу СИ-108;

установить длительность импульсов в серии 0,4 мкс (τ) и период повторения серий 3,6 мкс (T_c); временной сдвиг $d = 0$, период заполнения серий $T_{30} = 1,2$ мкс;

измерения производить при следующих значениях амплитуды: 10, 48, 99 В;

проделать те же измерения для длительности импульсов 0,1 мкс; 100 мкс; периода повторения серий 3 мкс; 900 мкс и периода заполнения серий 1 и 300 мкс;

повторить те же измерения для отрицательной полярности импульсов;

установить в генераторе Г5-79 режим сигналов пилообразной, треугольной или трапециевидальной формы (нажать кнопку " Δ "), длительность фронта $\tau_{\phi} = 10$ мкс; среза $\tau_{ср} = 0$, период повторения $T = 30$ мкс и 15 мс; полярность - положительная; временной сдвиг $d = 0$;

установить длительность сигналов 20 мкс и 4 мс, соответственно; произвести измерения при установках амплитуды на выходе 50 Ом (передняя панель): 1; 4,8; 9,9 В;

произвести измерения при установках амплитуд на выходе 1 кОм (выносной блок): 10, 48, 99 В, при этом установить

$\tau = 10$ мкс, $\tau_{ср} = 0$, $\tau_{\phi} = 10$ мкс или $\tau_{\phi} = \tau_{ср} = 10$ мкс, $\tau = 20$ мкс или $\tau_{\phi} = \tau_{ср} = 10$ мкс, $\tau = 30$ мкс и $\tau = 4$ мс;

установить период повторения 270 мкс и 36 мс соответственно; повторить те же измерения для отрицательной полярности.

Примечание. Измерение амплитуды свыше 5 В на осциллографе СИ-108 производить с помощью делителя 1:50.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если амплитуда основных прямоугольных импульсов в серии и сигналов пилообразной, треугольной и трапециевидальной формы изменяется от 1 до 9,9 В на нагрузке 50 Ом (передняя панель) и от 10 до 99 В на нагрузке 1 кОм (выход выносного блока) и погрешность установки амплитуды не превышает $\pm(0,1 A + 0,1 B)$ и $\pm(0,1 A + 1 B)$ соответственно, а при $\tau = 0,1 - 0,3$ мкс и $A = 10-99$ В погрешность установки амплитуды не превышает $\pm(0,2 A + 4 B)$.

12.3.3.2. Определение диапазона изменения и погрешности установки длительности основных прямоугольных импульсов и сигналов пилообразной, треугольной и трапециевидальной форм.

Длительность основных прямоугольных импульсов в серии и сигналов пилообразной, треугольной и трапециевидальной формы определя-

ется методом непосредственного измерения с помощью частотомера ЧЗ-54 и осциллографов С1-108 или С1-65А.

Схемы соединения приборов приведены на рис.31, 32, 33 и 34.

Погрешность определяют при установке длительностей 0,05 мкс, 0,1 мкс, 100 мкс^{*}, 100 мс^{*} и 999 мс на выходе 50 Ом (гнездо на передней панели);

0,1 мкс^{*}, 0,4 мкс, 100 мкс^{*}, 100 мс^{*} и 999 мс на выходе 1 кОм (выход выносного блока); 10, 20, 30 мкс; 10 мс^{*}, 100 мс^{*} и 999 мс при установке сигнала пилообразной, треугольной и трапециевидальной форм. При значениях, отмеченных *, проверяется работоспособность.

Измерение длительности 0,05 мкс и 0,1 мкс на выходе 50 Ом и 0,1 мкс и 0,4 мкс на выходе 1 кОм проводят соответственно на осциллографах С1-108 и С1-65А по схемам рис.32 и 30.

На осциллографах установить коэффициенты развертки 10 нс/дел. и 20-50 нс/дел. соответственно и измерения провести на уровне 0,5 амплитуды.

Измерения проводят в следующем порядке:

установить поверяемый генератор Г5-79 и режим внутреннего запуска, амплитуда - 1 и 7,0 В (выход 50 Ом), 10 и 70 В (выход 1 кОм);

период повторения серий - 1,0 мкс и 99,9 мкс (выход 50 Ом) и 8 мкс и 99 мкс (выход 1 кОм);

период заполнения серий - 0,2 мкс (выход 50 Ом) и 1,2 мкс (выход 1 кОм);

временной сдвиг - 0,1 мкс;

количество импульсов в серии - 2;

синхроимпульс "Ш";

номер синхроимпульса № СИ - 1;

базовое смещение - 0;

полярность - положительная и отрицательная;

повторить измерения при переключении номера синхроимпульса № СИ на 2;

определить длительность импульсов по таблице ИЗМЕРЕНИЕ (С1-108) или развертки осциллографа (С1-65А);

соединить генератор Г5-79 с частотомером, как показано на рис.31, причем при измерении длительности с выхода 50 Ом на передней панели частотомера включить нагрузку 50 Ом, и при измерениях длительностей с выхода выносного блока на частотомере включить нагрузку 10 кОм;

установить в генераторе Г5-79;

запуск - внутренний;

полярность - положительная и отрицательная;

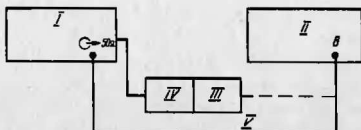


Рис.31. Схема соединений поверяемого генератора с частотомером ЧЗ-54 при определении длительности импульсов:

I - генератор Г5-79; II - частотомер ЧЗ-54; III - нагрузка 1 кОм;
 IV - выносной блок; У - кабель ВЧ (Г5-79)

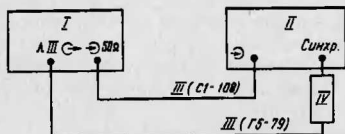


Рис.32. Схема соединений поверяемого генератора с осциллографом С1-108 при определении малых длительностей:

I - генератор Г5-79; II - осциллограф С1-108; III - кабель ВЧ; IV - переход 0.364.030

амплитуда 1 В, а при работе от выносного блока 10 В;
 период повторения серий - см. в табл.24.

Таблица 24.

Длительность импульсов	Период заполнения серий, $T_{зс}$		Период повторения серий, T_c			
			$R_n=50 \text{ Ом}$		$R_n=1 \text{ кОм}$	
	$R_n=50 \text{ Ом}$	$R_n=1 \text{ кОм}$	T_{c1}	T_{c2}	T_{c1}	T_{c2}
100 мкс ^ж	199 мкс	300 мкс	200 мкс	99,9 мс	900 мкс	99,9 мс
100 мс ^ж	199 мс	300 мс	200 мс	999 мс	900 мс	999 мс
999 мс	1 с	3 с	2 с	9,99 с	9 с	9,99 с

временной сдвиг - 0;
 количество импульсов в серии - 1;
 базовое смещение - 0;
 снять показания частотомера;

установить поверяемый генератор Г5-79 в режим сигналов пилообразной, треугольной или трапецидальной форм (нажать кнопку " $\frac{\square}{\Delta}$ "); соединить генератор Г5-79 с частотомером, как показано на рис.33; на генераторе установить:

запуска - внутренний;

полярность - положительная;

длительность фронта - 10 мкс;

амплитуда - 1 В и 10 В;

период повторения сигналов - см. табл.25.

При значениях, отмеченных ж, проверяется работоспособность.

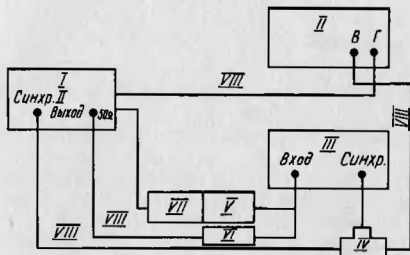


Рис.33. Схема соединений поверяемого генератора с частотомером ЧЗ-54 и осциллографом СИ-65А при измерении длительности сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм:

I - генератор Г5-79; II - частотомер ЧЗ-54; III - осциллограф СИ-65А; IV - тройник (комплект СИ-65А); V - нагрузка 1 кОм; VI - нагрузка 50 Ом; VII - блок выносной; VIII - кабель ВЧ

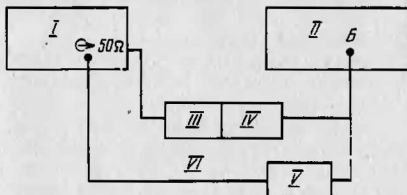






Рис.34. Схема соединений поверяемого генератора с частотомером ЧЗ-54 при определении периода повторения серий или сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм:

I - генератор Г5-79; II - частотомер ЧЗ-54; III - выносной блок; IV - нагрузка 1 кОм; V - нагрузка 50 Ом; VI - кабель ВЧ (Г5-79)

Длительность сигналов, τ	Длительность среза, $\tau_{ор}$	Выход 50 Ом		Выход I кОм	
		T min	T max	T min	T max
10 мкс ()	0	20 мкс		30 мкс	
20 мкс ()	10 мкс	22 мкс	9,99 с	60 мкс	9,99 с
30 мкс ()	10 мкс	33 мкс		90 мкс	
10 мс* ()	10 мкс	11 мс	9,99 с	30 мс	9,99 с
100 мс*	10 мкс	110 мс	9,99 с	300 мс	9,99 с
999 мс	10 мкс	1,1 с	9,99 с	3 с	9,99 с

Измерения длительности произвести по основанию сигнала (см. рис.35) между синхронимпульсами II и III при нажатой кнопке Е.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если длительность основных импульсов в серии регулируется от 0,05 мкс до 999 мс на выходе 50 Ом (гнездо на передней панели), от 0,1 мкс до 999 мс на выходе I кОм (гнездо на выносном блоке), а длительность сигналов пилообразной от 10 мкс до 999 мс, треугольной от 20 мкс до 999 мс и трапециевидальной форм от 10,1 мкс до 999 мс, и погрешность установки длительности основных импульсов не превышает $\pm(0,03\tau + 0,01 \text{ мкс})$ на выходе 50 Ом (гнездо на передней панели), $\pm(0,03\tau + 0,03 \text{ мкс})$ при τ от 0,4 мкс до 999 мс и $\pm(0,2\tau + 0,04 \text{ мкс})$ при τ от 0,1 мкс до 0,3 мкс на выходе I кОм (гнездо на выносном блоке), а сигналов пилообразной, треугольной или трапециевидальной форм $\pm(0,1\tau + 0,1 \text{ мкс})$.

12.3.3.3. Определение диапазона изменения и погрешности установки периода повторения серий основных импульсов и сигналов пилообразной, треугольной и трапециевидальной форм.

Период повторения серий и сигналов пилообразной, треугольной и трапециевидальной форм определяется методом непосредственного измерения с помощью частотомера ЧЗ-54.

Схема соединения приборов показана на рис.34.

Погрешность установки определяют при значениях периода повторения серий I мкс, 0,1 мс*, 0,1 с*, 99,9 с при установке серии импульсов и II мкс (на нагрузке 50 Ом) при установке сигнала типа "пила"; 33 мкс (на нагрузке I кОм) 0,1 мс*, 0,1 с*, 99,9 с (на нагрузке 50 Ом и I кОм) при установке сигнала пилообразной, треугольной и трапециевидальной формы. При значениях, отмеченных *, проверяется работоспособность.

Измерения проводятся в следующем порядке:

подготовить частотомер ЧЗ-54 к работе в режиме измерения периода повторения;

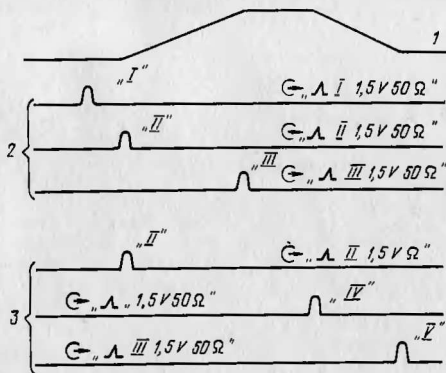


Рис. 35. Временные диаграммы:

1 - выход; 2 - режим работы; 3 - режим измерения (нажата кнопка В-[2])

установить поверяемый генератор в режим внутреннего запуска серии прямоугольных импульсов (нажать кнопки ЗАПУСК; "I" и " \square ") полярность импульсов - положительная; амплитуда - I и 10 В; длительность - 0,1 мкс; период заполнения серий - 0,3 мкс " \ominus 50 Ом и 1 мкс " \ominus 1 кОм"; временной сдвиг - 0, количество импульсов в серии - I; базовое смещение - 0;

соединить гнездо на передней панели генератора Г5-79 с частотометром, как показано на рис.34;

снять показания частотомера для $R_H=50$ Ом;

соединить гнездо выносного блока генератора Г5-79 с частотометром (см. рис.34);

снять показания частотомера для $R_H=1$ кОм;

установить поверяемый генератор в режим внутреннего запуска сигналов пилообразной, треугольной или трапецидальной форм, (нажать кнопки ЗАПУСК, "I" и " \square ") полярность сигналов положительная, длительность сигналов 10 мкс, $\tau_{ФР} = 10$ мкс;

соединить гнездо " \ominus 50 Ω " передней панели генератора Г5-79 с частотометром;

снять показания частотомера;

соединить гнездо на выносном блоке генератора Г5-79 с частотометром;

снять показания частотомера.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если период повторения серий регулируется от 1 мкс до 99,9 с, а сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм от 11, 22 или 33 мкс до 99,9 с, соответственно и погрешность установки периода повторения не превышает $\pm 0,03 T_c$ ($\pm 0,03 T$).

12.3.3.4. Определение диапазона изменений и погрешности установки периода заполнения серий. Период заполнения серий определяется методом непосредственного измерения с помощью частотомера ЧЗ-54.

Схема соединений прибора приведена на рис.31.

Погрешность определяют при значениях периодов заполнения 0,1 мкс*; 100 мкс*, 100 мс*, 9,99 с на выходе 50 Ом (гнездо на передней панели) и 1 мкс, 100 мкс*, 100 мс*, 9,99 с на выходе 1 кОм (гнездо на выносном блоке). При значениях, отмеченных *, проверяется работоспособность.

Измерения проводят в следующем порядке:

установить поверяемый генератор импульсов Г5-79 в режим внутреннего запуска серии прямоугольных импульсов (нажать кнопки ЗАПУСК, "Г", " λ "), полярность импульсов положительная, амплитуда 1 В и 10 В, временной сдвиг - 0, базовое смещение 0;

длительность импульсов, период повторения серий и количество импульсов в серии см. табл.26.

Таблица 26

Период заполнения серий, T_{3c}	Длительность импульсов	Период повторения серий, T_c	Количество импульсов, $K_{имп}$
0,1 мкс* (вых. 50 Ом)	0,05 мкс	50 мкс	2
1 мкс (вых. 1 кОм)	0,1 мкс	50 мкс	2
100 мкс*	10 мкс	600 мкс	2
100 мс*	1 мс	600 мс	2
9,99 с	10 мс	60,0 с	2

Подготовить частотомер для определения интервала времени между двумя перепадами одной полярности. Снять показания частотомера.

Период повторения одиночных импульсов 0,1 мкс определяется измерением частоты повторения ($f = \frac{1}{T_{3c}}$) с помощью частотомера

ЧЗ-54 (см. рис.34), но поверяемый генератор подключается ко входу "А" частотомера.

На генераторе устанавливаются следующие параметры:
 период повторения серий T_c - 1 мкс;
 период заполнения серий $T_{зс}$ - 0,1 мкс;
 временной сдвиг D - 0;
 длительность импульсов τ - 0,05 мкс;
 количество импульсов в серии $K_{имп}$ - 10; амплитуда A - 1 В;
 базовое смещение E - 0;
 номер синхроимпульса - 1;

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если период заполнения серий регулируется от 0,1 мкс до 9,99 с на выходе 50 Ом (гнездо на передней панели) и от 1 мкс до 99,9 с на выходе 1 кОм (гнездо на выносном блоке) и погрешность установки периода заполнения серий не превышает $\pm 0,03 T_{зс}$.

12.3.3.5. Определение диапазона изменения и погрешности установки временного сдвига.

Временной сдвиг серии импульсов или сигналов пилообразной, треугольной и трапецидальной форм относительно синхроимпульса "1" (по основанию) определяется методом непосредственного измерения с помощью частотомера ЧЗ-54 с блоком временных интервалов в диапазоне от 0,2 мкс до 999 мс, а при $D = 0$ и 0,1 мкс - с помощью осциллографа СИ-108 при измерениях с выхода 50 Ом (выход на передней панели) и осциллографа СИ-65А при измерениях с выхода 1 кОм (выносной блок).

Схема соединения приборов приведена на рис.36, 37 и 38.

Погрешность установки временного сдвига определяется при установках временного сдвига 0; 0,1 мкс; 100 мкс^{*}; 100 мс^{*}; 999 мс.

Измерения проводятся в следующем порядке:

установить на поверяемом генераторе Г5-79 внешний запуск (нажать кнопки ЗАПУСК "2"), полярность сигналов положительная;
 длительность импульсов в серии - 0,1 мкс; амплитуда 1,5 В с выхода 50 Ом, 10 В с выхода 1 кОм, количество импульсов в серии - 1; период заполнения серии - 1 мкс; базовое смещение - 0; период повторения серий см. табл.27.

Таблица 27

Временной сдвиг	Период повторения серий		Примечание
	T_c min; $T_{зс}$	T_c max; $T_{зс}$	
0	100 мкс	500 мкс	При установке временного сдвига, отмеченного звездочкой "ж", проверяют только работоспособность генератора
0,1 мкс	100 мкс	1 мс	
100 мкс [*]	500 мс	9,99 с	
100 мс [*]	500 мс	9,99 с	
999 мс	3 с	9,99 с	

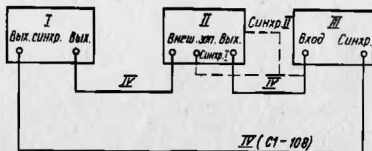


Рис. 36. Схема соединений генератора Г5-79 с осциллографом С1-108 при измерении малых временных сдвигов:

I - поверяемый генератор Г5-60; II - испытуемый генератор Г5-79; III - осциллограф С1-108; IV - кабель ВЧ

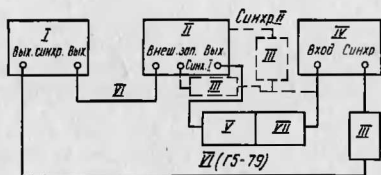


Рис. 37. Схема соединений генератора Г5-79 с осциллографом С1-65А при измерении малых временных сдвигов:

I - запускающий генератор Г5-60; II - поверяемый генератор Г5-79; III - нагрузка 50 Ом; IV - осциллограф С1-65А; V - выносной блок; VI - кабель ВЧ; VII - нагрузка I кОм

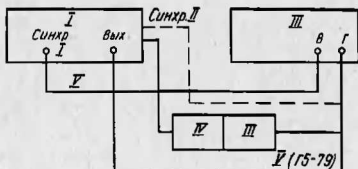


Рис. 38. Схема соединений генератора Г5-79 с частотомером ЧЗ-54 при измерении временного сдвига:

I - поверяемый генератор Г5-79; II - частотомер ЧЗ-54; III - нагрузка I кОм; IV - выносной блок; V - кабель ВЧ

Длительность фронта и среза при работе в режиме сигналов пилообразной, треугольной или трапециевидальной форм - 10 мкс.

Измерение временного сдвига сигналов пилообразной, треугольной или трапециевидальной форм проводят по схеме соединения на рис.36, но в качестве второго сигнала (вместо сигнала пилообразной, треугольной и трапециевидальной форм) используют синхриимпульс "П", совпадающий с началом данного вида сигнала, запуск генератора - внутренний.

Подготовить частотомер к измерениям временного сдвига, при этом подсоединить приборы, как указано на рис.36. Затем снять показания частотомера. После чего подсоединить приборы, как показано на рис.37 и 38.

На запуском генераторе период следования установить равным T из табл.12.6, амплитуду импульсов - 3 В, полярность - положительная, длительность импульса - 0,1 мкс, запуск - внутренний.

Откалибровать развертку осциллографа и снять показания осциллографа по таблице ИЗМЕРЕНИЕ на осциллографе С1-108 и показания осциллографа С1-65А.



Результаты поверки считаются удовлетворительными, если величина временного сдвига регулируется от 0 до 999 мс и погрешность установки временного сдвига не превышает $\pm(0,03 D + 0,02 \text{ мкс})$, а при установке $D = 0$ погрешность $\pm 0,03$ мкс для выхода 50 Ом и $\pm(0,03 D + 0,06 \text{ мкс})$, а при $D = 0$ погрешность $\pm 0,06$ мкс для выхода 1 кОм.

12.3.3.6. Определение диапазона установки количества импульсов в серии. Количество импульсов в серии подсчитывается методом непосредственного счета с помощью частотомера ЧЗ-54.

Схема соединений приборов для подсчета количества импульсов приведена на рис.39.

Определение количества импульсов производится при установке числа импульсов: 1, 4444, 9999.

Измерения проводятся следующим образом:

установить в поверяемом генераторе режим ручного механического пуска серии прямоугольных импульсов (нажать кнопки ЗАПУСК, "4", "  ") или период повторения серий $T_c = 99,9$ с (нажать кнопки ЗАПУСК, "1", "  "), полярность импульсов в серии положительная (нажать кнопки ВЫХОД и "1"), амплитуду 1 В при проверке с выхода 50 Ом (гнездо на передней панели) и 10 В при проверке с выхода выносного блока, длительность импульсов в серии 1 мкс, период заполнения серий 3 мкс, временной сдвиг - 0, базовое смещение 0;

подготовить частотомер к работе с подсчетом количества импульсов (нажать кнопку СБРОС);

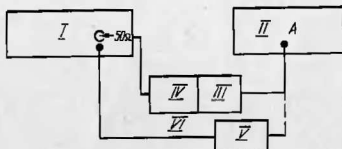


Рис.39. Схема соединений поверяемого генератора с частотомером ЧЗ-54 при определении количества импульсов в серии:
 I - поверяемый генератор Г5-79; II - частотомер ЧЗ-54; III - нагрузка I кОм; IV - выносной блок; V - нагрузка 50 Ом; VI - кабель ВЧ (Г5-79)

нажать на поверяемом генераторе кнопку ЗАПУСК, "4";
 считать показания частотомера;
 обростить показания частотомера и снова нажать кнопку "4"
 поверяемого генератора и т.д. (три-четыре раза).

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если количество импульсов в серии регулируется от I до 9999.

12.3.3.7. Определение длительности фронта и среза основных прямоугольных импульсов.

Длительность фронта и среза импульсов определяют методом непосредственного измерения о последующим вычислением с помощью осциллографа СИ-108 и генератора импульсов Г5-60 на выходе 50 Ом (выход на передней панели), осциллографе СИ-65А и генератора импульсов Г5-60 на выходе I кОм (гнездо на выносном блоке).

Схема соединений приборов приведена на рис.40, 41.

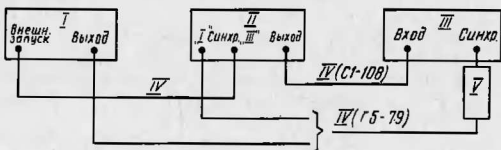


Рис.40. Схема соединений поверяемого генератора с осциллографом СИ-108 для измерения длительности фронта и среза:

I - генератор импульсов Г5-60; II - поверяемый генератор Г5-79;
 III - осциллограф СИ-108; IV - кабель ВЧ; V - переход 32-П14/3

Измерения приводятся в следующем порядке:
установить на поверяемом генераторе Г5-79 режим внутреннего запуска серии прямоугольных импульсов (нажать кнопки ЗАПУСК "Г", "А"), полярность импульсов положительная и отрицательная, амплитуда 5 В и 50 В, временной сдвиг 0, базовое смещение 0;

номер синхроимпульса "Ш" соответствует номеру измеряемого импульса;

длительность импульсов в серии, период повторения серий, период заполнения серий и количество импульсов в серии см. табл.28;

откалибровать развертку осциллографа С1-108, выбрать коэффициент развертки таким, чтобы ширина изображения определяемого участка занимала на экране осциллографа не менее одного большого деления по оси X;

определить длительность фронта и среза при $\tau = 0,05$ мкс между уровнями 0,1 и 0,9 от установленной амплитуды (между опорной и отсчетной метками) по таблице ИЗМЕРЕНИЕ.

Аналогично определить длительность среза, используя генератор импульсов Г5-60 (см. рис. 40); на генераторе импульсов Г5-60 установить временной сдвиг таким, чтобы на экран осциллографа вывести срез импульса;

произвести измерение при переключении полярности на отрицательную (нажать кнопки ВЫХОД и "З");

откалибровать развертку осциллографа С1-65А;

соединить приборы по схеме, приведенной на рис. 41;

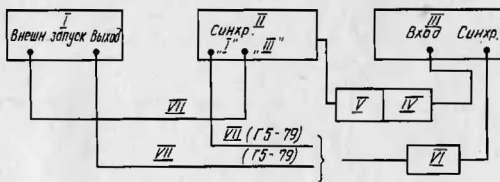


Рис.41. Схема соединений поверяемого генератора с осциллографом

С1-65А для определения длительности фронта и среза:

I - генератор импульсов Г5-60; II - поверяемый генератор Г5-79; III - осциллограф С1-65А; IV - нагрузка 1 кОм; V - выносной блок; VI - нагрузка 50 Ом; VII - кабель ВЧ

Таблица 23

Длительность (τ), мкс	Выход I кОм	Период повторения се- рий (T_c)		Период заполнения серий ($T_{зс}$)		Количество импульсов ($N_{имп}$)	
		Выход 50 Ом	Выход I кОм	Выход 50 Ом	Выход I кОм	Выход 50 Ом	Выход I кОм
0,05 мкс	0,4 мкс	I мкс	7,2 мкс	0,1 мкс	1,2 мкс	5	2
0,1 мкс	10 мкс	20 мкс	90 мкс	I мкс	30 мкс	10	I
10 мкс	50 мкс	40 мкс	I мс	15 мкс	150 мкс	I	I
0,5 мкс*	0,5 мкс*	5 мкс	5 мкс	0,6 мкс	1,5 мкс	I	I

*На этой длительности производится измерение выбросов.

определить длительность фронта (τ_{ϕ}) и среза (τ_{op}) по формулам (I2.1) и (I2.2)

$$\tau_{\phi} = KXl \quad (I2.1)$$

$$\tau_{op} = KXl \quad (I2.2)$$

где τ_{ϕ} (τ_{op}) - длительность фронта (среза);

KX - коэффициент развертки осциллографа;

l - измеренное значение развертки между уровнями 0,1-0,9 установленной амплитуды, в делениях;

произвести измерения при отрицательной полярности импульса.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если величина длительности фронта и среза не превышает 10 нс на выходе 50 Ом (гнездо на передней панели) и 100 нс на выходе 1 кОм (гнездо на выносном блоке).

I2.3.3.8. Определение величины выбросов до фронта, за фронтом, до среза, за срезом прямоугольных импульсов, а также неравномерности вершины основных прямоугольных импульсов.

Величина выбросов и неравномерность вершины импульсов определяется непосредственным измерением с помощью осциллографов CI-108 и CI-65A.

Схемы осциллограмм приведены на рис. 40 и 41.

Измерение величины выбросов и неравномерности вершины проводится при установке на осциллографе минимально возможного коэффициента отклонения. Ручками " v /дел" и " l " осциллографов CI-65A и CI-108 устанавливают изображения выброса или вершины импульса на середину экрана. Отсчет величины выброса на осциллографе CI-108 при $\tau = 0,5$ мкс (см. табл.28) производится между опорной меткой на уровне установки амплитуды и отсчетной меткой на уровне выброса по табл. ИЗМЕРЕНИЕ.

Отсчет величины выброса на осциллографе CI-65A проводится относительно установившейся части импульса при длительности импульса 0,5 мкс.

Относительное значение амплитуды выбросов в процентах рассчитывают по формуле I2.3.

$$A_{\phi} = \frac{h_x}{h_A} \cdot 100 \quad (I2.3)$$

где h_x - измеренное значение амплитуды выбросов, мм;

h_A - установленное значение амплитуды, мм.

Отсчет величины неравномерности вершины импульса проводится относительно установленной амплитуды импульсов при значении длительности импульсов 500 мкс, периоде заполнения серий 1,5 мс, пе-

при повторении серий 4,5 мс и $K_{\text{ИМП}}=1$ по таблице ИЗМЕРЕНИЕ на осциллографе CI-108, а на осциллографе CI-65A рассчитывается относительное значение неравномерности вершины в процентах по формуле I2.4.

$$A_B = \frac{h_x}{h_A} \cdot 100 \quad (I2.4)$$

где h_x - измеренное значение неравномерности вершины, мм;

h_A - установленное значение амплитуды, мм.


Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительная величина амплитуды выбросов до фронта, за фронтом, до среза, за срезом не превышает 10 %, а неравномерность вершины не превышает 5 %.

I2.3.3.9. Определение диапазона изменения и погрешности установки длительности фронта и среза сигналов пилообразной, треугольной или трапециoidalной форм.

Длительность фронта и среза сигналов определяется косвенным изменением с помощью частотомера ЧЗ-54 и осциллографа CI-65A.



Схема соединений приборов приведена на рис. 33. Погрешность определяют при следующих значениях длительностей фронта 10 мкс, 10 мс*, 100 мс*, 999 мс и среза 0, 10 мкс, 10 мс*, 100 мс*, 998 мс.

Измерения проводятся в следующем порядке:

установить на поверяемом генераторе Г5-79 режим внутреннего запуска сигналов пилообразной, треугольной и трапециoidalной форм (нажать кнопки ЗАПУСК, "1" и "  "), полярность сигналов положительная (нажать кнопки ВЫХОД, "1") и отрицательная (нажать кнопки ВЫХОД, "3"), амплитуда 5 В (подключен выход с передней панели) и 50 В (подключен выход выносного блока); период повторения сигналов 9,99 с; временной сдвиг 0; длительность сигналов 999 мс;

соединить приборы как показано на рис. 33.

Измерения длительности фронта проводят между синхроимпульсами "П" и "Ш" при подаче синхроимпульса "П" на вход "В" частотомера, а синхроимпульса "Ш" на вход "Г".

Измерение длительности среза проводят между синхроимпульсами "1У" и "У" при подаче синхроимпульса "1У" на вход "В" частотомера и синхроимпульса "У" на вход "Г" (нажата кнопка "Е"). Синхроимпульсы "1У" и "У" появляются на выходах  1,5V 50Ω "  Ш 1,5V 50Ω "; а на индикаторе $K_{\text{ИМП}}$ в младшем разряде появится "2"; на осциллографе CI-65A (при $T=50$ мкс, $\tau=10$ мкс, $\tau_{\text{Ф}}=10$ мкс) измерить величину длительности среза при установке $\tau_{\text{ср}}=0$ на уровне 0,1-0,9 амплитуды при синхронизации импульсом "Ш".

Измененные значения $\tau_{\text{ср}}=0$ производить при полярности сигналов (положительная и отрицательная) и амплитуде 5В на выходе 50 Ом.

Определить временной интервал между синхроимпульсами П и Ш и между синхроимпульсами IV и У.

Результат поверки считается удовлетворительным, если длительность фронта регулируется от 10 мкс до 999 мс, а среза от 0 до 998 мс и погрешность установки длительности фронта и среза не превышает $\pm 0,1 \tau_{\text{ф}}(\tau_{\text{ср}})$, а при установке длительности среза, равного нулю ($\tau_{\text{ср}}=0$), погрешность установки не более 1 мкс.

12.3.3.10. Определение диапазона изменения и погрешности установки базового смещения. Диапазон изменения и погрешность установки базового смещения определяются методом непосредственного измерения напряжения с помощью вольтметра В7-22А, работающего в режиме измерения постоянного тока.

Схема соединения поверяемого генератора с вольтметром приведена на рис. 42.

Погрешность установки определяют при следующих положениях смещения:

0; 0,1; 1,0; 2 В положительной и отрицательной полярности.

Измерения проводятся в следующем порядке:

установить в поверяемом генераторе Г5-79 внутренний запуск серии прямоугольных импульсов (нажать кнопки ЗАПУСК, "Г", " $\frac{\square}{\lambda}$ ") амплитуду импульсов в серии 0,1 В; длительность импульсов в серии 0,05 мкс, период повторения серий $T_0 = 2$ мс, временной сдвиг 0, количество импульсов в серии 1, период заполнения серий - 1 мкс;

произвести измерение величины базового смещения по вольтметру.

После проверки установленных величин базового смещения в поверяемом генераторе установить амплитуду 7,9 В и базовое смещение ± 2 В.

По методике п.12.3.3.1 провести измерение амплитуды импульсов и наблюдать неискаженную форму сигналов при $\tau = 0,2$ мкс положительной и отрицательной полярности.




Рис.42. Схема соединений поверяемого генератора с вольтметром

В7-22А в режиме измерения величины базового смещения:

I - поверяемый генератор Г5-79; II - вольтметр В7-22А; III - кабель ВЧ; IV - нагрузка 50 Ом; V - тройник

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если величина базового смещения регулируется от 0 до ± 2 В и погрешность установки не превышает $\pm(0,1 E \pm 0,1 B)$.

12.4. Оформление результатов поверки

Оформление положительных результатов поверки должно производиться одним из следующих способов:

1) клеймением поверенных средств измерений с обязательной записью результатов поверки в формуляре;

2) выдачей "Свидетельств о поверке" установленной формы с указанием в нем результатов поверки;

3) запись результатов поверки в формуляре, заверенной подписью поверителя и оттиском поверительного клейма.

Приборы, имеющие отрицательные результаты поверки, в обращение не допускаются.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

13.1. Приборы, поступающие на оклад потребителя, могут храниться в стапливаемом хранилище в упакованном или неупакованном виде в течение 10 лет или в неотапливаемом хранилище в упакованном виде в течение 5 лет со дня поступления.

13.2. Условия хранения в стапливаемом хранилище:

- температура воздуха от 5 до 40 °С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

Условия хранения в неотапливаемом хранилище:

- температура воздуха от минус 55 до плюс 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

13.3. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

13.4. В случае длительного хранения приборы должны быть подвергнуты консервации, условия хранения должны соответствовать приведенным в п. 13.2.

13.5. Консервация производится помещением прибора в чехол из полимерной пленки с силикагелем - осушителем. Силикагель - осушитель распределяют по мешочкам.

13.6. Мешочки с силикагелем размещают и с применением барьерных прослоек плотно закрепляют на приборе.

Мешочки с силикагелем не должны касаться поверхности прибора.

13.7. Прибор в укладочном ящике вместе с мешочками с силика-

гелем-осушителем помещается в чехол из полимерной пленки, из чехла откачивают воздух, после чего чехол заваривают.

13.8. Дальнейшая упаковка производится согласно п.14.1.

13.9. Расконсервация осуществляется снятием пленки и удалением мешочков с силикагелем-осушителем.

13.10. Приборы, находящиеся на длительном хранении, подлежат переконсервации через 3 года хранения.

13.11. После расконсервации прибор необходимо поверить в соответствии с разделом 12.

13.12. В течение гарантийного срока потребитель обязан сохранять транспортную упаковку, в которой прибыл прибор.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

14.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки

14.1.1. Для упаковки генератора Г5-79 при транспортировании используются укладочный и транспортный ящики.

14.1.2. Упаковку следует производить в помещении с относительной влажностью воздуха до 80 % при температуре от 15 до 35 °С.

14.1.3. Упаковка прибора перед транспортированием производится в следующей последовательности: на дно укладочного ящика разместить упаковку из пенопласта с запасными платами, закрепить ее;

поместить прибор, комплект ЭИП и уложенную в полиэтиленовый чехол эксплуатационную документацию в соответствующие ячейки укладочного ящика (туда же поместить мешочки с силикагелем);

закрыть укладочный ящик на замки и опломбировать;

поместить укладочный ящик в полиэтиленовый чехол, из чехла откачать воздух, чехол заварить;

ныюлать транспортный ящик изнутри влагонепроницаемой бумагой;

поместить укладочный ящик в чехле в транспортный ящик;

заполнить до уплотнения пространство между стенками укладочного и транспортного ящиков амортизирующим материалом;

поместить на верхний слой амортизирующего материала товароопроводительную документацию;

закрепить крышку транспортного ящика гвоздями;

опантовать транспортный ящик стальной лентой. Ящик опломбировать.

14.1.4. Маркировка и места расположения пломб на транспортном ящике приведены на рис. 43.

14.1.5. Размещение прибора в таре и укладочном ящике приведено на рис. 44 и 45.

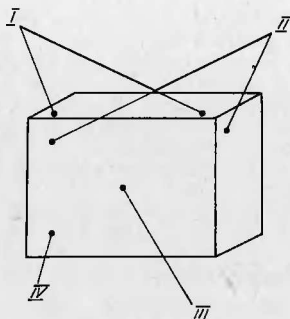


Рис.43. Маркировка и места расположения пломб на транспортном ящике: I - пломбы; II - манипуляционные знаки; III - основные надписи; IV - дополнительные надписи

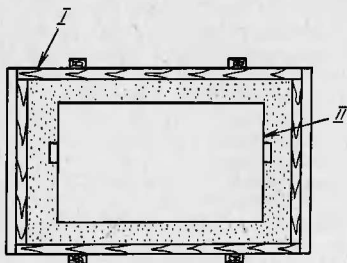


Рис.44. Схема размещения прибора в таре и укладочном ящике: I - транспортная тара; II - укладочный ящик

14.2. Условия транспортирования

14.2.1. Транспортировать приборы, упакованные в соответствии с подразделом 14.1, разрешается всеми видами транспорта в транспортном ящике при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 65 °С относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

Допускается транспортирование на колесных шасси в эксплуатационном состоянии без работы на ходу.

И4.2.2. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого воздействия пыли. Не допускается кантование прибора. Должна быть исключена возможность смещения и соударения ящиков.

И4.2.3. При необходимости транспортирования прибора вторичная упаковка производится в соответствии с подразделом И4.1.

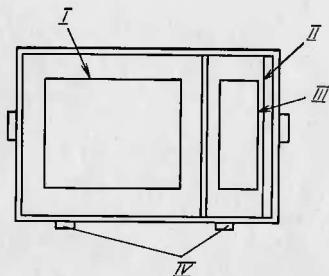


Рис.45. Схема размещения прибора и комплекта ЗИП в укладочном ящике:
I - прибор; II - эксплуатационная документация; III - комплект ЗИП;
IV - места пломбирования