

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ  
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ

**Г4-129**

**Техническое  
описание и инструкция  
по эксплуатации**

**3.260.101 ТО**

*14628-80*

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Назначение . . . . .	7
2. Технические данные . . . . .	7
3. Состав прибора . . . . .	12
4. Устройство и работа прибора и его составных частей . . . . .	13
4.1. Принцип действия . . . . .	13
4.2. Схема электрическая принципиальная . . . . .	14
4.2.1. Органы управления и контроля . . . . .	14
4.2.2. Описание электрической структурной схемы прибора . . . . .	15
4.2.3. Генератор задающий . . . . .	19
4.2.4. Блок комбинированный . . . . .	19
4.2.5. Аттенюатор ступенчатый . . . . .	21
4.2.6. Формирователь напряжений НЧ . . . . .	22
4.2.7. Устройство управления . . . . .	22
4.2.8. Индикатор частоты . . . . .	23
4.2.9. Блок питания . . . . .	25
4.2.10. Плата 3.665.514 . . . . .	26
4.3. Конструкция . . . . .	27
5. Маркирование и пломбирование . . . . .	29
6. Общие указания по эксплуатации . . . . .	30
7. Указания мер безопасности . . . . .	30
8. Подготовка к работе . . . . .	31
9. Порядок работы . . . . .	31
9.1. Подготовка и проведение измерений . . . . .	31
9.2. Проведение измерений . . . . .	32
10. Характерные неисправности и методы их устранения . . . . .	34
11. Техническое обслуживание . . . . .	37
12. Проверка прибора . . . . .	37
12.1. Операции и средства поверки . . . . .	38
12.2. Условия поверки и подготовка к ней . . . . .	45
12.3. Проведение поверки . . . . .	45
12.4. Определение метрологических параметров . . . . .	45
12.5. Оформление результатов поверки . . . . .	53
12.6. Приложение к разделу ПОВЕРКА . . . . .	54
13. Правила хранения . . . . .	66
14. Транспортирование . . . . .	66
14.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки . . . . .	66
14.2. Условия транспортирования . . . . .	66

Рис. 23. Размещение элементов на плате 2.084.071.  
Рис. 24. Устройство управления.  
Схема электрическая принципиальная 2.390.164 Э3.  
Рис. 25. Размещение элементов на плате 2.390.164.  
Рис. 26. Блок счетный.  
Схема электрическая принципиальная 3.056.108 Э3.  
Рис. 27. Размещение элементов блока систного 3.056.108.  
Рис. 28. Блок автоматики.  
Схема электрическая принципиальная 3.051.036 Э3.  
Рис. 29. Размещение элементов блока автоматики 3.051.036.  
Рис. 30. Блок питания.  
Схема электрическая принципиальная 2.087.536 Э3.  
Рис. 31. Размещение узлов блока питания Г4-129.  
Рис. 32. Размещение элементов в блоке питания 2.087.536.  
Рис. 33. Размещение элементов на узле печатном 3.662.429.  
Рис. 34. Размещение элементов на узле печатном 3.662.430.  
Рис. 35. Размещение элементов на узле печатном 3.662.431.  
Рис. 36. Расположение выводов и основных элементов усилителя на транзисторах М42113 (или 3.462.002).  
Рис. 37. Расположение выводов и основных элементов усилителя на транзисторах М42112.  
Рис. 38. Комплект ЗИП и вспомогательного имущества.

Между страницами 122 и 123:

Рис. 39. Схема упаковки и маркирование упаковки прибора Г4-129.  
Расположение выводов микросхем на четырех листах.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Генератор сигналов высокочастотный Г4-129 с амплитудной, частотной и импульсной модуляцией предназначен для настройки, регулировки и испытаний различных радиотехнических устройств десиметрового диапазона волн.

Генератор Г4-129 используется также в качестве высокочастотного блока в приборе Г4-128.

Внешний вид генератора Г4-129 показан на рис. 1.

1.2. Генератор может использоваться как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 263 до 323 К (от минус 10°C до плюс 50°C);
- относительная влажность воздуха 95% при температуре 303 К (30°C);
- напряжение сети  $(220 \pm 22)$  В частотой  $(50 \pm 0,5)$  Гц и  $(220 \pm 11)$  В частотой  $(400 \frac{+28}{-12})$  Гц;
- атмосферное давление  $(100 \pm 4)$  кПа,  $(750 \pm 30)$  мм рт. ст.

1.3. Основные области применения: радиосвязь, радиовещание, телевидение, радиоизмерительная техника.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Прибор обеспечивает следующие режимы работы:

- немодулированные колебания;
- внутренняя и внешняя частотная модуляция синусоидальным сигналом (ЧМ);
- внутренняя и внешняя амплитудная модуляция синусоидальным сигналом (АМ);
- внутренняя амплитудно-импульсная модуляция «меандром» 1 кГц и внешняя амплитудно-импульсная модуляция (ИМ);
- синхронизация частоты генератора внешним синхронизатором в режимах немодулированных колебаний.

### 2.3. Частотные параметры.

2.3.1. Диапазон частот генератора 310—1200 МГц перекрыва-ется двумя поддиапазонами с граничными частотами 310—600, 600—1200 МГц.

Перекрытие между поддиапазонами и запас по краям диапазона не менее 1% от значения номинальной граничной частоты.

2.3.2. Основная погрешность установки частоты в режимах немодулированных колебаний, АМ, ЧМ, ИМ не более  $\pm(0,05 \pm \frac{1}{f})\%$ , где  $f$  — установленное значение частоты в МГц.

2.3.3. Нестабильность частоты за любые 15 мин. работы генератора после самопрогрева в течение 30 мин. и 2 ч в нормальных условиях не более соответственно  $\pm 2,5 \cdot 10^{-4}$  и  $\pm 5 \cdot 10^{-5}$  от несущей частоты. Дополнительное время установления рабочего режима после перестройки частоты не превышает 15 мин.

Изменение частоты при изменении уровня выходного сигнала на  $\pm 10$  дБ относительно опорного значения не превышает  $\pm 5 \cdot 10^{-6}$ .

2.3.4. Плавная расстройка частоты сигнала не менее 100 кГц.

2.3.5. Среднеквадратическое значение паразитной девиации частоты в режиме немодулированных колебаний в полосе от 30 Гц до 20 кГц не более  $1 \cdot 10^{-6}$  от несущей частоты.

### 2.4. Параметры выходной мощности.

2.4.1. В режиме немодулированных колебаний генератор Г4-129 обеспечивает на согласованной нагрузке с  $K_{ct}U$  не более 1,35, подключенной через кабель к основному выходу прибора, выходную мощность, калиброванную от  $10^{-2}$  до  $10^{-15}$  Вт с использованием внешнего аттенюатора на 20 дБ, входящего в комплект прибора. Регулировка выходной мощности производится ступенями через 1 дБ и 10 дБ от 20 до 139 дБ и плавно в пределах не менее 1 дБ. Отсчет мощности в децибелах относительно 1 Вт справедлив при крайнем правом положении ручки УРОВЕНЬ.

2.4.2. Основная погрешность установки опорного значения выходной мощности  $10^{-3}$  Вт (ослабление 30 дБ ступенчатого аттенюатора) не более  $\pm 1$  дБ при работе с прибавляемым кабелем на согласованную нагрузку 50 Ом с  $K_{ct}U$  не более 1,35. Ручка УРОВЕНЬ в крайнем правом положении.

2.4.3. Основная погрешность установки ослабления аттенюатора не более  $\pm 1$  дБ. Дополнительная погрешность аттенюатора при установке ослабления более 110 дБ (показание шкалы) не более  $\pm 0,2$  дБ на каждые 10 дБ.

Дополнительная погрешность установки выходной мощности при малых ее значениях (остаточная выходная мощность) не более  $\pm 0,5 \cdot 10^{-14}$  Вт.

2.4.4. Основная погрешность ослабления внешнего аттенюатора 20 дБ не более  $\pm 0,5$  дБ.

2.4.5. Дополнительная погрешность установки опорного значения выходного сигнала при изменениях температуры на  $10^{\circ}\text{C}$  в пределах рабочих условий не более  $\pm 0,3$  дБ.

2.4.6. Дополнительная погрешность установки ослабления ступенчатого аттенюатора при изменениях окружающей температуры на  $10^{\circ}\text{C}$  не более  $\pm 0,25$  дБ от 20 до 110 дБ;  $\pm 0,3$  дБ до 120 дБ;  $\pm 0,35$  дБ до 130 дБ;  $\pm 0,4$  дБ до 139 дБ.

2.4.7. Погрешность установки опорного уровня выходной мощности в режиме немодулированных колебаний при использовании трансформатора 50/75 Ом и кабеля 4.852.106 из комплекта прибора не более  $\pm 1,5$  дБ при работе на согласованную нагрузку 75 Ом с  $K_{ct}U$  не более 1,35.

2.4.8. Нестабильность опорного уровня выходной мощности при неизменном напряжении питания и неизменных внешних условиях за 15 мин. после самопрогрева генератора в течение 30 мин. не более  $\pm 0,05$  дБ. Дополнительное время установления рабочего режима после частотной перестройки не более 15 мин.

2.4.9. Волновое сопротивление генератора 50 Ом. Коэффициент стоячей волны напряжения ( $K_{rt}U$ ) основного выхода с придаваемым кабелем 4.852.106 не более 1,5. При подключении к концу кабеля внешнего аттенюатора  $K_{ct}U$  выхода не более 1,25, при подключении трансформатора 50/75  $K_{ct}U$  не более 2,0.

Выходной разъем генератора типа III по ГОСТ 13317—80.

2.4.10. Паразитная амплитудная модуляция выходного сигнала на основном выходе генератора в режиме немодулированных колебаний не более 0,2%.

2.4.11. Содержание 2-й и 3-й гармоник несущей частоты в режиме немодулированных колебаний по отношению к уровню сигнала несущей частоты не более минус 30 дБ.

2.4.12. Мощность выходного сигнала на некалиброванном выходе на согласованной нагрузке с  $K_{ct}U$  не более 1,35 не менее 0,1 и не более 10 мВт.

Форма сигнала на этом выходе не гарантируется.

2.4.13. Напряженность электрического поля в пространстве вокруг генератора на расстоянии 1 м при установке минимального гарантируемого уровня выходного сигнала не превышает  $10^{-4}$  В/м.

## 2.5. Параметры частотной синусоидальной модуляции (ЧМ)

2.5.1. Диапазон частот модулирующего сигнала при внешней частотной синусоидальной модуляции от 50 до 60000 Гц.

2.5.2. Девиация частоты устанавливается и отсчитывается в пределах от 30 до 500 кГц во всем диапазоне модулирующих и несущих частот. Номинальные значения шкал индикаторного прибора 500, 200, 100, 50 кГц.

Основная погрешность установки девиации частоты модулирующей частоте 1000 Гц не более  $\pm 15\%$  от номинала отсчетной шкалы.

2.5.3. Погрешность установки девиации частоты в диапазоне модулирующих частот не более  $\pm 20\%$  от номинала отсчетной шкалы.

2.5.4. Коэффициент гармоник ( $K_r$ ) формы огибающей частотно-модулированного выходного сигнала при внутренней модуляции на частоте 1000 Гц при девиации частоты выходного сигнала 500 кГц не более 2%, в диапазоне модулирующих частот не более 5%.  $K_r$  внешнего модулирующего сигнала при этом не более 0,3%.

2.5.5. Погрешность установки опорного уровня выходной мощности  $10^{-3}$  Вт в режиме ЧМ не более  $\pm 1$  дБ при работе в нормальных условиях с кабелем 4.852.106 на нагрузке с  $K_{ct}U$  не более 1,35.

2.5.6. Среднеквадратическое значение напряжения внешнего модулирующего сигнала, необходимое для получения девиации 500 кГц, не более 5 В.

2.5.7. Входное сопротивление гнезда ЧМ в пределах  $(680 \pm 200)$  Ом.

2.5.8. Паразитная амплитудная модуляция при девиации 500 кГц в режиме ВНУТР. ЧМ не более 10%.

2.5.9. Частота генератора перестраивается внешним постоянным напряжением величиной  $\pm 7$  В в пределах  $\pm 500$  кГц.

## 2.6. Параметры амплитудной синусоидальной модуляции (АМ).

2.6.1. Частота сигнала внутреннего модулятора при внутренней амплитудной и частотной модуляции синусоидальным сигналом и внутренней импульсной модуляции меандром  $(1000 \pm 100)$  Гц.

2.6.2. Диапазон частот модулирующего сигнала при внешней амплитудной синусоидальной модуляции от 50 до 20000 Гц.

2.6.3. В приборе обеспечивается возможность плавной установки коэффициента модуляции 30% по внешнему модулометру. Погрешность установки выходной мощности, погрешность установки коэффициента модуляции и  $K_r$ , не гарантируются.

2.6.4. Напряжение внешнего модулирующего сигнала, необходимое для получения коэффициента модуляции 30%, не более 2 В.

2.6.5. Входное сопротивление гнезда АМ  $(680 \pm 135)$  Ом.

2.6.6. Выходная мощность генератора в режиме АМ на нагрузках 50 Ом не менее  $10^{-4}$  Вт при установке ручек ОСЛАБЛЕНИЕ в положение 30 дБ.

## 2.7. Параметры амплитудной импульсной модуляции.

2.7.1. В режиме внешней амплитудной импульсной модуляции генератор выдает выходные высокочастотные импульсы дли-

тельностью от 0,5 до 500 мкс с частотой следования от 10 до 20000 Гц при скважности не менее 2.

Параметры выходных высокочастотных импульсов:

- длительность фронта не более  $0,5 \tau_u$ , но не более 3 мкс,
- длительность среза не более  $\tau_u$ , но не более 3 мкс,
- неравномерность вершины не более 25 %,
- изменение длительности выходного импульса относительно модулирующего не более  $\pm (0,1\tau_u + 0,4)$  мкс.

Параметры модулирующих импульсов:

- длительность импульсов от 0,3 до 500 мкс,
- частота повторения от 10 до 20000 Гц при скважности не менее 2,
- длительность фронта и среза не более 0,15 мкс,
- неравномерность вершины не более 5 %,
- выходное сопротивление импульсного генератора не более 100 Ом,
- амплитуда импульсов отрицательной полярности 5—8 В,
- амплитуда импульсов положительной полярности 10—15 В.

Примечание. Допускается модуляция импульсами положительной полярности амплитудой до 25 В при скважности не менее 10.

2.7.2. В режиме внутренней амплитудной импульсной модуляции прибор выдает высокочастотные импульсы «меандр» с частотой следования  $(1000 \pm 100)$  Гц. Отношение полупериодов меандря отличается от 1 не более чем на  $\pm 10\%$ .

2.7.3. Погрешность установки опорного значения выходной мощности в режиме амплитудно-импульсной модуляции не более  $\pm 2,2$  дБ при работе с кабелем 4.852.106 на внешней нагрузке 50 Ом с  $K_{ct}U$  не более 1,35.

2.7.4. Входное сопротивление гнезда ИМ  $(600 \pm 120)$  Ом.

2.7.5. Ослабление выходного сигнала при амплитудно-импульсной модуляции в интервалах между импульсами не менее 40 дБ.

## 2.8. Прочие параметры.

2.8.1. Генератор обеспечивает свои технические характеристики по истечении времени установления рабочего режима, равного 30 мин., кроме п. 2.3.3.

2.8.2. Генератор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение 16 ч при сохранении технических характеристик.

2.8.3. Генератор сохраняет свои технические характеристики при питании от сети переменного тока напряжением  $(220 \pm 22)$  В частотой  $(50 \pm 0,5)$  Гц или  $(220 \pm 11)$  В частотой  $(400 \pm 28)$  Гц с содержанием гармоник до 5 %.

2.8.4. Мощность, потребляемая от сети приnomинальном напряжении, не более 85 В·А.

2.8.5. Нормальные и предельные условия эксплуатации генератора должны соответствовать данным, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Условия эксплуатации	Температура	Относительная влажность, %	Атмосферное давление	Параметры сети	
				напряжение, В	частота, Гц
Нормальные	(293±5) К, (20±5) °C	65±15 при температуре (293±5) К, (20±5) °C	(100±4) кПа, (750±30) мм рт. ст.	220±4,4 400 <sup>+28</sup> <sub>-12</sub>	50±0,5 400 <sup>+28</sup> <sub>-12</sub>
Предельные	263—323 К (от минус 10 °C до +50 °C)	95±3 при температуре 303 К, (30 °C)	(100±4) кПа, (750±30) мм рт. ст.	220±22 220±11	50±0,5 400 <sup>+28</sup> <sub>-12</sub>

2.8.6. Время наработки на отказ не менее 5500 ч.

Срок службы не менее 10 лет.

Технический ресурс 10000 ч.

2.8.7. Габаритные размеры в миллиметрах и масса генератора в килограммах приведены в табл. 2.

Таблица 2

Без упаковки		В укладочном ящике		В транспортной таре	
размеры, мм	масса, кг	размеры, мм	масса, кг	размеры, мм	масса, кг
335×175×375	14,5	615×320×490	35	735×395×565	60

### 3. СОСТАВ ПРИБОРА

Состав комплекта генератора Г4-129 приведен в табл. 3, комплект запасного имущества и принадлежностей показан на рис. 38 приложения.

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1. Генератор сигналов высокочастотный Г4-129	3.260.101	1	

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение	Коли-чество	Примечание
2. Комплект комбинированный в составе:			
а) кабель соединительный ВЧ	4.068.147	1	
б) то же	4.852.517-10	1	
в) кабель соединительный	4.851.474-10	1	
г) то же	4.852.106	1	
д) шнур соединительный	4.851.011	1	
е) аттенюатор фиксированный	4.860.159	1	
ж) переход коаксиальный	2.243.069	1	
з) переход коаксиальный Э2-111/4	2.236.470	1	
и) переход коаксиальный Э2-23	2.236.145	1	
к) трансформатор сопротивлений 50/75 Ом	2.754.558	1	
л) вставки плавкие: ВП2Б-1В 1,0А 250 В	2.240.061	1	
ВП2Б-1В 2,0А 250 В		9	
ВП2Б-1В 3,15А 250 В		6	
ВП2Б-1В 4,0А 250 В		9	
м) плата коммутационная	3.260.101 ТО	6	
н) шнур соединительный	3.662.019-03	1	
3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	4.860.144	1	
4. Формуляр		1	
5. Ящик укладочный		1	Для прибора
6. Ящик	4.161.648-04	1	Для ЗИПа
	4.161.646-10	1	

#### 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

##### 4.1. Принцип действия.

Работа генератора Г4-129 основана на принципе формирования выходного сигнала в диапазоне частот 310—1200 МГц из

сигнала задающего генератора на диапазон 600—1200 МГц (рис. 3). Выходной сигнал задающего генератора поступает на 2 канала: канал формирования выходного сигнала генератора и канал встроенного электронного индикатора частоты.

В канале формирования выходного сигнала сигнал задающего генератора после предварительного усиления (усилитель 0,6—1,2 ГГц) поступает через коммутаторы на  $p-n-p$  диодах либо непосредственно на усилитель мощности 0,3—1,2 ГГц, либо через делитель частоты на 2. С выхода усилителя мощности 0,3—1,2 ГГц высокочастотный сигнал поступает на аттенюатор электрически управляемый, являющийся исполнительным элементом системы автоматической регулировки мощности (АРМ). После аттенюатора электрически управляемого высокочастотный сигнал фильтруется в блоке электрически коммутируемых фильтров низких частот (ФНЧ). С выхода фильтров сигнал поступает на датчик уровня системы АРМ, затем через модулятор электрически управляемый и ступенчатый аттенюатор проходит на выходной разъем прибора.

Частотная модуляция сигнала осуществляется с помощью варикапа, включенного в задающий генератор.

Импульсная модуляция сигнала выполняется в модуляторе электрически управляемом.

Амплитудная модуляция производится в аттенюаторе электрически управляемом через систему АРМ.

В канале встроенного индикатора частота задающего генератора делится рядом последовательных делителей частоты на 128 и измеряется встроенным электронным индикатором частоты.

#### 4.2. Схема электрическая принципиальная.

##### 4.2.1. Органы управления и контроля.

Органы управления и подсоединительные разъемы расположены на передней и задней панелях прибора (рис. 4).

1. ДИАПАЗОНЫ GHz — переключатель — переключение поддиапазонов 0,31—0,6 и 0,6—1,2 ГГц и включение высокочастотного сигнала.

2. ВНЕШН., ВНУТР., АМ, ЧМ, ИМ — переключатель — выбор режима работы генератора.

3. ГЛУБИНА — резистор переменный — установка коэффициента модуляции.

4. АМ — разъем — подача входного модулирующего напряжения для осуществления амплитудной модуляции и контроль частоты внутреннего модулирующего напряжения.

5. ДЕВИАЦИЯ kHz — резистор переменный — плавная установка девиации частоты.

6. ЧМ — разъем — подача входного модулирующего напряжения для осуществления частотной модуляции в режиме частотной модуляции и подача управляющего сигнала в режиме непрерывной генерации.

7.  $\oplus$  — тумблер — переключение полярности внешнего модулирующего импульса.

8. ИМ — разъем — подача входного напряжения для осуществления импульсной модуляции.

9. ОСЛАБЛЕНИЕ dB — ручки установки величины выходного высокочастотного сигнала в пределах 20—139 dB через 1 и 10 dB.

10. ВЫХОД I — разъем — выход калиброванного высокочастотного сигнала.

11. Прибор измерительный — установка девиации частоты в режиме частотной модуляции, индикация уровня выходной высокочастотной мощности в режимах непрерывной генерации, импульсной и амплитудной модуляции.

12. УРОВЕНЬ — резистор переменный — плавная регулировка уровня выходного высокочастотного сигнала.

13. КАЛИБР. — резистор переменный — изменение чувствительности прибора измерительного при калибровке измерителя девиации частоты.

14. 50, 100, 200, 500, КАЛИБР., ДЕВИАЦИЯ kHz — переключатель — ступенчатая установка девиации частоты в режиме частотной модуляции, переключение в положение калибровки схемы измерения девиации частоты.

15.  $\times 10 - \times 1$  — тумблер — перенос запятой частотомера электронно-счетного.

16. ЧАСТОТА MHz — ручка — установка частоты.

17. РАССТРОЙКА — резистор переменный — плавная установка частоты.

18. ВКЛ. СЕТЬ — тумблер — включение прибора.

19. Табло индикатора частоты — индикация частоты.

20. 1A, ВП2Б-1В — вставки плавкие.

21.  $\sim 220V\ 85V\cdot A$  — вилка — подача напряжения питания.

22.  $\pm$  — корпусная клемма.

23. ВЫХОД II — разъем — некалиброванный выход высокочастотного сигнала.

24. Электрохимический счетчик времени — определение суммарного времени наработки прибора.

#### 4.2.2. Описание электрической структурной схемы.

Структурная схема генератора Г4-129 с условным обозначением блоков и узлов по электрической принципиальной схеме (рис. 1 приложения) показана на рис. 5.

Входящие в схему функциональные узлы и их назначение.

Генератор задающий (У1) — генерирование сигнала в диапазоне частот 600—1200 МГц, частотная модуляция сигнала, электронная перестройка частоты.

Блок комбинированный (У2) — формирование и усиление сигнала в диапазоне частот 310—1200 МГц, фильтрация гармоник сигнала, автоматическая регулировка мощности, амплитудная и импульсная модуляция сигнала, деление частоты задающего генератора на 128.

**Формирователь напряжения НЧ (У6)** — формирование напряжения частотой 1 кГц синусоидальной и прямоугольной (мейндр) формы, формирование сигнала для уменьшения нелинейных искажений модулирующей в режиме ЧМ и автоматического переключения фильтров низких частот в пределах поддиапазонов.

**Блок автоматики (У5)** — формирование кварцевого временного интервала и импульсов счета.

**Блок счетный (У4)** — счет и индикация результатов измерения на цифровых газоразрядных лампах.

**Аттенюатор ступенчатый 0—119 дБ (У3)** — регулирование уровня выходной мощности.

**Устройство управления (У7)** — формирование сигналов управления импульсным модулятором.

**Блок питания (У8)** — выдача необходимых напряжений и токов.

**Плата** (без обозначения) — формирование опорных напряжений, выпрямление модулирующего напряжения в режиме ЧМ.

При включении прибора тумблером ВКЛ. СЕТЬ задающий генератор выдает сигналы на блок комбинированный (У2).

Частота сигнала, поступающего на вход канала индикатора частоты, делится в блоке комбинированном на 128 и поступает на блок автоматики (У5), а с него на блок счетный (У4).

Выбор рабочего поддиапазона осуществляется переключателем ДИАПАЗОНЫ GHz, при этом на блок комбинированный поступают:

— сигналы управления фильтрами низких частот (ФНЧ): на рабочий ФНЧ подается положительное открывающее напряжение, на остальные ФНЧ поступает отрицательное запирающее напряжение. Коммутация ФНЧ в пределах одного поддиапазона осуществляется выходным напряжением дискриминатора (в узле У6), управляемым потенциометрическим датчиком в генераторе задающем (У1);

— сигнал коммутации канала прямого усиления (0,6—1,2) и канала деления частоты на 2 (0,3—0,6 ГГц). При включении канала деления частоты на усилитель 0,3—0,6 ГГц в канале деления частоты подается коллекторное питание.

При ненажатых клавиши ДИАПАЗОНЫ GHz подается запирающее напряжение на все ФНЧ, модулятор и аттенюатор электрически управляемый. Сигнал на выходном разъеме I отсутствует.

При нажатии одной из клавиш ДИАПАЗОНЫ GHz генератор включается в режим немодулированных колебаний (НГ). При этом:

— через устройство управления (У7) подается сигнал управления, обеспечивающий прохождение СВЧ сигнала через модулятор;

— подается опорное напряжение на систему АРМ. Стрелочный индикатор показывает наличие мощности на входе аттенюатора ступенчатого;

— коммутируется блок автоматики (У5) для обеспечения прямого отсчета частоты на табло индикатора частоты.

Для осуществления модулированных режимов работы необходимо нажать одну из клавиш ВНЕШН. или ВНУТР. и одну из клавиш АМ, ЧМ или ИМ.

При нажатии клавиши ВНЕШН.:

— разъем ЧМ подключается к переключателю ДЕВИАЦИЯ kHz;

— от входа устройства управления (У7) отключается сигнал внутреннего генератора меандра и ко входу устройства управления подключается разъем ИМ;

— разъем АМ подключается к контактам клавиш АМ.

При нажатии клавиши ВНУТР.:

— включается питание звукового генератора, входящего в состав У6;

— сигнал звукового генератора поступает на контакты клавиши АМ и на переключатель ДЕВИАЦИЯ kHz.

При нажатии клавиши АМ:

— на потенциометр ГЛУБИНА поступает модулирующее напряжение от внутреннего звукового генератора или внешнего модулятора;

— включается опорное напряжение системы АРМ, соответствующее режиму АМ.

При нажатии клавиши ЧМ:

— вход варикапа задающего генератора (У1) отключается от разъема ЧМ и подключается к выходу преобразователя, входящего в состав У6;

— индикаторный прибор с индикацией уровня выходного сигнала переключается на выход схемы измерения девиации частоты.

При нажатии клавиши ИМ:

— на устройство управления (У7) подаются питирующие напряжения, обеспечивающие его работу в режиме ИМ;

— сигнал звукового генератора подается на вход формирователя меандра.

С переключателя ДЕВИАЦИЯ kHz в положении КАЛИБР. подается постоянное напряжение на потенциометр ДЕВИАЦИЯ и связанную с ним схему подачи и контроля модулирующего сигнала в режиме ЧМ.

В положениях 50, 100, 200, 500 переключателя ДЕВИАЦИЯ kHz на схему подачи и контроля модулирующего сигнала поступает модулирующий сигнал.

Рассмотрим прохождение модулирующих сигналов в каждом из режимов.

Блок автоматики включает в себя:

- счетный селектор;
- формирующие устройства импульсов переписи и сброса;
- переключатель запятой и диапазонов;
- устройство запуска и выдачи информации на регистрирующее устройство;
- генератор опорный 10 МГц;
- делители частоты опорного сигнала.

Основные узлы данного устройства показаны на структурной схеме индикатора частоты.

Счетный селектор (схема автоматики) разрешает прохождение импульсов с генератора ( $f_{сн}$ ) за определенный для каждого диапазона интервал времени  $T_{сн}$ .

От заднего фронта импульса времени счета запускаются ждущие мультивибраторы формирующие устройства импульсов переписи и сброса, которые поступают в счетный блок для открытия регистра памяти и установки счетчиков в нулевое состояние.

Для повышения разрешающей способности индикатора частоты предусмотрено увеличение временного интервала в 10 раз.

При переключении диапазонов производится изменение в 2 раза временного интервала с целью получения непосредственного отсчета частоты выходного сигнала. Изменение временных интервалов осуществляется за счет коммутации делителей с помощью логической схемы 133ЛР1.

Блок счетный включает в себя 6-разрядный десятичный счетчик с промежуточным запоминанием и индикацией результатов измерения на цифровых газоразрядных лампах.

Структурная схема одного разряда блока счетного приведена на рис. 7. В его состав входят десятичный счетчик, выполненный на 133ИЕ2, регистр памяти — на 133ТМ5, дешифратор — на 133ИД1 и цифровая лампа ИН-16.

Десятичный счетчик 133ИЕ2 имеет максимальное быстродействие 10 МГц. Схема содержит информационные выходы в коде 8—4—2—1, входы установки в состоянии 0 и 9. Срабатывание по счетному входу происходит на перепад 1—0. Установка в нулевое состояние производится единичным путем.

Регистр памяти 133ТМ5 содержит четыре D — триггера с парно объединенными тактовыми входами. Запись информации производится на перепад 1—0.

Дешифратор 133ИД1 имеет схему преобразования двоично-десятичного кода в десятичный и высоковольтные ключи для управления газоразрядной лампой ИН-16.

Все микросхемы, используемые в индикаторе частоты, совместимы по входным и выходным уровням. Уровень логической единицы  $1 \geq 2,4$  В, логического нуля  $0 \leq 0,4$  В.

#### 4.2.9. Блок питания.

Блок питания предназначен для обеспечения всех цепей генератора сигналов необходимыми напряжениями и токами. Схема приведена в приложении.

Блок питания состоит из пяти стабилизированных источников: минус 12,6 В 0,4А; 12,6 В 1,0А; 20 В 0,2А; минус 5 В 1,1А; 5 В 0,9А и нестабилизированного источника 250 В 10 мА.

Все стабилизированные источники выполнены по схеме компенсационного типа с последовательным включением регулирующего транзистора.

В стабилизаторах напряжения компенсационного типа выходное напряжение сравнивается с эталонным и при изменении первого на какую-то величину, вырабатывается сигнал рассогласования.

Сигнал рассогласования, усиленный усилителем постоянного тока, подается в соответствующей фазе на регулирующий транзистор. Регулирующий транзистор, меняя свое сопротивление в зависимости от величины и фазы сигнала, поддерживает на выходе стабилизатора напряжения постоянным с заданной точностью.

Источник напряжения минус 12,6 В 0,4А состоит из двухполупериодного выпрямителя Д7, Д8, емкостного фильтра С7, С8, составного регулирующего транзистора Т4 (на радиаторе) и Т1, Т2 (на плате) и усилителя постоянного тока, элементы которого расположены на плате 3.662.430.

Усилитель постоянного тока состоит из вспомогательного выпрямителя Д2 с фильтром С1, стабилизированного стабилитрона Д4, источника эталонного напряжения Д3, каскада усиления сигнала рассогласования Т3, выходного делителя напряжения R6...R8 с термокомпенсирующими диодами Д5, Д6 и выходного конденсатора С3.

Источник напряжения 12,6 В 1,0А состоит из двухполупериодного выпрямителя Д9, Д10, емкостного фильтра С9...С12, составного регулирующего транзистора Т5 (на радиаторе) и Т4, Т6 (на плате) и усилителя постоянного тока, элементы которого расположены на плате 3.662.430.

Усилитель постоянного тока состоит из: стабилизатора постоянного тока Д7, Д8, Т5, R9, R10, источника эталонного напряжения Д9, каскада усиления сигнала рассогласования Т7, выходного делителя напряжения R13...R15 и термокомпенсирующими диодами Д10, Д11 и выходного конденсатора С5.

Источник напряжения 5 В 0,9А состоит из двухполупериодного выпрямителя Д1, Д2, емкостного фильтра С1, С2, составного регулирующего транзистора Т1 (на радиаторе) и Т1 (на плате) и усилителя постоянного тока, элементы которого расположены на плате 3.662.429.

Усилитель постоянного тока состоит из: вспомогательного выпрямителя D1 с фильтром C1, стабилизированного стабилитроном D2, источника эталонного напряжения D3, дифференциального усилителя сигнала рассогласования на микросхеме MC1, выходного делителя напряжения R6 с термокомпенсирующими диодами D4, D5 и выходного конденсатора C4.

Источник напряжения минус 5 В 1,1А выполнен точно по такой же схеме, что и источник 5 В 0,9 А и содержит аналогичные элементы.

Источник напряжения 20 В 0,2А состоит из: двухполупериодного выпрямителя D5, D6, емкостного фильтра C5, C6, составного регулирующего транзистора T3 (на радиаторе) и T3, T5 (на плате) и усилителя постоянного тока, элементы которого расположены на плате 3.662.429.

Усилитель постоянного тока состоит из: стабилизатора постоянного тока D11, D12, T4, R13, R14, источника эталонного напряжения D13, каскада усиления сигнала рассогласования T6, выходного делителя напряжения R17...R19 с термокомпенсирующими диодами D14, D15 и выходного конденсатора C10.

Нестабилизированное напряжение 250 В 10 мА снимается с однополупериодного выпрямителя D1 (на плате 3.662.430).

Все необходимые напряжения снимаются с вторичных обмоток трансформатора Тр, отделенных от сетевой обмотки электростатическим экраном.

Для защиты прибора в условиях неисправностей поставлены вставки плавкие Пр1+Пр12.

Все выходные напряжения выведены на разъем типа РП10-22.

Блок питания выполнен в виде отдельного узла, скрепляемого с генератором винтами в общем футляре.

Регулирующие транзисторы расположены на задней стенке — радиаторе.

Конденсаторы фильтров всех стабилизированных источников объединены конструктивно в один блок.

Отвод тепла, выделяющегося на элементах блока питания, производится за счет естественной конвекции воздуха через жалюзи в нижней и верхней крышках прибора.

#### 4.2.10. Узел печатный 3.665.514.

На плате (рис. 3 приложения) расположены:

- делители опорного напряжения системы АРМ — R18, R19; R1; R2; R3; R4;
- делители опорного напряжения варикапа задающего генератора R7; R8;
- делитель постоянного напряжения для калибровки схемы измерения девиации частоты R9, R10;
- схема измерения девиации частоты R11—R17, C3, C4, MC1, D1;

- потенциометр R20 регулировки чувствительности схемы измерения девиации частоты по постоянному току;
- схема инвертирования внешних положительных импульсов R21—R26, C6—C8, D2—D6, T1.

#### 4.3. Конструкция.

4.3.1. Генератор сигналов высокочастотный Г4-129, внешний вид которого показан на рис. 1, выполнен в виде отдельного переносного прибора. Элементы корпуса прибора (рис. 8) собраны из профильного материала. Чтобы вскрыть прибор, необходимо его распломбировать. Нижняя крышка крепится двумя винтами с чашками для пломб. Для снятия верхней крышки нужно отвинтить два верхних винта крепления блока питания (У8) со стороны задней панели, один из которых пломбирован, ослабить два нижних винта и, повернув блок питания на угол 2—3° на нижних винтах, снять верхнюю крышку.

Нормальное рабочее положение прибора — наклонное, обеспечивается ножкой, установленной на нижней крышке.

4.3.2. В заднюю панель прибора вмонтирован электрохимический счетчик времени (ресурсомер) типа ЭСВ-2,5-12,6, предназначенный для определения суммарного времени наработки прибора при его настройке, испытаниях и эксплуатации.

Отсчет наработанного времени производится по делению шкалы, против которого находится мениск правого столбика ртути.

Если зазор между двумя столбиками ртути достиг 90—95% (не более) всей шкалы, нужно изменить направление отсчета путем смены полярности питания счетчика. При этом отсчет будет производиться в обратном порядке.

4.3.3. Все блоки и узлы генератора Г4-129 выполнены с применением печатного монтажа, а СВЧ узлы — с применением гибридной тонкопленочной технологии.

Все блоки и узлы прибора смонтированы на трех шасси (рис. 9). В качестве шасси используются литой корпус блока комбинированного, задняя и передняя панели прибора. На задней панели прибора собран блок питания. На передней панели — генератор задающий, аттенюатор ступенчатый, блок счетный, блок автоматики, формирователь напряжения НЧ, устройство управления.

Блок комбинированный (рис. 7 приложения) представляет собой экранированную коробку с тремя отсеками. Каждый отсек закрывается трехслойной крышкой с резиновой прокладкой. Резиновая прокладка служит для создания равномерного и постоянного давления на фольгу, которая через сетку создает экранировку отсеков коробки. Связь с другими узлами прибора по высокой частоте через коаксиальные разъемы, по питанию через разъем типа РП10-22. Питание непосредственно в отсеки подается

5.2. Заводской порядковый номер генератора Г4-129 и год изготовления указаны на задней панели.

5.3. Все элементы и составные части, установленные на шасси, панелях и печатных платах, имеют маркировку позиционных обозначений в соответствии с позиционными обозначениями первичных элементов к электрическим принципиальным схемам.

5.4. Генератор Г4-129 пломбируется мастичными пломбами, которые устанавливаются на задней и передней панелях и нижней крышке.

## 6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. После длительного хранения следует произвести внешний осмотр, опробование, а затем поверку метрологических параметров согласно разделу 12.

6.2. При внешнем осмотре необходимо проверить:

- сохранность пломб;
- комплектность согласно табл. 3;
- отсутствие видимых механических повреждений, влияющих на точность показаний прибора;
- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, плавность вращения ручек органов настройки, наличие предохранителей;
- правильность установки стрелок показывающих приборов против нулевых отметок шкалы;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных проводов, кабелей, переходов.

6.3. При эксплуатации вентиляционные отверстия на корпусе генератора Г4-129 не должны закрываться посторонними предметами, а прибор должен быть установлен на ручку в нормальное наклонное рабочее положение.

6.4. Сделать отметку в формуляре о начале эксплуатации и записать показания счетчика наработки.

В процессе эксплуатации показания счетчика периодически 2 раза в год записываются в формуляр.

До включения прибора необходимо ознакомиться с разделами 7, 8.

## 7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. По требованиям к электробезопасности генератор удовлетворяет ГОСТ 12.2.007.0—75. Класс защиты I.

7.2. В процессе ремонта при проверке режимов элементов не допускать соприкосновения с токонесущими элементами, так как в приборе имеется переменное напряжение 220 В и постоянное 250 В.

Замена деталей должна проводиться только при обесточенном приборе.

- при вращении ручки РАССТРОЙКА из крайнего правого положения в крайнее левое положение показания цифрового табло меняются в пределах не менее 100 кГц;
- при переключении тумблера  $\times 10 - \times 1$  в положение  $\times 10$  переносится запятая цифрового табло влево на один знак;
- при нажатых кнопках ВНУТР., ЧМ в положении КАЛИБР. переключателя ДЕВИАЦИЯ kHz при вращении ручки ДЕВИАЦИЯ kHz показания цифрового и стрелочного индикаторов увеличиваются;
- при нажатых кнопках ВНУТР., ЧМ и среднем положении ручки ДЕВИАЦИЯ kHz при вращении ручки КАЛИБР. вправо показания стрелочного индикатора увеличиваются;
- ослабление выставляется путем совмещения показаний шкалы десятичного и единичного аттенюатора ОСЛАБЛЕНИЕ dB на фоне белого отсчетного окна на передней панели.

## 9.2. Проведение измерений.

9.2.1. Проведение измерений складывается в основном из операций:

- установка требуемого режима работы;
- установка уровня выходного сигнала;
- установка частоты;
- установка глубины модуляции;
- установка величины девиации частоты.

9.2.2. Режим немодулированных колебаний устанавливается нажатием одной из кнопок ДИАПАЗОНЫ GHz.

Установка других режимов работы проводится нажатием кнопок переключателя рода работ. Выключение нажатой кнопки проводится вторичным нажатием этой же кнопки.

Комбинированные виды модуляции (ЧМ в АМ, ЧМ в ИМ) устанавливаются нажатием одновременно двух кнопок переключателя рода работ.

Одновременная внутренняя и внешняя модуляция прибором не обеспечивается.

9.2.3. Необходимое значение частоты устанавливается включением одного из поддиапазонов 0,31—0,6 и 0,6—1,2 ГГц и ручкой ЧАСТОТА MHz.

Плавное изменение частоты можно проводить ручкой РАССТРОЙКА в режимах немодулированных колебаний, АМ, ИМ. В режиме ЧМ ручкой РАССТРОЙКА можно плавно настраиваться только при девиации частоты менее 100 кГц во избежание увеличения челищевых искажений.

9.2.4. Установка уровня выходного сигнала возможна только на разъем ВЫХОД I генератора. Она осуществляется ручками ОСЛАБЛЕНИЕ dB ступенчатого аттенюатора. Показания аттенюатора даются в децибелах относительно 1 Вт. При показаниях шкалы аттенюатора 20 dB уровень выходного сигнала равен

10 мВт. Правильность отсчета гарантируется при работе на нагрузку 50 Ом и крайнем правом положении ручки УРОВЕНЬ.

При работе в трактах с волновым сопротивлением 75 Ом включается трансформатор, входящий в ЗИП прибора.

Для получения уровня выходного сигнала  $10^{-14}$ — $10^{-16}$  Вт включается аттенюатор фиксированный 20 дБ, входящий в ЗИП прибора.

9.2.5. Включение режима частотной модуляции осуществляется нажатием кнопки ЧМ и кнопок ВНЕШН. или ВНУТР. в зависимости от вида модуляции. На рабочей частоте предварительно необходимо провести калибровку.

Установите переключатель ДЕВИАЦИЯ kHz в положение КАЛИБР. Тумблер  $\times 1$ — $\times 10$  поставьте в положение  $\times 10$ . Ручку ДЕВИАЦИЯ kHz поставьте в крайнее левое положение, отсчитайте частоту по цифровому табло. Вращая ручку ДЕВИАЦИЯ kHz вправо, установите по табло значение частоты, увеличенное на 500 кГц. Ручкой КАЛИБР. установите по стрелочному индикатору 100  $\mu$ A. На этом калибровка измерителя девиации частоты закончена, при дальнейшей работе недопустим поворот ручки КАЛИБР.

Включите режим внешней или внутренней модуляции путем нажатия соответствующих кнопок.

Поставьте переключатель ДЕВИАЦИЯ kHz в положение 500. Ручкой ДЕВИАЦИЯ kHz установите по стрелочному индикатору 100 делений, при этом устанавливается девиация частоты 500 кГц.

Установка пределов девиации проводится переключателем ДЕВИАЦИЯ kHz, а плавная установка — ручкой ДЕВИАЦИЯ kHz. Отсчет девиации проводится по стрелочному индикатору, шкала индикатора линейная.

При изменении рабочей частоты калибровка девиометра проводится в указанной выше последовательности.

9.2.6. Для включения режима внутренней импульсной модуляции необходимо нажать кнопки ВНУТР. и ИМ. Для включения режима внешней импульсной модуляции необходимо нажать кнопки ВНЕШН. и ИМ, на разъем ИМ подать импульсы отрицательной полярности амплитудой 5—8 В или положительной полярности амплитудой 10—15 В. Тумблер ПЦ должен соответствовать полярности внешнего модулирующего импульса.

9.2.7. Для включения прибора в систему ФАП используется дополнительный выход, расположенный на задней стенке генератора. Управляющее напряжение подается на разъем ЧМ, при этом все кнопки переключателя рода работ отжаты, одна из кнопок ДИАПАЗОНЫ GHz нажата.

9.2.8. Для включения режима амплитудной модуляции необходимо нажать кнопку АМ, режим внешней или внутренней модуляции включается нажатием соответствующей кнопки ВНЕШН. или ВНУТР. При внешней модуляции на гнездо АМ подается внешний синусоидальный сигнал частотой от 50 Гц до 20 кГц, амплитудой порядка 2 В. Регулировка глубины модуляции проводится ручкой ГЛУБИНА.

9.2.9. Для выключения прибора необходимо отжать обе кнопки ДИАПАЗОНЫ GHz, перевести тумблер ВКЛ. СЕТЬ в нижнее положение, отсоединить шнур питания и все кабели, соединяющие прибор с другими видами оборудования.

## 10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Ремонт генератора Г4-129 должен проводиться в специализированных ремонтных органах или поверочных лабораториях.

10.2. Для доступа к узлам генератора при ремонте необходимо отключить его от сети, вскрыть в соответствии с указаниями (п. 4.3.1).

10.3. Прежде чем начинать ремонт неисправного узла, необходимо проверить поступление на него входных сигналов и наличие номинальных питающих напряжений.

10.4. При проведении ремонта следует строго выполнять меры безопасности, указанные в разделе 7.

10.5. Перечень наиболее возможных неисправностей и указания по их устранению приведены в табл. 5.

Таблица 5

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
1. При включении тумблера СЕТЬ не загорается цифровое табло	Неисправен сетевой кабель или предохранитель	Отремонтировать кабель, заменить неисправный предохранитель
2. Отсутствует мощность на обоих выходах, показания индикатора частоты не изменяются при вращении ручки ЧАСТОТА MHz	Нет мощности с задающего генератора	Проверить и отремонтировать задающий генератор

Продолжение табл. 5

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
3. Индикатор частоты работает normally, мощность на дополнительном выходе находится в пределах нормы; мощность на основном выходе отсутствует, система АРМ работает (при вращении ручки УРОВЕНЬ показания индикаторного прибора изменяются)	а) нарушение контакта в аттенюаторе ступенчатом  б) ВЧ сигнал не проходит через модулятор электрически управляемый	Проверить мощность на разъеме Ш1 блока комбинированного. В случае normalной мощности с блока комбинированного: — отремонтировать аттенюатор ступенчатый  Сигнал на выходе блока комбинированного отсутствует:  а) проверить ток через последовательные диоды модулятора на входе 1 малоемкостного фильтра блока комбинированного. В случае отсутствия тока (25 мА) проверить и исправить схему питания  б) отремонтировать модулятор
4. Индикатор частоты работает normally, мощность на дополнительном выходе находится в пределах нормы; мощность на основном выходе отсутствует, система АРМ не работает	а) не подается опорное напряжение  б) не работает УПТ системы АРМ  в) отсутствует сигнал коммутации ФНЧ  г) неисправен аттенюатор электрически управляемый	Измерить вольтметром напряжение на выводе Э1 блока комбинированного (0,5—0,3 В). При отсутствии указанного напряжения проверить цепи подачи опорного напряжения и устранить обнаруженную неисправность  Проверить УПТ и заменить неисправные элементы  Проверить правильность подачи сигналов коммутации ФНЧ и устранить неисправности  Проверить прохождение сигнала через аттенюатор и отремонтировать
5. Индикатор частоты работает normally; мощность на основном и дополнительном выходе отсутствует или ниже нормы.	Неисправен один из усилителей тракта формирования диапазона (0,6—1,2 ГГц, 0,3—1,2 ГГц, 0,3—0,6 ГГц) или коммутатор	Устранить неисправность усилителя; сменить неисправный ріп диод коммутатора

Продолжение табл. 5

Наименование неисправности, виновное проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
6. Мощность на основном выходе при 20 дБ ослабления ступенчатого аттенюатора больше 10 мВт и не регулируется ручкой УРОВЕНЬ	а) неисправен детекторный диод Д3 датчика уровня  б) разрыв системы АРМ	Проверить диод Д3 и неисправный заменить  Проверить передачу сигнала по низкочастотной части кольца системы АРМ
7. Большой частотный ход выходной мощности основного выхода	Обрыв конденсатора С1 на плате датчика уровня 2.245.389	Заменить конденсатор
8. При вращении ручки ЧАСТОТА MHz показания цифрового индикатора не меняются, параметры сигнала на основном и дополнительном выходах в пределах норм	а) неисправен индикатор частоты  б) неисправен делитель частоты на 128	Проверить сигнал на выходе З малосигнального ФНЧ блока комбинированного. Если при перестройке генератора частота на выходе малосигнального фильтра З блока комбинированного изменяется в пределах 4,6—9,5 МГц, а уровень сигнала порядка 0,5 В, то неисправен встроенный индикатор частоты. Устранить неисправность индикатора частоты  При перестройке генератора частота на выходе малосигнального фильтра З не изменяется. Найти и устранить неисправность в одной из плат делителя частоты на 128

Примечание. Приведенный перечень не является исчерпывающим. При ремонте прибора следует пользоваться таблицами режимов полупроводниковых приборов.

10.6. Сделать отметку о ремонте в формуляре и провести поверку прибора согласно указаниям раздела 12.

10.7. При необходимости более сложного ремонта (в объеме среднего ремонта) по вопросам заказа ремонтного ЗИПа, ремонтной документации, а также по получению адресов предприятий централизованного ремонта приборов необходимо обращаться к заводу-изготовителю по адресу, указанному в формуляре прибора.

## **11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **11.1. Перечень контрольно-профилактических работ.**

11.1.1. С целью обеспечения работоспособности прибора в течение всего времени эксплуатации должны проводиться следующие контрольно-профилактические работы:

Внешний осмотр прибора:

- а) проверка крепления органов управления и регулировки, плавности их действия и четкости фиксации;
- б) состояние лакокрасочных и гальванических покрытий;
- в) проверка комплектности прибора и исправности кабелей, придаваемых к прибору;
- г) проверка общей работоспособности прибора.

Внешний осмотр прибора проводится один раз в 12 месяцев, а также совмещается с другими видами контрольно-профилактических работ.

11.1.2. Проверка прибора на соответствие техническим характеристикам, приведенным в паспорте. Проверка проводится согласно методике, изложенной в разделе ПОВЕРКА ПРИБОРА. Этот вид контрольно-профилактических работ проводится один раз в год и после ремонта прибора.

11.1.3. Осмотр внутреннего состояния монтажа и узлов прибора проводится после истечения гарантийного срока один раз в два года. Проверяется крепление узлов, качество паяк, состояние контактов ВЧ разъемов, работа переключателей, отсутствие трещин и сколов на деталях из пластмассы, удаляется грязь и коррозия. Коррозированные места защищаются и покрываются соответствующей смазкой.

## **12. ПОВЕРКА ПРИБОРА**

Настоящий раздел составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 8.322—78 «Генераторы сигналов измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 0,03—17,44 ГГц» и устанавливает методы и средства поверки генератора.

Периодичность поверки один раз в 12 месяцев.

12.4.4	Определение погрешности установки ослабления аттенюатора	400 МГц, 1200 МГц 20—110 дБ 120 дБ 130 дБ 139 дБ	$\pm 1$ дБ $\pm 1,26$ дБ $\pm 1,78$ дБ $\pm 4,6$ дБ	ДК1-12 Г4-76А или Г4-128
12.4.5	Определение коэффициента гармоник отдающей частотно-модулированного выходного сигнала в режимах ВНУТР. ЧМ и ВНЕШН. ЧМ	Крайние частоты диапазона, девиация 500 кГц 2% (ВНУТР. ЧМ), 5% (ВНЕШН. ЧМ)	С6-5 или С6-1, СК3-41 или СК3-45, Г3-102 или Г3-118	
12.4.6	Определение среднеквадратического значения напряжения модулирующего сигнала, необходимого для обеспечения девиации 500 кГц	Крайние частоты диапазона, модулирующие частоты 50 Гц и 60 кГц	Г4-102 или Г3-118, В7-16 или В7-16А	
12.4.7	Определение основной погрешности установки девиации частоты в режиме ВНУТР. ЧМ	310, 600, 1000 МГц Девиация 500, 200, 100, 50, 30 кГц	$\pm 15\%$ от номинала шкалы	СК3-41 или СК3-45
12.4.8	Определение погрешности установки девиации частоты в диапазоне модулирующих частот	310, 1000 МГц, девиация 500 кГц, модулирующие частоты 50, 200 Гц, 1, 20, 60 кГц	$\pm 20\%$ от номинала шкалы	СК3-41 или СК3-45, Г3-102 или Г3-118

Продолжение табл. 6

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отмечки	Допускаемые зна- чения погрешностей или предельные зна- чения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	испомога- тельные
12.4.9	Определение параметров амплитудной модуляции в режиме ВНУТР. ЧМ	310, 1200 МГц, девиация 500 кГц	10%	B3-40 или B3-57, стены, СППМ (спец.)	
12.4.10	Определение параметров генератора при работе в режиме внешней импульсной модуляции	310, 1200 МГц	Согласно п. 2.7.1	G5-50 или G5-54, C1-64, или C1-64A с детектор- ной головкой от УЗ-29	
12.4.11	Определение параметров генератора в режиме внутренней импульсной модуляции (режим мейндр)	310, 1200 МГц	Частота следования $(1000 \pm 100)$ Гц	C1-64 или C1-64A, детекторная головка от УЗ-29	

6 Г4-129 ТО

12.4.12	Определение $K_{ct}U_{вых}$ холда (волковое сопротивление 50 Ом и 75 Ом)	310, 1200 МГц, 700 МГц, при положении аттенюатора 30, 40, 60 дБ	1,5 (для 50 Ом), 2 (для 75 Ом)	PK2-47
12.4.13	Определение максимального уровня сигнала на некалиброванном выходе	Весь диапазон частот	не менее 0,1 мВт, не более 10 мВт	M3-51 ИЛН M3-21А
12.4.14	Определение нестабильности опорного уровня выходной мощности	310, 1200 МГц	$\pm 0,05$ дБ	B7-16, детектор- ная голов- ка от УЗ-29

П р и м е ч а н и я.

- Параметры генератора по пп. 12.4.2, 12.4.5, 12.4.6, 12.4.8, 12.4.9, 12.4.12, 12.4.14 проверяются только после ремонта генератора.
- Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
- Образцовые (вспомогательные) средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспорах) о государственной или ведомственной поверке.

12.1.2. При проведении поверки должны применяться средства, указанные в табл. 7.

Таблица 7

Наименование средств поверки	Основные технические характеристики средств поверки		Рекомен- дуемое средство проверки	Примечание
	пределы измерения	погрешность		
Частотомер электрон- но-счетный	1 кГц, 300—1250 МГц	$10^{-4}$	Ч3-38 или Ч3-54 с блоками Я3Ч-41, Я3Ч-42	
Установка для халиф- ровки аттенюаторов	Диапазон частот 310—1200 МГц, пределы измерений 0—119 дБ относит. $10^{-2}$ Вт	$\pm 0,3$ дБ	ДК1-12	
Генератор сигналов низкочастотный	Диапазон частот 0,05—60 кГц, коэффициент гармоник 0,2%, напряжение вы- хода 5 В	$\pm 4\%$	Г3-102 или Г3-118	
Измеритель модуляции и девиации	Пределы измерения де- виации 1—600 кГц, диа- пазон модуляции от их частот 0,05—60 кГц, КНИ $< 0,3\%$	$\pm 3\%$	СК3-41 или СК3-45	
Измеритель нелинейных искажений	Пределы измерения и я коэффициента гармоник 0,1—5%	$\pm 0,6\%$	С6-5 или С6-7, или С6-11	

Оscиллограф	Полоса пропускания 0—30 МГц, чувствительность 5 мВ/дел.	C1-64 или C1-64A
Детекторная головка	Диапазон частот 300—1200 МГц	Из комплекта усилителя УЗ-29
Ваттметр поглощаемой мощности термоэлектрический	Диапазон частот 300—1200 МГц, пределы измерения 0,1—10 мВт	M3-21A или M3-51
Вольтметр универсальный	U = 0,01—300 В U ~ = 100 мВ—10 В диапазон частот 50 Гц—60 кГц	B7-16 или B7-16A
Микровольтметр	Диапазон измерений 10 мВ—1 В диапазон частот 50 Гц—60 кГц	B3-40 или B3-57
Памператель К ст U <sup>11</sup> ослабления панорамный	Диапазон частот 310—1200 МГц, $K_{ст} U = 1,02 \pm 2$	PK2-47
Генератор импульсов	0,3—500 мкс, 10 Гц—20 кГц, длительность фронта и спада не более 0,15 мкс	T5-50 или T5-54
Ваттметр поглощаемой мощности	Диапазон частот 310—1200 МГц, пределы измерения 0,05—3 мВт	M3-51 ±4,2% (без учета погрешности из-за рассогласования) с преобразователем 4,681,47

Продолжение табл. 7

Наименование средств измерения	Основные технические характеристики средств измерения		Рекомен- дуемое средство проверки	Примечание
	пределы измерения	погрешность		
Генератор сигналов вы- сокочастотный	Диапазон частот 310—1200 МГц, два выхода, мощность 5—10 мВт	Г4-128		

## 12.2. Условия поверки и подготовка к ней.

12.2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды  $(293 \pm 5)$  К,  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха  $(65 \pm 15)\%$ ;
- атмосферное давление  $(100 \pm 4)$  кПа,  $(750 \pm 30)$  мм рт. ст.;
- напряжение питания  $(220 \pm 4,4)$  В частотой  $(50 \pm 0,5)$  Гц и содержанием гармоник до 5%.

12.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе 8.

## 12.3. Проведение поверки.

12.3.1. При проведении внешнего осмотра должны быть проверены все требования по пункту 6.2. Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

12.3.2. Опробование работы генератора проводится по п. 9.1.4 для оценки его исправности без применения средств поверки. Несправные генераторы также бракуются и направляются в ремонт.

## 12.4. Определение метрологических параметров.

12.4.1. Проверка основной погрешности установки частоты прибора по встроенному индикатору частоты проводится частотометром ЧЗ-38 с блоками ЯЗЧ-41 и ЯЗЧ-42 на крайних частотах каждого поддиапазона (310 и 600 МГц, 600 и 1200 МГц) и одной промежуточной частоте каждого поддиапазона. Измерения проводятся в режиме немодулированных колебаний в положении 30 переключателей ОСЛАБЛЕНИЕ dB. Частотометр подключается к калиброванному выходу. Тумблер переноса запятой встроенного индикатора частоты устанавливается в положение « $\times 1$ », ручки ДЕВИАЦИЯ kHz и ГЛУБИНА ставятся в крайнее левое положение, ручка УРОВЕНЬ — в крайнее правое положение.

Погрешность установки частоты ( $\delta f$ ) в процентах вычисляется по формуле:

$$\delta_f = \frac{f_{\text{ном}} - f_{\text{изм}}}{f_{\text{изм}}} \cdot 100,$$

где  $f_{\text{ном}}$  — показание встроенного индикатора частоты;

$f_{\text{изм}}$  — показание частотометра.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если прибор удовлетворяет требованиям п. 2.3.2.

12.4.2. Проверка нестабильности частоты прибора проводится с помощью частотомера ЧЗ-38 с блоками ЯЗЧ-41, ЯЗЧ-42 на частотах 1200 и 310 МГц.

Нестабильность частоты сигнала определяется как отношение наибольшей разности значений частот сигнала, измеренных за 15-минутный интервал времени, к значению установленной частоты.

После измерения нестабильности частоты после самопрогрева прибора в течение 30 мин. или 2 ч прибор перестраивается на другую частоту и после 15-минутного дополнительного времени установления рабочего режима проводится измерение нестабильности частоты.

Проверка изменения частоты проводится в положении 30—40 переключателей ОСЛАБЛЕНИЕ дБ. Результаты проверки считаются удовлетворительными, если прибор соответствует требованиям п. 2.3.3.

12.4.3. Основная погрешность установки опорного значения выходной мощности  $10^{-3}$  Вт определяется по структурной схеме рис. 11.

Основная погрешность установки опорного уровня выходной мощности  $10^{-3}$  Вт ( $\delta$ ) в децибелах определяется по формуле:

$$\delta = 10 \lg \frac{P_{\text{ном}}}{P_{\text{изм}}},$$

где  $P_{\text{ном}}$  —名义ное значение мощности  $10^{-3}$  Вт,

$P_{\text{изм}}$  — измеренное значение мощности, Вт.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если прибор соответствует требованиям п. 2.4.1.

12.4.4. Определение основной погрешности установки ослабления ступенчатого аттенюатора, дополнительной погрешности при значениях ослабления свыше 110 дБ и дополнительной погрешности установки выходной мощности при малых ее значениях (остаточной выходной мощности) проводится одновременно путем определения суммарной погрешности (сумма основной и дополнительной погрешностей) с помощью установки ДК1-12 и генератора высокочастотного Г4-128 (генератор сигналов высокочастотный Г4-129 с усилителем мощности) в соответствии с рис. 12.

При измерениях не допускается поворот ручки УРОВЕНЬ.

Измерения проводятся на частотах 400 и 1200 МГц при положениях аттенюатора 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 139 дБ относительно положения 30 дБ.

С целью исключения случайных ошибок измерения на больших ослаблениях рекомендуется проводить не менее трех раз и за результат измерения брать среднюю величину.

Балансировка измерителя ДК1-12 проводится дважды: с дополнительным аттенюатором 30 дБ при установке аттенюатора прибора Г4-129 на 20 дБ, с дополнительным аттенюатором 10 дБ при измерении ослаблений более 110 дБ.

Суммарная погрешность ослабления аттенюатора ( $\Delta A$ ) в децибелах вычисляется по формуле:

$$\Delta A = A_{\text{ном}} - A_{\text{изм}} - 30,$$

где  $A_{\text{ном}}$  — номинальное значение ослабления аттенюатора (показание шкалы), дБ,

$A_{\text{изм}}$  — измеренное значение ослабления аттенюатора, дБ.

Допустимая суммарная погрешность при ослаблениях до 110 дБ не должна превышать  $\pm 1$  дБ, а при ослаблениях свыше 110 дБ определяется по формуле:

$$\Delta A = \pm \left[ 1 + 0,02(A_{\text{ном}} - 110) + 3 \cdot 10^{\frac{A_{\text{ном}} - 139}{10}} \right]$$

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если погрешность не превышает следующих значений:

$\pm 1$  дБ при ослаблении от 20 до 110 дБ;

$\pm 1,26$  дБ при ослаблении 120 дБ;

$\pm 1,78$  дБ при ослаблении 130 дБ;

$\pm 4,6$  дБ при ослаблении 139 дБ.

12.4.5. Коэффициент гармоникгибающей частотно-модулированного сигнала определяют при помощи измерителя нелинейных искажений С6-5, подключенного к ВЫХОДУ НЧ измерителя девиации СКЗ-41. В качестве источника внешнего модулирующего сигнала в режиме ВНЕШН. ЧМ используется генератор Г3-102.

Измерения проводят на несущих частотах 310 и 1000 МГц при девиации частоты 500 кГц.

Частота модулирующего сигнала при внутренней модуляции 1000 Гц, при внешней модуляции 50 Гц (при полосе СКЗ-41 20 кГц) и 60 кГц (при полосе СКЗ-41 200 кГц).

Из показаний измерителя коэффициента гармоник исключается остаток, обусловленный наличием паразитной модуляции.

Коэффициент гармоник ( $K_r$ ) в процентах вычисляется по формуле:

$$K_r = \sqrt{K_{f_0}^2 - K_{f_{\text{ост}}}^2},$$

где  $K_{f_0}$  — показание измерителя коэффициента гармоник при девиации 500 кГц

$K_{f_{\text{ост}}}$  — показание измерителя коэффициента гармоник при работе генератора при снятом модулирующем напряжении.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения коэффициента гармоник в режиме ВНУТР. ЧМ и ВНЕШН. ЧМ не превышают 2% и 5% соответственно.

12.4.6. Проверка среднеквадратического значения внешнего модулирующего сигнала, необходимого для обеспечения девиации частоты 500 кГц при крайнем правом положении ручки ДЕВИАЦИЯ kHz, проводится с помощью цифрового вольтметра В7-16 и генератора Г3-102 в соответствии с рис. 13.

Измерения проводят на крайних частотах диапазона при модулирующих частотах 50 Гц и 60 кГц. Перед измерением напряжения на каждой несущей частоте проводят калибровку встроенного в генератор измерителя девиации.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если прибор соответствует требованиям п. 2.5.6.

12.4.7. Проверка основной погрешности установки девиации частоты в режиме ВНУТР. ЧМ проводится измерителем модуляции СК3-41 на несущих частотах 310 и 600 МГц.

Внутренний измеритель девиации калибруется и по шкале устанавливается девиация ( $\Delta f$ ) 500, 200, 100, 50 и 30 кГц. Установленные значения девиации измеряются прибором СК3-41. В качестве измерения берется средняя девиация, измеренная «вверх» и «вниз».

Погрешность установки девиации частоты  $\delta_0$  в процентах вычисляется по формуле:

$$\delta_0 = \frac{\Delta f_{\text{ном}} - \Delta f_{\text{изм}}}{\Delta f_{\text{макс}}} \cdot 100,$$

где  $\Delta f_{\text{ном}}$  — номинальное значение девиации;

$\Delta f_{\text{изм}}$  — измеренное значение девиации;

$\Delta f_{\text{макс}}$  — максимальное гарантируемое значение девиации частоты на установленном пределе.

Погрешность на частоте 1200 МГц гарантируется проверкой погрешности на частоте 600 МГц первого поддиапазона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если погрешность установки девиации частоты в режиме ВНУТР. ЧМ не превышает  $\pm 15\%$  от номинала отсчетной шкалы.

12.4.8. Проверка погрешности установки девиации частоты в диапазоне модулирующих частот проводится с помощью прибора СК3-41 на несущих частотах 310 и 1000 МГц.

Прибор Г4-129 ставится в режим ВНЕШН. ЧМ, на гнездо ЧМ с генератора Г3-102 подается модулирующее напряжение не более 5 В. Внутренний измеритель девиации частоты калибруется и ручкой ДЕВИАЦИЯ kHz устанавливается девиация 500 кГц при частотах модуляции 50, 200, 1000, 20000, 60000 Гц. Установленная девиация измеряется прибором СК3-41.

6 Г4-129 ТО	12.4.12	Определение $K_{ct}$ У выхода (волновое сопротивление 50 Ом и 75 Ом)	310, 1200 МГц, 700 МГц, при положении аттенюатора 30, 40, 60 дБ	1,5 (для 50 Ом), 2 (для 75 Ом)	PK2.47
	12.4.13	Определение максимального уровня сигнала на некалиброванном выходе	Весь диапазон частот	не менее 0,1 мВт, не более 10 мВт	M3-51 ИЛН M3-21А
	12.4.14	Определение нестабильности опорного уровня выходной мощности	310, 1200 МГц	$\pm 0,05 \text{ дБ}$	B7-16, датчикор- наж голов- ка от УЗ-29

**П р и м е ч а н и я.**

- Параметры генератора по шп. 12.4.2, 12.4.5, 12.4.6, 12.4.8, 12.4.9, 12.4.12, 12.4.14 проверяются только после ремонта генератора.
- Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
- Образцовые (вспомогательные) средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.

Погрешность установки девиации частоты ( $\delta$ ) в процентах вычисляется по формуле:

$$\delta = \frac{\Delta f_F - \Delta f_{изм}}{\Delta f_{макс}} \cdot 100,$$

где  $\Delta f_F$  — девиация частоты, установленная по отсчетному устройству при частоте модуляции  $F$ , кГц;

$\Delta f_{изм}$  — девиация частоты, измеренная внешним измерителем девиации, кГц;

$\Delta f_{макс}$  — максимально гарантируемое значение девиации частоты на установленном пределе.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если погрешность установки девиации частоты в режиме ВНЕШН. ЧМ не превышает  $\pm 20\%$  от номинала отсчетной шкалы.

12.4.9. Проверка паразитной амплитудной модуляции в режиме внутренней частотной синусоидальной модуляции проводится на крайних частотах диапазона при девиации 500 кГц по схеме, приведенной на рис. 14.

Сигнал с генератора мощностью порядка 100—300 мкВт подается на детекторную головку.

Коэффициент паразитной амплитудной модуляции ( $m$ ) в процентах вычисляется по формуле:

$$m = \frac{U_k}{\gamma I(R_u + R_{np})} \cdot 100,$$

где  $U_k$  — показание микровольтметра В3-40;

$\gamma$  — коэффициент формы детекторной головки;

$I$  — ток, протекающий по микроамперметру ИП;

$R_u$ ,  $R_{np}$  — сопротивление нагрузки и внутреннее сопротивление микроамперметра.

Коэффициент  $\gamma$  для различных детекторов в зависимости от выходной мощности может быть в пределах 1—3 и определяется

изменением мощности, подаваемой на детекторную головку. Коэффициент  $\gamma$  вычисляется по формуле:

$$\gamma = \frac{20 \lg \frac{I_1}{I_2}}{n_1 - n_2},$$

где  $I_1, I_2$  — показания микроамперметра, соответствующие положениям  $n_1$  и  $n_2$  аттенюатора генератора, дБ.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если прибор соответствует требованиям п. 2.5.8.

12.4.10. Проверка прибора в режиме внешней амплитудной импульсной модуляции проводится подачей на разъем ИМ при нажатой кнопке ВНЕШН. с генератора ГБ-50 или ГБ-54 импульсов положительной и отрицательной полярности (в зависимости от положения тумблера  $\Gamma / \Gamma'$ ). Проверка проводится на частотах 310, 600, 900, 1200 МГц при длительностях выходных импульсов 0,5; 10, 500 мкс при модулирующих частотах 1 кГц и 10 кГц (для длительности импульсов 0,5 и 10 мкс). Ручки ОСЛАБЛЕНИЕ dB ставятся в положение 30.

Амплитуда модулирующих импульсов и соответствие их требованиям, указанным в п. 2.7.1 определяется с помощью осциллографа.

Определение параметров выходных импульсов прибора проводится с помощью осциллографа и детекторной головки, нагруженной на сопротивление  $150 \pm 300$  Ом (постоянная времени  $t < 3 \cdot 10^{-8}$  с).

Типичные осциллограммы импульсов и пример определения их параметров указан на рис. 15.

Измерение параметров импульсов проводится по следующей методике.

Определяется амплитуда импульса в точке пересечения плоской части вершины с линией фронта ( $A_u$ ) и в точке пересечения продолжения плоской части с линией среза ( $A_{uc}$ ).

П р и м е ч а н и я:

1. За линию фронта (среза) принимается касательная, проходящая через точку наибольшей крутизны фронта (среза).

2. Под плоской частью вершины понимается наибольшая по длительности часть ее, наиболее близкая к прямой и имеющая наименьший наклон к линии развертки. При длительности импульса, когда возникают трудности в определении плоской части вершины, рекомендуется увеличить длительность радиоимпульса до появления выраженной плоской части, увеличивая длительность модулирующего импульса (см. рис. 15б).

Длительность импульса определяется на уровне 0,5 от амплитуд  $A_u$  и  $A_{uc}$ .

Длительность фронта определяется временем между точками пересечения уровней 0,1 и 0,9  $A_u$  с линией фронта.

Длительность среза определяется временем между точками пересечения уровней 0,1 и 0,9  $A_{uc}$  с линией среза.

Неравномерность вершины импульса ( $\delta A$ ) в процентах определяется по формуле:

$$\delta A = 2 \frac{(A_n - A_{nc})}{A_n + A_{nc}} \cdot 100$$

При наличии колебаний на вершине импульса (см. рис. 15б,в) допускается неравномерность вершины определять по формуле:

$$\delta A = 2 \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}} \cdot 100$$

Изменение длительности выходных импульсов относительно модулирующих ( $\Delta t$ ) определяется по формуле:

$$\Delta t = \tau_{\text{mod}} - \tau_u,$$

где  $\tau_{\text{mod}}$  — длительность модулирующего импульса,

$\tau_u$  — длительность продетектированного импульса.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если прибор удовлетворяет требованиям п. 2.7.1.

12.4.11. Проверка частоты следования импульсов меандр в режиме ВНУТР. ИМ проводится с помощью частотомера ЧЗ-38. Частотомер подключается к разъему АМ генератора при нажатых кнопках ВНУТР. и ВНЕШН.

Погрешность частоты внутреннего модулятора в Гц вычисляется по формуле:

$$\Delta F = F_{\text{ном}} - F_{\text{изм}},$$

где  $F_{\text{ном}}$  — номинальная частота (1000 Гц) внутреннего модулятора;

$F_{\text{изм}}$  — частота, измеренная частотометром.

Несимметрия полупериодов меандра определяется по осциллографу, на который подается через детекторную головку ВЧ меандр.

Несимметрия определяется как отношение длительности большого полупериода к меньшему.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если прибор соответствует требованиям п. 2.7.2.

12.4.12. Проверка  $K_{ct}U$  выхода прибора проводится с помощью измерителя РК2-47.

$K_{ct}U$  измеряется при подключении к основному выходу генератора придаваемого кабеля 4.852.106, внешнего аттенюатора 20 dB (вольновое сопротивление 50 Ом); придаваемого кабеля

4.852.106 трансформатором сопротивлений 50/75 Ом (волновое сопротивление 75 Ом). Измерения проводятся при положениях переключателя ступенчатого аттенюатора 30, 40 и 60 dB.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если прибор соответствует требованиям п. 2.4.9.

12.4.13. Проверка мощности выходного сигнала на цекалиброванном выходе генератора проводится прибором М3-51 или М3-21А.

Измерения проводят во всем диапазоне частот с фиксацией наибольшего и наименьшего значений мощности.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если прибор соответствует требованиям п. 2.4.12.

12.4.14. Проверка нестабильности опорного уровня выходной мощности проводится измерением выходного напряжения с детекторной головки из комплекта УЗ-29 вольтметром В7-16 при подаче на детекторную головку сигнала с прибора при положении ступенчатого аттенюатора 20 dB.

Измерения проводят в течение 30 мин. через каждые 3 мин. после времени установления рабочего режима в течение 30 мин. на любой крайней частоте диапазона.

Детекторная головка должна располагаться возможно дальше от всех нагревающихся приборов, чтобы в процессе измерений ее температура оставалась постоянной. Соединительные высокочастотные кабели во время измерений не должны перемещаться.

Нестабильность опорного значения напряжения выходного сигнала в децибелах вычисляется по формуле:

$$\delta p = \frac{20 \lg \frac{U_{\max}}{U_{\min}}}{\gamma},$$

где  $U_{\max}$  и  $U_{\min}$  — соответственно максимальное и минимальное показание вольтметра в течение 15-минутного интервала времени;

$\gamma$  — коэффициент формы детекторной головки.

Коэффициент  $\gamma$  для различных детекторов может быть в пределах 1—3 и определяется изменением мощности, подаваемой на детекторную головку.

Коэффициент  $\gamma$  вычисляется по формуле:

$$\gamma = \frac{20 \lg \frac{U_1}{U_2}}{n_2 - n_1},$$

где  $U_1$  и  $U_2$  — показания вольтметра, соответствующие положениям  $n_1$  и  $n_2$  аттенюатора прибора.

Прибор перестраивается на другую частоту и после 15-минутного дополнительного времени установления рабочего режима аналогичным образом проводится измерение нестабильности опорного уровня.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если прибор соответствует требованиям п. 2.4.8.

#### 12.5. Оформление результатов поверки.

12.5.1. Результаты измерений заносятся в протоколы, форма которых приведена ниже.

12.5.2. Положительные результаты первичной и ведомственной поверок оформляют в порядке, установленном ведомственной и метрологической службами.

12.5.3. Приборы, не удовлетворяющие требованиям раздела 12, бракуются и на них выдают справку о запрещении приборов к применению.

## 12.6. Приложение к разделу ПОВЕРКА.

### 12.6.1. Форма протоколов поверки.

#### П Р О Т О К О Л №\_\_\_\_\_

Определение погрешности установки частоты по встроенному отсчетному устройству (пп. 2.3.2, 12.4.1).

Прибор Г4-129 №\_\_\_\_\_

Проверяемые частоты, МГц	Измеренная погрешность, %	Допускаемая погрешность, %
		±0,05

Вывод: прибор соответствует п. 2.3.2 ТО.

Измерения проводил \_\_\_\_\_

(подпись поверителя)

(дата)

**П Р О Т О К О Л №**

Определение нестабильности частоты сигнала (пп. 2.3.3, 12.4.2).

Прибор Г4-129 №

Проверяемый параметр	Измеренное значение	Допускаемая погрешность
1. Значение установленной частоты, МГц		
2. Нестабильность частоты за 15-минутный интервал после установления рабочего режима в течение 30 мин.		$\pm 2,5 \cdot 10^{-4}$
3. Нестабильность частоты за 15-минутный интервал после установления рабочего режима в течение 2 ч		$\pm 5 \cdot 10^{-6}$
4. Значение установленной частоты после перестройки, МГц		
5. Нестабильность частоты за 15-минутный интервал времени после перестройки		

Вывод: прибор соответствует п. 2.3.3 ТО.

*Измерения проводил*

(подпись поверителя)

(дата)

**П Р О Т О К О Л №**

Определение основной погрешности установки опорного уровня мощности на калиброванном выходе (пп. 2.4.2, 12.4.3).

Прибор Г4-129 №

Проверяемые частоты, МГц	Измеренная погрешность, дБ	Допускаемая погрешность, дБ
		±1

Вывод: прибор соответствует п. 2.4.2 ТО.

*Измерения проводил* \_\_\_\_\_  
(подпись поверителя) \_\_\_\_\_ (дата)

## П Р О Т О К О Л №

Определение погрешности установки ослабления аттенюатора  
(пп. 2.4.3, 12.4.4).

Прибор Г4-129 №

Проверяемое ослабление, дБ	Допускаемая погрешность, дБ	Измеренная погрешность, дБ	
		на f=410 МГц	на f=1200 МГц
20	± 1		
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
100			
110			
120	±1,26		
130	±1,78		
139	±4,6		

Вывод: прибор соответствует п. 2.4.3 ТО.

Измерения проводил

(подпись поверителя)

(дата)

## П Р О Т О К О Л №

Определение коэффициента гармоник огибающей частотно-модулированного сигнала в режимах ВНУТР. ЧМ и ВНЕШН. ЧМ (пп. 2.5.4, 12.4.5).

Прибор Г4-129 №\_\_\_\_\_.

Несущая частота, МГц	Частота модуляции, кГц	Допускаемое значение коэффициента гармоник, %	Измеренный коэффициент гармоник, %
310	1,0 (ВНУТР. ЧМ)	2	
1000			
310	0,05 60		
1000	0,05 60	5	

Вывод: прибор соответствует п. 2.5.4 ТО.

Измерения проводил \_\_\_\_\_  
(подпись поверителя) \_\_\_\_\_ (дата)

## П Р О Т О К О Л №

Определение среднеквадратического значения напряжения модулирующего сигнала, необходимого для обеспечения девиации 500 кГц (пп. 2.5.6, 12.4.6).

Прибор Г4-129 №\_\_\_\_\_.

Несущая частота, МГц	Модулирующая частота, кГц	Модулирующее напряжение, В	
		измеренное	допустимое
310	0,05 60		не более 5
1000	0,05 60		

Вывод: прибор соответствует п. 2.5.6 ТО.

Измерения проводил \_\_\_\_\_  
(подпись поверителя) \_\_\_\_\_ (дата)

**П Р О Т О К О Л №**

Определение основной погрешности установки девиации частоты в режиме ВНУТР. ЧМ (пп. 2.5.2, 12.4.7).

Прибор Г4-129 №

Положение переключателя ДЕВИАЦИЯ, кГц	Установленная девиация, кГц	Измеренная погрешность, %		Допустимая погрешность, %
		на $f=310$ МГц	на $f=1000$ МГц	
50	30			$\pm 15$
	50			
100	50			
	100			
200	100			
	200			
500	200			
	500			

Вывод: прибор соответствует п. 2.5.2.

Измерения проводил

(подпись поверителя)

(дата)

П Р О Т О К О Л №

Определение погрешности установки девиации частоты в диапазоне модулирующих частот  
(пп. 2.5.3, 12.4.8).

Прибор Г4-129 №

Установленная девиация, кГц	Частота модуляции, кГц	Измеренная погрешность, %		Допустимая погрешность, %
		на $f = 310$ МГц	на $f = 1000$ МГц	
500	0,05			$\pm 20$
	1,0			
	2,0			
	20			
	60			

ВЫВОД: прибор соответствует п. 2.5.3 ТО.

*Измерения проводил* \_\_\_\_\_  
(подпись поверителя)  
(дата)

**П Р О Т О К О Л №**

Определение паразитной амплитудной модуляции в режиме ВНУТР. ЧМ (пп. 2.5.8, 12.4.9).

Прибор Г4-129 №

Несущая частота, МГц	Измеренная паразитная <sup>ам</sup> девиация частоты, %	Допустимая паразитная <sup>ам</sup> девиация частоты, %
310		10
1200		

Вывод: прибор соответствует п. 2.5.8 ТО.

Измерения проводил

(подпись поверителя)

(дата)

# ПРОТОКОЛ №

Определение параметров генератора в режиме внутренней импульсной модуляции (пп. 2.7.2, 12.4.11).

Прибор Г4-129 №

Несущая частота, МГц	Частота следования, Гц		Несимметрия измерения допустимая
	измеренная	допустимая	
310	1000±100		± 10%
1200	1000±100		

Вывод: прибор соответствует п. 2.7.2 ТО.

Измерения проводил \_\_\_\_\_  
(подпись поверителя)

(дата)

**ПРОТОКОЛ №**Определение  $K_{ct}$  U выхода (волновое сопротивление 50 Ом и 75 Ом) (пп. 2.4.9, 12.4.12).**Прибор Г4-129 №**

Частота, МГц	Положение переключателей ОСЛАБЛЕНИЕ, dB	$K_{ct}$ U на выходе кабеля (нагрузка 50 Ом)		$K_{ct}$ U на выходе аттенюатора 20 дБ		$K_{ct}$ U на выходе трансформатора 50/75 Ом	
		измерен.	допуст.	измерен.	допуст.	измерен.	допуст.
	30		1,5		1,25		2,0
	40						
	60						

Вывод: прибор соответствует п. 2.4.9 ТО.

*Измерения проводил* \_\_\_\_\_  
(подпись поверителя)

(дата)

**П Р О Т О К О Л №**

Определение максимального уровня на некалиброванном вы-  
ходе (пп. 2.4.12, 12.4.13).

Прибор Г4-129 №\_\_\_\_\_.

Частота, МГц	Измеренная мощность, мВт	Допустимое значение мощности, мВт
		не менее 0,1 и не более 10

Вывод: прибор соответствует п. 2.4.12 ТО.

*Измерения проводил* \_\_\_\_\_  
(подпись поверителя) \_\_\_\_\_ (дата)

**П Р О Т О К О Л №**

Определение нестабильности опорного уровня выходной мощ-  
ности (пп. 2.4.8, 2.4.14).


Прибор Г4-129 №\_\_\_\_\_.

Частота, МГц	Измеренная нестабильность, дБ	Допустимая нестабильность, дБ
310		±0,05
1200		

Вывод: прибор соответствует п. 2.4.8 ТО.



*Измерения проводил* \_\_\_\_\_  
(подпись поверителя) \_\_\_\_\_ (дата)

Рис. 15. Осуществляемые умножения.

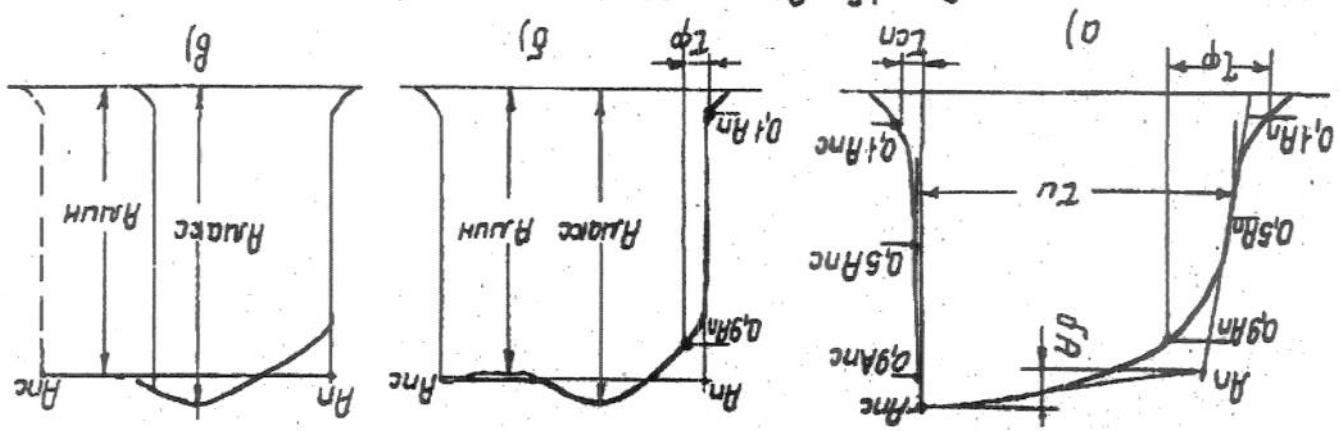

ПРИЛОЖЕНИЕ

Очень важно учесть то, что настройка 50 Ом  
 Рис. 11. Схема структурная опорного генератора 50 Ом  
 переходом 32-112/2, 4-бусе батареи узла питания А2М-66.  
 3-уровня схема синтезатора теплоделителя А.681471  
 4-стабилизатор А-129, 2-приемоакустическая радиостанция А852406.

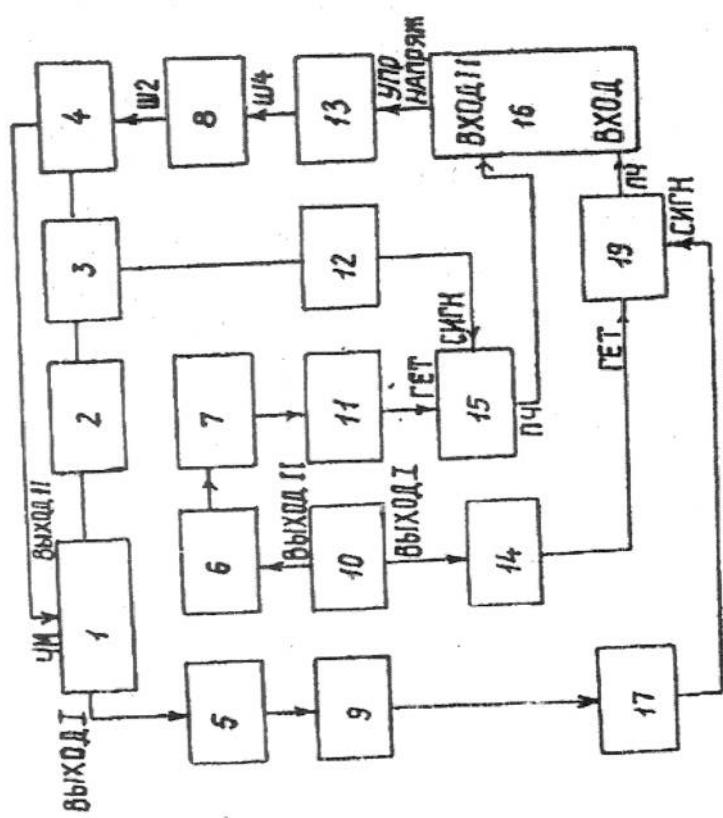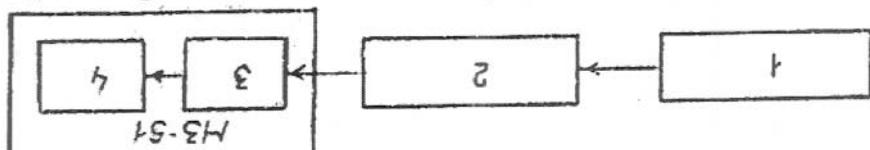

1-пробиваемый генератор Р4-129; 2,5,7,12,14-кабели  
 4,850 394-03 (из комплекта ДК1-12); 3-надфиль  
 аттенюаторов 60÷70 дБ 2.260.029; 4-кабель 4.653.641;  
 6-усилитель мощности (из комплекта Р4-128); 8-фильтр  
 5 МГц 2.067.476; 9-аттенюатор 20 дБ 2.260.029-04;  
 10-генератор Р4-129; 11-аттенюатор 20 дБ 2.260.029-04,  
 13-кабель 4.653.640, 15,19-сигналы 50-700 МГц (2.256.255)  
 или 17-2.145.612 (2.206.255-01); 16-устройство ДК1-12;  
 17-аттенюатор 10 дБ 2.260.029-02.

Рис. 12. Схема структурная опорного генератора  
 ступенчатого прибора Р4-129


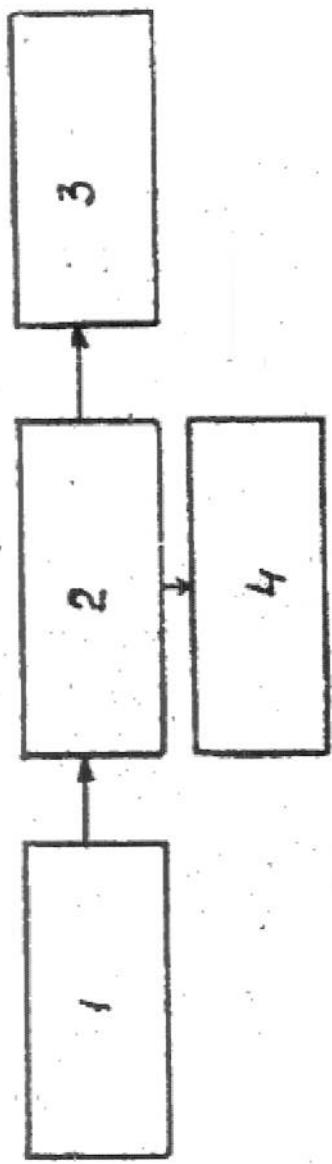


Рис. 13 Схема четырехступенчатого генератора синусоидальной частоты.  
 1 - генератор Л4-102; 2 - тройник СР-50-95д; 3 - усилитель  
 УЧ; 4 - ламповый умножитель 87-16.  
 Рабочий диапазон частоты 100-129 Гц.

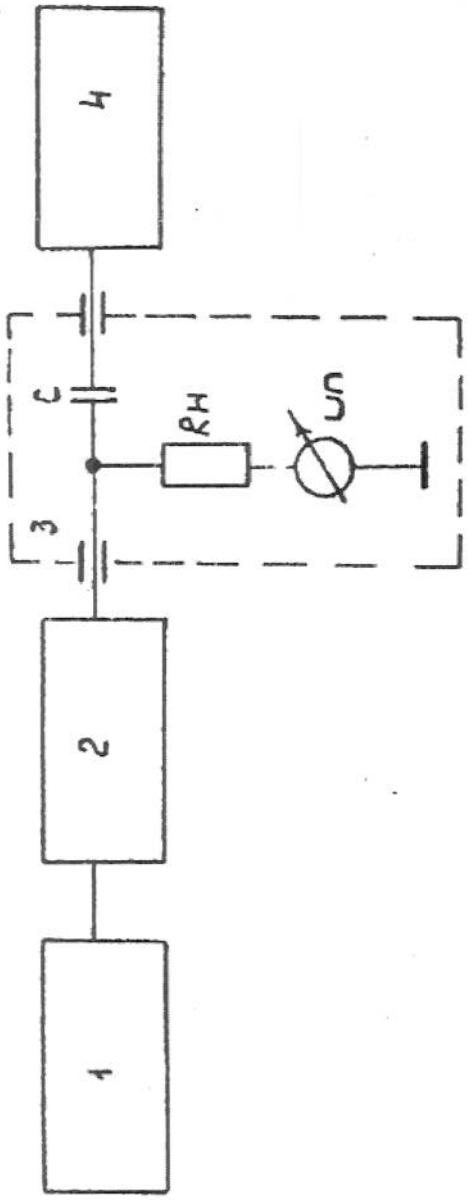

1. Испытуемый генератор Г4-129;
- 3-стенда СПМ;
2. Демпфорная головка от усилителя У-ЧСЛЛИБольтметр УЗ-29, перенесенного тока ВЗ-ЧО.
- Рис. 14. Схема структурная проверки параметров АИ
- Примечание. В стенде СПМ используются следующие элементы:  
 С1 - конденсатор К73П-3-0,05мкФ  $\pm 20\%$ ;  
 Р1 - резистор ОМЛТ-0,5-5100м $\Omega$   $\pm 10\%$ ,  
 УП - микросхема переключения Р9р1. Конденсатор, резистор и микросхема сопротивлением 200м $\Omega$  должны быть пониженны вдвое.

ПРОТОКОЛ №

Определение параметров генератора при работе в режиме внешней импульсной модуляции  
(пп. 2.7.1, 12.4.10).

Прибор Г4-129 №

Несущая частота, МГц	Длительность импульса $\tau_u$ , мкс	Параметры выходных импульсов			Отличие длительности $\tau_u$ от $\tau_{\text{мод}}$ , мкс
		$\tau_{\text{ср}}$ , мкс	$\tau_{\text{ср}}$ , мкс	неравномерность вершины, %	
310	0.5				
	10				
	500				
1200	0.5				
	10				
	500				

Вывод: прибор соответствует п. 2.7.1 ТО.

Измерения проводил \_\_\_\_\_  
(подпись поверителя)

(дата)