

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

Медведевских С.В.

« 15 » _____ 2008 г.

М.П.

**Стандартный образец
фракционного состава
нефти и нефтепродуктов**

(ФС-АРН)

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер ГСО 8459-2003

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 05.10.2002 с изм.1 утв. 28.10.2006 г.
Единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия № 2, дата выпуска сентябрь 2008г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов в аппарате АРН-2.

Область применения: нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: Национальный стандарт РФ ГОСТ 11011-85. Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой дополнительно очищенную от механических примесей, обессоленную и обезвоженную товарную нефть, расфасованную в склянки с навинчивающейся металлической крышкой.

Объем экземпляра СО 2 дм³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля выхода углеводородных фракций, в процентах.

Индекс СО	Интервалы допускаемых значений аттестованных характеристик СО,		Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованных характеристик СО при P=0.95
	В интервале температур, °C	%	
ФС-АРН	*НК - 62	от 1,00 до 4,00	± 0,17
	62 - 70	от 0,50 до 2,00	± 0,07
	70 - 80	от 0,50 до 2,00	± 0,07
	80 - 90	от 0,50 до 2,00	± 0,07
	90 - 100	от 0,50 до 2,00	± 0,07
	100 - 110	от 0,50 до 2,00	± 0,07
	110 - 120	от 1,00 до 2,00	± 0,07
	120 - 130	от 1,00 до 2,00	± 0,07
	130 - 140	от 1,00 до 2,00	± 0,07
	140 - 150	от 1,00 до 2,00	± 0,07
	150 - 160	от 1,00 до 2,00	± 0,07
	160 - 170	от 1,00 до 2,00	± 0,07
	170 - 180	от 1,00 до 2,00	± 0,07
	180 - 190	от 1,00 до 2,00	± 0,07
	190 - 200	от 1,00 до 2,00	± 0,07
	200 - 210	от 0,05 до 2,00	± 0,10
	210 - 220	от 0,20 до 2,50	± 0,10
	220 - 230	от 1,00 до 2,00	± 0,10
	230 - 240	от 1,00 до 2,50	± 0,12
	240 - 250	от 1,00 до 2,50	± 0,12
	250 - 260	от 1,00 до 2,50	± 0,12
	260 - 270	от 1,00 до 2,50	± 0,12
	270 - 280	от 1,00 до 2,50	± 0,12
	280 - 290	от 1,00 до 2,50	± 0,12
	290 - 300	от 1,00 до 3,50	± 0,12
	300 - 310	от 1,00 до 2,50	± 0,12
	310 - 320	от 1,00 до 3,50	± 0,12
	320 - 330	от 1,00 до 2,50	± 0,07
	330 - 340	от 1,00 до 4,00	± 0,10
	340 - 350	от 1,00 до 3,00	± 0,10
	350 - 360	от 1,00 до 2,50	± 0,07
	360 - 370	от 1,00 до 2,50	± 0,07
	370 - 380	от 1,00 до 2,50	± 0,07
	380 - 390	от 1,00 до 2,50	± 0,07

*НК – начало кипения

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО:

Орган ГССО -

- Автономная Некоммерческая Организация «Научно-Производственное Объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149


ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

Орган ГССО -

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»
(ООО «ИНТЕГРСО»)


450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

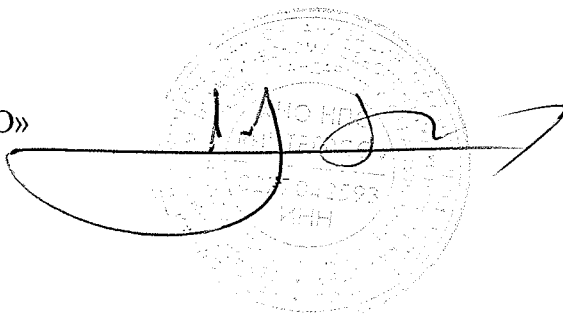

Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»

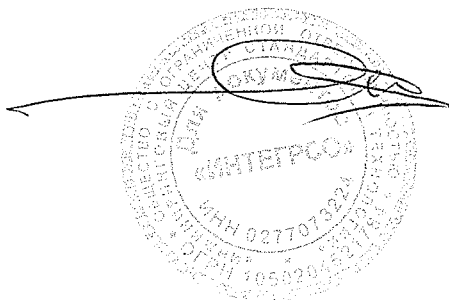

Мухамедзянов Р.А.

Мухамед