

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец состава
водного раствора хлорид-ионов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер 7787-2000

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Технические условия, утвержденные УНИИМ и ЭАА «Экоаналитика», 1995г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Градуировка ионных хроматографов, фотоэлектроколориметров ФЭК-56М, ФЭК-60 или их заменяющих; аттестация методик выполнения измерений, контроль погрешности методик выполнения измерений.

Область применения – Охрана природы, гидрометеорология, санэпиднадзор

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

- градуировка СИ в соответствии с МИ 2345-95 "ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов";

- аттестация МВИ в соответствии с МИ 2336-95 «ГСИ. Характеристики погрешности результатов количественного химического анализа. Алгоритмы оценивания»;

- контроль погрешности результатов измерений, выполняемых в соответствии с ГОСТ 4245-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов»; ИСО 10304/1-92 «Качество воды. Определение растворенных фторида, хлорида, нитрита, ортофосфата, бромид, нитрата и сульфата методом жидкостной ионной хроматографии»; МУ МЗ № 5994-91 «Методические указания по ионохроматографическому измерению концентраций оксидов азота, азотной кислоты, серной кислоты, хлороводорода, о-фосфорной кислоты, аммиака в воздухе рабочей зоны»; «Методикой определения концентрации хлористого водорода турбидиметрическим методом» (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л: Гидрометиздат, 1987г); ПНД Ф 14.1:2.4.23-95 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации анионов фторидов, хлоридов, фосфатов, нитратов, сульфатов в поверхностных, питьевых и сточных водах методом ионной хроматографии» и по другим МВИ содержания хлороводорода и хлорид ионов в объектах окружающей среды, промышленных выбросах, сточной и питьевой воде. Проведение контроля погрешности измерений и обработка результатов по МИ 2335-95.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой водный раствор натрия хлористого. Материал расфасован в стеклянные ампулы объемом 5 см³ или 20 см³. Ампулы имеют этикетку с указанием названия стандартного образца, аттестованной характеристики, аттестованного значения, погрешности аттестованного значения, срока годности экземпляра образца и даты выпуска.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика	Интервал допускаемых аттестованных значений	Границы допускаемой относительной погрешности при P=0,95
Массовая концентрация хлорид-ионов	от 0,475 мг/см ³ до 0,525 мг/см ³ .	±1%

Срок годности экземпляра СО: 3 года.

44

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Эколого-аналитическая ассоциация "Экоаналитика", 119899 Москва Ленинские горы МГУ,
Химический факультет, кафедра аналитической химии

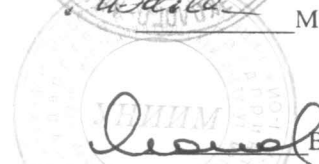
Уральский научно-исследовательский институт метрологии, 620219
Екатеринбург, Красноармейская 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Эколого-аналитическая ассоциация "Экоаналитика".

Генеральный директор
ЭАА "Экоаналитика"


М.М.Залетина

Директор УНИИМ


В.В.Леонов

48