

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
(ГФУП ВНИИМС)

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГФУП ВНИИМС

А.И. Асташенков

"августа" 2000 г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
ГСИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
BT, ST, CT и NT
фирмы "BIZERBA"
Германия

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Гр. 20230-00

Москва
2000 г.

Приложение. «Рекомендация. ГСИ. Преобразователи весоизмерительные цифровые BT, ST, CT и NT фирмы “BIZTRBA”, Германия. Методика поверки»

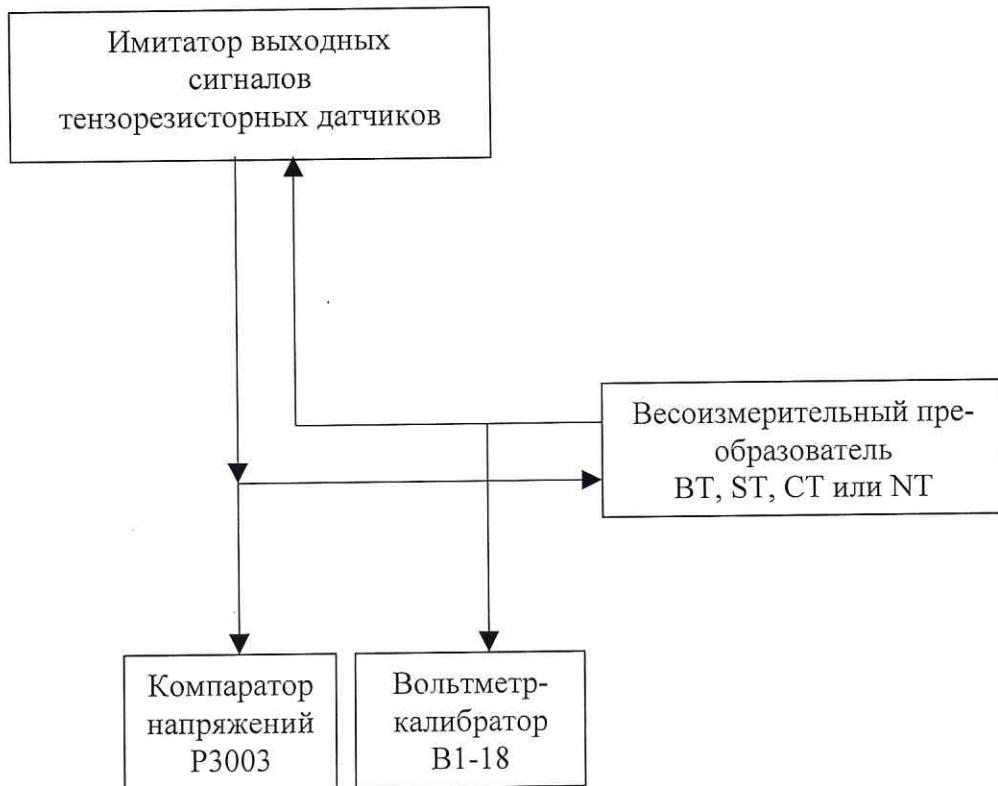


СХЕМА ДЛЯ ПОВЕРКИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ
BT, ST, СТ и NT