

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

ФБУ «Марийский ЦСМ»

А.Г. Учайкин

2016 г.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Образец контрольный с искусственным дефектом «11010WR60A»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

нр. 63754-16

г. Йошкар-Ола

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	3
1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....	3
2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	3
5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	4
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ	4
5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	4
6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	4
7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	6
ПРИЛОЖЕНИЕ Б « ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ».....	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на Образец контрольный с искусственным дефектом (ИД) «11010WR60A» заводской № 151124722710А (далее образец), предназначенного для воспроизведения геометрических параметров наружного дефекта (длины, глубины и ширины) и используется для настройки условной чувствительности и проверки оборудования вихревоковой дефектоскопии блоков цилиндров.

Образец подлежит поверке с периодичностью, устанавливаемой потребителем с учётом режимов и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в два года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:

РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

3. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД по поверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4
1. Подготовка к проведению поверки	8	Да	Да
2. Внешний осмотр	9.1	Да	Да
3. Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины, ширины и глубины искусственного дефекта (ИД)		Да	Да
4. Оформление результатов поверки	11	Да	Да

4. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют следующие средства поверки (эталоны, средства измерений и вспомогательные устройства):

линейка измерительная металлическая, (0 – 1000) мм;

весы лабораторные ВМ 24001, НПВ = 24 кг; ПГ ± 3 г;

микроскоп инструментальный ИМЦ 150Х50, Б. Предел допускаемой основной погрешности ±3 мкм при отсчете от нулевого положения в диапазоне измерений (0-25) мм;

приспособление в виде плоского зеркала для изменения хода лучей;

индикатор часового типа ИЧ-10 с ценой деления 0,01 мм КТ 0;

стойка С11-28-125-125;

плита поверочная шлифовальная тип 1000×630 КТ 1.

Примечания:

1. Допускается применение других средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими в соответствии с вышеуказанными нормативными документами требуемую точность измерений.

2. Все СИ, применяемые при поверке, должны быть утвержденного типа и поверены.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки образца допускают персонал организаций, аккредитованных в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ в соответствии с установленным порядком, изучивших настоящую методику поверки и паспорт на образец, имеющих опыт работы по поверке геометрических средств измерений.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.003-91, а также требования безопасности на средства поверки и вспомогательное оборудование, изложенные в документах, содержащих методику поверки, и/или в эксплуатационной документации на данные средства поверки и вспомогательное оборудование.

7. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- температура окружающего воздуха, °C 5 – 25;
- относительная влажность окружающего воздуха, % 30 – 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 84 – 106,7 (630–800).

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведения поверки поверителю должны быть предоставлены копии следующих документов:

- паспорт на образец;
- описание типа на образец;

8.2 Перед проведением поверки ИД образца очищается от пыли и грязи хлопчатобумажной салфеткой, смоченной спиртом или бензином, затем продувается воздухом от резиновой груши.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность ИД и отсутствие видимых повреждений.

При наличии несоответствий по п. 9.1.1, влияющих на метрологические характеристики (далее – МХ) образца, дальнейшие операции по поверке прекращаются, в случае невозможности их устранения в процессе поверки, бракуется, выписывается извещение о непригодности.

9.2 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины, ширины и глубины искусственного дефекта (ИД).

При определении пределов допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины, ширины и глубины ИД проводят многократные измерения ($N=5$ измерений) геометрических размеров ИД согласно схемам, приведенным на рис. 1-2.

Находят среднее значение результата из 5 измерений по формуле (1):

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N} \quad (1)$$

вычисляют стандартное отклонение результатов измерений s_r по формуле (2):

$$s_r = +\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N-1}}$$

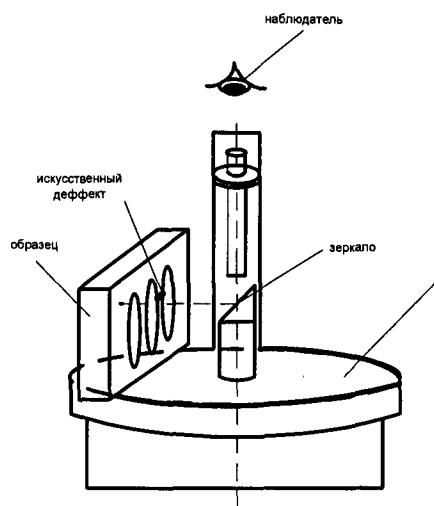


Рис. 1

Схема измерений ширины и длины искусственного дефекта на микроскопе

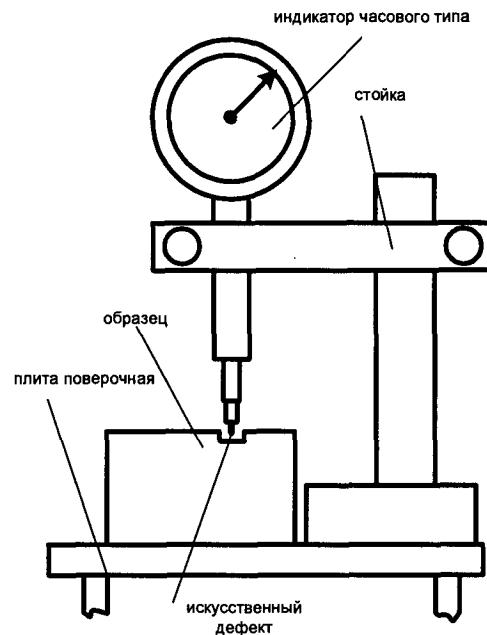


Рис. 2

Схема измерений глубины искусственного дефекта с помощью индикатора часового типа

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины, ширины и глубины ИД

$\Delta_{сумм}$ вычисляют по формуле (3)

$$\Delta_{сумм} = \pm K \sqrt{s_r^2 + \frac{\Delta^2}{3}} \quad (3)$$

где $K=2$ для доверительной вероятности $P=0,95$;

Δ в случае измерения ширины и глубины ИД равна допускаемой абсолютной погрешности микроскопа, а в случае измерения глубины ИД - допускаемой абсолютной погрешности индикатора часового типа.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения размера ИД не превышают для:

- длины $\pm 0,1$ мм;
- ширины $\pm 0,2$ мм;
- глубины $\pm 0,1$ мм

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов поверки по пунктам раздела 9, выдают свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с Приложением к приказу Минпромторга № 1815 от 02.07.2015 г. «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

11.2 При отрицательных результатах поверки образец признается непригодной к дальнейшей эксплуатации и на него выдается извещение о непригодности, оформленное в соответствии с действующим законодательством РФ об обеспечении единства измерений.

Приложение A
(обязательное)

Форма протокола поверки

Протокол поверки
образца контрольного с искусственным дефектом «11010WR60A».

1. Наименование организации, проводящей поверку	
2. Адрес организации, проводящей поверку	
3. Место проведения поверки	
4. Дата проведения поверки	
5. Полное наименование образца	Образец контрольный с искусственным дефектом «11010WR60A»
6. Заводской № образца	151124722710A
7. Методика поверки	Образец контрольный с искусственным дефектом «11010WR60A». Методика поверки
8. Условия проведения поверки	
Температура окружающей среды	
Атмосферное давление	
Относительная влажность воздуха	

9. Эталоны и вспомогательные устройства, применяемые при поверке

№ п/п	Тип	Заводской №	№ свидетельства о поверке	Дата поверки
1.				
2.				
3.				

10. Результаты внешнего осмотра

Вывод:

11. Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины, ширины и глубины искусственного дефекта (ИД).

Таблица 2 Результаты измерений и вычислений

$X_i, \text{мм}$	\bar{X}	$s_r = +\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N-1}}$	$\Delta_{cумм} = \pm K \sqrt{s_r^2 + \frac{\Delta^2}{3}}$
Измерение длины ИД. N=5; P=0,95; K=2; Δ= 0,003 мм			
Измерение ширины ИД N=5; P=0,95; K=2; Δ= 0,003 мм			
Измерение глубины ИД N=5; P=0,95; K=2; Δ= 0,008 мм			

Вывод:

Общий вывод:

Поверитель: _____

Ф. И. О., подпись